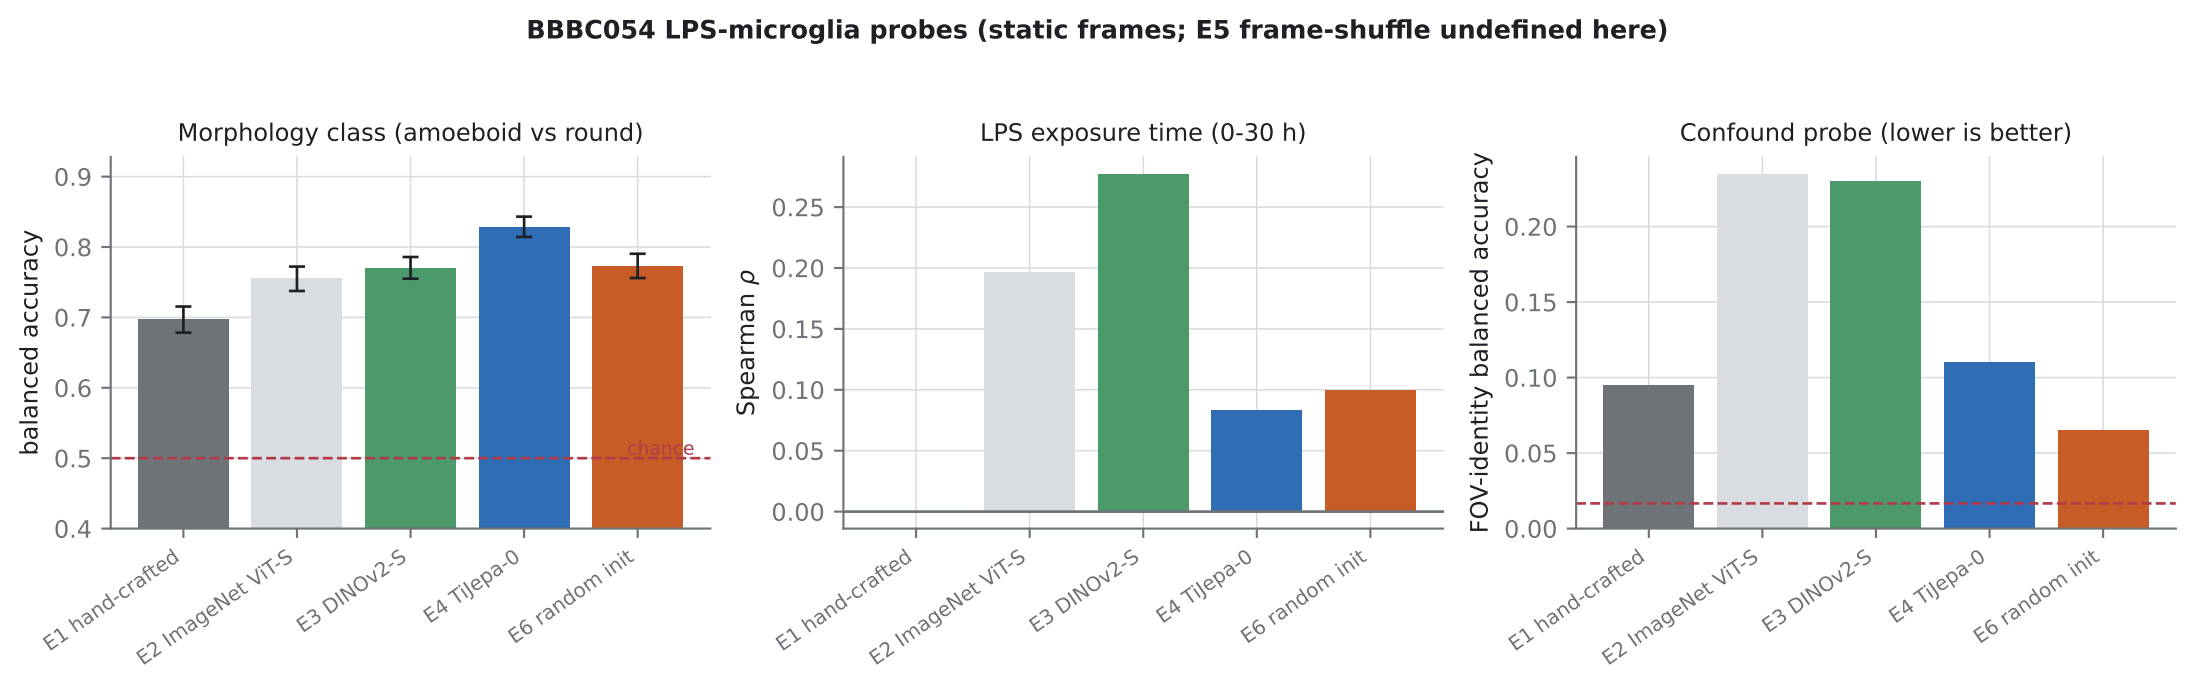
BBBC054 LPS-microglia probes (static frames; E5 frame-shuffle undefined here)
Morphology class (amoeboid vs round)
balanced accuracy
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
chance
E1 hand-crafted
E2 ImageNet ViT-S
E3 DINOv2-S
E4 TIJepa-0
E6 random init
LPS exposure time (0-30 h)
Spearman ρ
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
E1 hand-crafted
E2 ImageNet ViT-S
E3 DINOv2-S
E4 TIJepa-0
E6 random init
Confound probe (lower is better)
FOV-identity balanced accuracy
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
E1 hand-crafted
E2 ImageNet ViT-S
E3 DINOv2-S
E4 TIJepa-0
E6 random init