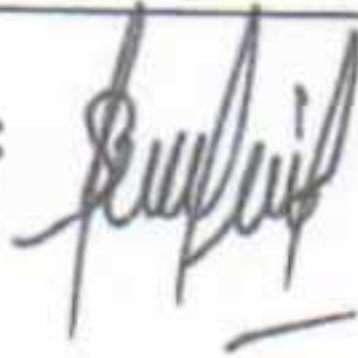
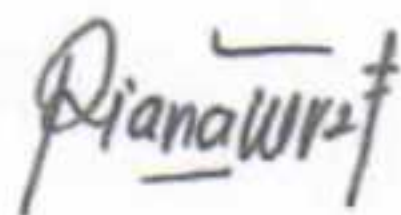


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

UJI PEMASTIAN MUTU

PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

NO DOKUMEN	:	UDDP-PM-L2-002
VERSI	:	004
TANGGAL BERLAKU	:	29 Juli 2025
TANGGAL REVIEW	:	29 Juli 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☒ COPY NO : ☐

Disusun oleh: Syifa Fauzia, Amd.Kes Staf Sub Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 24 Juli 2025
Diperiksa oleh : Riana Rizki Wulandari, Amd.AK Staf Sub Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 24 Juli 2025
Disetujui oleh : Ali Nuryadin, A.Md.Kes, SKM., MKM Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 25 Juli 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 28 Juli 2025

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 1 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) uji pemastian mutu peralatan & bahan habis pakai merupakan petunjuk bagi petugas untuk melakukan pengkajian mutu meliputi pengujian kualifikasi dan validasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) kritikal yang baru. Pengujiannya disesuaikan dengan standar spesifikasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai sesuai standar, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman, efektif, dan konsisten.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh petugas yang kompeten dalam melakukan pengujian kualifikasi dan validasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) yang baru.

SPO ini meliputi persyaratan administratif berupa kelengkapan dokumen dan persyaratan teknis berupa kelulusan uji kualifikasi (desain, instalisasi, operasional, dan kinerja) untuk alat dan uji validasi untuk BHP dan proses.

SPO ini juga merupakan acuan untuk pemasok dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan uji kualifikasi dan validasi.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1. Butir 2.34 Higiene Petugas (Teknisi)

Untuk memastikan perlindungan produk, donor dan karyawan terhadap kontaminasi, petugas mengenakan APD seperti pakaian pelindung diri yang bersih sesuai tugas yang mereka lakukan. Gunakan sarung tangan sekali pakai atau steril saat menangani bahan yang mungkin bersentuhan dengan darah.

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

3.2. Kualifikasi dan validasi Peralatan dan/atau Bahan habis Pakai

3.2.1. Butir 5.1 Sarana, prasarana, dan peralatan harus dikualifikasi sebelum digunakan. Sistem, proses, dan pengujian harus divalidasi, yang melibatkan pertimbangan yang lebih luas di luar sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan. Namun, dalam standar ini, istilah validasi digunakan dalam pengertian umum, meliputi kegiatan kualifikasi maupun validasi.

3.2.2. Butir 5.2 Setiap perubahan yang direncanakan pada sarana dan prasarana, peralatan, sarana penunjang, dan proses harus didokumentasikan secara resmi dan dampaknya terhadap mutu komponen darah harus divalidasi.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 2 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

3.2.3. Kegiatan kualifikasi harus mempertimbangkan semua tahap mulai dari pengembangan awal sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna sampai pada akhir penggunaan peralatan, sarana dan prasarana, sarana penunjang, atau sistem. Tahap utama dan beberapa kriteria yang diusulkan dapat disertakan dalam urutan sebagaimana dijelaskan pada angka 5.22 hingga angka 5.27.

3.3. Dokumentasi Termasuk RIV

3.3.1 Butir 5.18. Hasil yang tidak memenuhi kriteria keberterimaan yang telah ditentukan harus dicatat sebagai penyimpangan dan diinvestigasi secara menyeluruh sesuai prosedur internal. Setiap implikasi terhadap validasi harus dibahas dalam laporan.

3.3.2 Butir 5.19. Pengkajian dan pengambilan kesimpulan validasi harus dilaporkan dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria keberterimaan. Tiap perubahan terhadap kriteria keberterimaan harus dijustifikasi secara ilmiah dan rekomendasi akhir dibuat sebagai luaran validasi.

3.4. Kualifikasi Ulang

3.4.1. Butir 5.28. Harus dilakukan evaluasi terhadap peralatan, sarana dan prasarana, serta sistem secara berkala untuk memastikan bahwa status kualifikasi tetap terkendali.

3.4.2. Butir 5.29. Bila diperlukan kualifikasi ulang yang dilakukan pada periode waktu tertentu, periode dan kriteria untuk evaluasi harus ditetapkan. Selanjutnya, kemungkinan perubahan minor dari waktu ke waktu harus dinilai.

4. Referensi

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Pengelola Darah Dan Bank Plasma

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Pemastian Mutu : Suatu bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pemastian bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
- 5.2. Kualifikasi : Suatu rangkaian tindakan yang digunakan untuk memberikan bukti terdokumentasi bahwa setiap peralatan, bahan kritis, atau reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 3 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

akhir yang mungkin memengaruhi mutu atau keamanan produk, yang handal, sebagaimana ditetapkan dan mendapatkan hasil yang diharapkan

- 5.3. Validasi : Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
- 5.4. Pengawasan Mutu : Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOB yang berhubungan dengan spesifikasi, pengambilan sampel, dan pengujian. Pengawasan mutu juga berhubungan dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan serta produk yang belum diluluskan tidak digunakan/ didistribusikan sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat.
- 5.5. Pemberi Kontrak : Suatu lembaga atau institusi yang mensubkontrakkan pekerjaan atau jasa tertentu kepada lembaga yang berbeda dengan kontrak yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 5.6. Penerima Kontrak : Suatu lembaga atau institusi yang melakukan pekerjaan atau jasa tertentu berdasarkan kontrak untuk lembaga yang berbeda.
- 5.7. Kualifikasi Desain : Kualifikasi Desain (KD) adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem atau peralatan baru. Desain hendaklah memenuhi ketentuan CPOB dan didokumentasikan.
- 5.8. Kualifikasi Instalasi : Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah diinstal sesuai dengan spesifikasi UDDP dan rekomendasi dari manufaktur/pabrik.
- 5.9. Kualifikasi Operasional : Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa sistem dan subsistem dapat bekerja dalam rentang operasional yang dipersyaratkan.
- 5.10. Kualifikasi Kinerja : Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menjelaskan bahwa peralatan ini telah bekerja sesuai dengan fungsinya dan memenuhi spesifikasi proses.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 4 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

6. Peran dan Tanggung jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manager Kualitas	- Melakukan kontrol dokumen terhadap SPO Uji Pemastian Mutu - Mengesahkan dan meninjau ulang SPO dan formulir terkait hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP - Mengawasi pelaksanaan proses, membuat laporan tindakan perbaikan, pencegahan dan tindak lanjutnya
Kepala Sub Bidang pengawasan mutu	- Melakukan perencanaan kegiatan kualifikasi dan validasi untuk alat dan/atau BHP baru - Memberikan persetujuan pada SPO dan keseluruhan kegiatan yang berlangsung di pemastian mutu - Menindaklanjuti laporan kegiatan dengan memberikan surat keterangan hasil uji - Membuat surat tanggapan pengajuan pemastian mutu dan surat keterangan hasil pemastian mutu alat dan atau BHP - Merevisi dan menyetujui SPO, IK, dan protokol - Mengawasi pelaksanaan proses, membuat laporan tindakan perbaikan, pencegahan dan tindak lanjutnya - Melaporan kegiatan dengan memberikan surat keterangan hasil uji - Melakukan dokumentasi terhadap dokumen PKS
Staf pengawasan mutu & petugas bidang terkait	- Membuat SPO dan Instruksi Kerja - Memberikan surat tanggapan dan lampiran uji pemastian mutu kepada pemohon - Membuat protokol pemastian mutu alat dan BHP - Menerima peralatan dan/atau BHP dari pemasok - Melakukan uji kualifikasi dan validasi - Membuat laporan hasil uji pemastian mutu alat dan atau BHP
Pemohon	Membuat surat permohonan pemastian mutu sebagai pemberi kontrak

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 5 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Peran	Tanggung Jawab
	• Menerima surat jawaban pemastian mutu dari UDDP PMI • Melengkapi persyaratan pemastian mutu • Mengisi formulir persetujuan uji pemastian mutu • Mematuhi persyaratan dan tata tertib uji pemastian mutu • Membawa alat yang diuji dilengkapi dengan alat penunjang lainnya • Instal peralatan dan melakukan kualifikasi instalisasi • Memeriksa operasional peralatan dengan <i>user</i> • Menyediakan manual operasional peralatan & Bahan Habis Pakai serta hasil uji performa dari pabrik • Melakukan pelatihan singkat seperti presentasi mengenai alat atau Bahan Habis Pakai, demo alat atau Bahan Habis Pakai sebelum kualifikasi alat

7. Prosedur

7.1. Persiapan Uji Pemastian Mutu

- 7.1.1. Pemohon membuat surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) yang berlaku maksimal 2 tahun setelah tanggal penerbitan surat permohonan
- 7.1.2. Kepala UDD Pusat & Manager Kualitas, menerima surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)
- 7.1.3. Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu menerima disposisi surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kepala UDD Pusat & Manager Kualitas
- 7.1.4. Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu membuat surat jawaban atas surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP), form ketersediaan, persyaratan dan tata tertib uji pemastian mutu selanjutnya diberikan kepada pemohon
- 7.1.5. Pemohon menandatangani formulir ketersediaan dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Uji Pemastian Mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)
- 7.1.6. Pemohon melengkapi dokumen-dokumen persyaratan
- 7.1.7. Pastikan pemohon melengkapi dan menyerahkan dokumen dengan lengkap

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 6 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

- 7.1.8. Sub bidang pengawasan mutu (penguji) menyusun protokol uji pemastian mutu alat dan/atau BHP terkait
- 7.1.9. Kepala Sub Bidang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengujian
- 7.1.10. Sub bidang pengawasan mutu (penguji) menyerahkan RAB, protokol uji dan jadwal pelaksanaan kepada Manager Kualitas untuk disetujui
- 7.1.11. Manajer kualitas mengecek, menyetujui dan mengesahkan RAB, protokol uji dan jadwal pelaksanaan
- 7.1.12. Sub bidang pengawasan mutu (penguji) menyerahkan RAB, dan jadwal pelaksanaan kepada pemohon setelah disetujui Manager Kualitas
- 7.1.13. Pastikan pemohon menerima & menyetujui RAB dan jadwal pelaksanaan
- 7.1.14. Pemohon melakukan pembayaran biaya uji pemastian mutu sesuai RAB yang telah diterima
- 7.1.15. Pemohon melakukan pengecekan daya listrik dan area pengujian sebelum melakukan pengiriman dan/atau instalisasi alat dan/atau BHP didampingi staf sub bidang rumah tangga
- 7.1.16. Pemohon mengirim alat dan/atau BHP yang akan dilakukan uji pemastian mutu di UDD Pusat PMI
- 7.1.17. Sub bidang pengawasan mutu (penguji) menerima alat dan/atau BHP dari pemohon dan mengecek kelengkapan dokumen

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

7.2. Uji Pemastian Mutu

- 7.2.1. Pemohon melakukan proses kualifikasi instalasi (KI) terhadap alat didampingi dan dimonitor staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji)
- 7.2.2. Pemohon melakukan proses *training* terkait alat dan/atau BHP terhadap Sub bidang pengawasan mutu (penguji)
- 7.2.3. Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji) dan pemohon melakukan Kualifikasi Operasional (KO) terhadap alat dan/atau BHP
- 7.2.4. Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji) melakukan uji Kualifikasi Kinerja (KK) pada alat dan/atau BHP terhadap tiga (3) nomor lot berbeda sesuai dengan protokol uji pemastian mutu alat dan BHP yang telah disusun dan disahkan.
- 7.2.5. Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji) melakukan interpretasi seluruh hasil pengujian dan mendokumentasikan seluruh kegiatan uji pemastian mutu meliputi (Kualifikasi Desain, Kualifikasi Instalasi, Kualifikasi Operasional dan Kualifikasi Kinerja)
- 7.2.6. Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji) membuat laporan hasil uji pemastian mutu

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 7 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

- 7.2.7. Kepala sub bidang pengawasan mutu mengecek kembali laporan hasil uji pemastian mutu dan membuat surat keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP tersebut
- 7.2.8. Manager Kualitas mengesahkan hasil laporan hasil uji pemastian mutu dan menyetujui surat keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP
- 7.2.9. Kepala UDD Pusat PMI menyetujui hasil uji pemastian mutu dan mengesahkan surat keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP
- 7.2.10. Pemohon menerima laporan hasil pemastian mutu alat dan/atau BHP terkait
- 7.2.11. Pemohon melakukan *uninstall* dan penarikan alat

7.3. Pemastian Mutu Ulang

7.2.1 Pemastian Mutu ulang dilakukan setelah masa berlaku surat rekomendasi berakhir (3 tahun)

7.2.2 Pemastian mutu ulang dilakukan apabila:

7.2.2.1. Terdapat perubahan kepada proses, bahan atau parameter pengoperasiannya.

7.2.2.2. Peralatan telah dipindahkan (tidak berlaku untuk peralatan yang dikonfirmasi oleh produsen sebagai "*portable*" atau "*mobile*")

7.2.2.3. Peralatan telah mengalami perbaikan fungsional

7.2.2.4. Hasil dari QC, kalibrasi, evaluasi berkala, hasil dari monitoring *post market* diidentifikasi sebagai masalah atau trend (kecenderungan).

7.2.3 Pengujian pemastian mutu ulang dilakukan secara teknis dan kelengkapan dokumen terhadap alat dan/atau bahan habis pakai tersebut terhadap satu (1) nomor lot.

7.4. Perubahan nama distributor pada Surat Keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP

7.4.1. Pemohon mengajukan permohonan uji pemastian mutu kepada Kepala UDD Pusat PMI

7.4.2. Pemohon mematuhi tata tertib dan mengisi formulir persetujuan uji pemastian mutu

7.4.3. Pemohon melengkapi persyaratan perubahan surat keterangan uji pemastian mutu sebagai berikut:

7.4.3.1 Melengkapi dokumentasi AKL/AKD terbaru

7.4.3.2 Surat penunjukan sebagai pemasok dari perusahaan (*manufacture*)

7.4.3.3 Izin Distribusi Alat Kesehatan (IDAK)

7.4.3.4 Data populasi penggunaan alat dan/atau BHP di lingkungan UDD PMI

7.4.3.5 Sertifikat terkait dari badan nasional dan internasional

7.4.3.6 Hasil uji kualitas produk dari pabrik (*Kit insert*)

7.4.3.7 Buku manual operasional alat dan/atau BHP

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 8 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

7.4.3.8 Dokumen Kualifikasi Instalasi (KI), Kualifikasi Operasional (KO), dan Kualifikasi Kinerja (KK) dari pabrik alat sebagai dokumen uji kualifikasi.

7.4.4 Pemohon mendampingi proses uji pemastian mutu (KI, KO, KK).

7.4.5 Staf Sub Bidang Pengawasan Mutu melakukan uji pemastian mutu mengikuti prosedur pada butir 7.2. Uji Pemastian Mutu

8. Lampiran

8.1. Surat tanggapan pemastian mutu Alat dan/atau BHP

8.2. Persyaratan pemastian mutu Alat dan/atau BHP

8.3. Tata tertib pemastian mutu peralatan dan/atau BHP

8.4. Formulir Persetujuan pemastian mutu Alat dan/atau BHP

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	02 Oktober 2015	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Dokumen Baru
002	01 November 2018	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Revisi 1 ▪ Masa Berlaku selesai
003	22 Juli 2020	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Revisi 2 ▪ Penambahan PKS ▪ Perubahan alur evaluasi ▪ Penambahan lampiran
004	29 Juli 2022	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Revisi 3 ▪ Perubahan pengujian pemastian mutu ulang
005	18 Juli 2025	▪ PMK No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar pelayanan Darah ▪ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Pengelola Darah Dan Bank Plasma	Revisi 4 ▪ Perubahan proses pengujian pemastian mutu ulang (re-evaluasi) ▪ Perubahan referensi pada Peraturan BPOM

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 9 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.1 Surat tanggapan pemastian mutu Alat dan/atau BHP

Jakarta,

Nomor :/04.03/..../2020
 Lamp : 3 Lembar
 Hal : Tanggapan pengajuan Uji Evaluasi

Kepada:

PT.

.....

.....

Jakarta Selatan - 12520

Sesuai dengan surat No. dari perusahaan saudara, dengan perihal permohonan evaluasi terhadap alat, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilengkapi untuk uji evaluasi, yaitu :

1. Persyaratan Administratif (terlampir)
2. Mengisi formulir persetujuan uji evaluasi alat dan BHP (terlampir)
3. Proses evaluasi sesuai protokol uji evaluasi yang ditetapkan
4. Kesepakatan kerjasama distribusi

UDD Pusat PMI melakukan kerjasama distribusi dengan PT (Perseroan terbatas) dalam distribusi ke UDD-UDD daerah di Indonesia, terkait fungsi UDD Pusat PMI sebagai pusat yang mengatur logistik pelayanan darah secara nasional.

Apabila saudara menyetujui persyaratan uji evaluasi tersebut, mohon mengisi formulir persetujuan (terlampir) dan melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut diatas, kemudian kirimkan ke UDD Pusat PMI (Sub Bidang Pengawasan Mutu). Persyaratan tersebut akan digunakan untuk melakukan uji evaluasi di laboratorium kami yang waktunya akan kami tetapkan kemudian.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Unit Donor Darah Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
 Kepala,

(dr. Robby Nur Aditya., M.Si)

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

Tembusan:

Ketua bidang pengembangan UDD PP PMI

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 10 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.2 Persyaratan pemastian mutu Alat dan/atau BHP

PERSYARATAN PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

- Melengkapi dokumen-dokumen yang meliputi :
 - Surat pendaftaran alat dari badan milik pemerintah yang berwenang (AKL)
 - Izin Penyalur Alat kesehatan (IPAK)
 - Sertifikat terkait dari badan internasional
 - Hasil uji kualitas produk dari pabrik (*Kit insert*)
 - Buku manual operasional alat dan/atau BHP
 - Dokumen Kualifikasi Instalasi (KI), Kualifikasi Operasional (KO), dan Kualifikasi Kinerja (KK) dari pabrik alat sebagai dokumen uji kualifikasi.
 - Populasi data penggunaan alat dan/atau BHP (lokal/internasional).
- Melengkapi pembayaran pemastian mutu yang besarnya akan diinformasikan kemudian. (Pembayaran administrasi dapat dibagi 3 termin yaitu 50% sebelum proses pemastian mutu, 25% pada saat proses evaluasi, dan 25% setelah evaluasi selesai).
- Pemohon (distributor/perusahaan) mengutus 1 (satu) orang petugas teknis atau petugas aplikasi untuk mendampingi proses pemastian mutu (untukantisipasi bila terjadi kerusakan pada alat).
- Apabila terjadi kerusakan pada alat harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) minggu dan harus segera dilakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kerusakan.
- Apabila ada kegagalan produk terkait alat dan/atau BHP yang digunakan untuk pemastian mutu maka segera melakukan penarikan dengan menyertakan surat keterangan dari pabrik dan menggantinya.
- Apabila terjadi kegagalan pemeriksaan pemastian mutu, BHP menjadi tanggungan pemohon (distributor/ perusahaan).
- Apabila proses evaluasi telah selesai maka pemohon wajib melakukan penarikan alat maksimal 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat rekomendasi dikeluarkan.
- Alat dan/atau BHP yang dinyatakan lulus pemastian mutu akan mendapatkan Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu dari UDD Pusat PMI yang masa berlakunya tiga (3) tahun. Untuk memperpanjang masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu terdapat ketentuan ketentuan yang harus dipahami sebagai berikut:
 - Melampirkan data populasi pemakaian alat dilingkungan UDD Pusat PMI
 - Pemohon melampirkan dokumen pendukung seperti: AKL, sertifikat kualitas, dll
 - Apabila terdapat keluhan dari pemakai alat tersebut di UDD,
 - Dilakukan uji verifikasi alat dengan jumlah sampel yang akan di tentukan di dalam protocol uji pemastian mutu ulang.
- UDD Pusat PMI akan melakukan monitoring terkait alat dan/atau BHP yang telah dilakukan pemastian mutu kepada UDD di seluruh Indonesia.
- Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu dari UDD Pusat PMI dinyatakan tidak berlaku apabila alat dan/atau BHP dipasarkan oleh distributor yang berbeda dengan yang tertera pada AKL.
- Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu hanya berlaku untuk lingkungan internal UDD Pusat PMI, tidak untuk instansi lainnya seperti Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Rumah Sakit.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 11 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.3 Tata tertib pemastian mutu peralatan dan/atau BHP

TATA TERTIB PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

- A. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pemohon (distributor/perusahaan)**
1. Mentaati segala persyaratan untuk instalisasi alat sesuai aturan Rumah Tangga UDD Pusat PMI
 2. Menyediakan dokumen kualifikasi instalisasi dan operasional
 3. Pada proses pemastian mutu pemohon tidak diperkenankan masuk kedalam laboratorium pemastian mutu tanpa seizin petugas pemastian mutu (UDD Pusat PMI)
 4. Selama proses pemastian mutu berlangsung pemohon tidak diperkenankan untuk bertanya tentang hasil pemeriksaan pemastian mutu
 5. Tidak memaksa petugas UDD Pusat PMI untuk mempercepat waktu pemastian mutu (mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UDD Pusat PMI)
 6. Tidak mengajukan penghentian proses evaluasi yang sedang berjalan
 7. Mengikuti serta menyepakati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama (PKS)
- B. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pelaksana (UDD Pusat PMI)**
1. Melaksanakan pemastian mutu tepat pada waktunya
 2. Mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) dan protokol saat pemastian mutu terkait
 3. Menyediakan dokumen protokol kinerja dan evaluasi
 4. Mengikuti tata tertib laboratorium
 5. Tidak memberikan informasi apapun terkait hasil pemastian mutu saat proses berlangsung
 6. Memberitahu segera kepada petugas teknis atau aplikasi dari pemohon yang mendampingi petugas evaluator di UDD Pusat PMI apabila terjadi *troubleshooting* pada alat
 7. Mencatat segala informasi terkait proses pemastian mutu seperti: kemudahan penggunaan alat, waktu pembacaan hasil, dan lain-lain

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU PERALATAN & BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 12 dari 12 Nomor : UDDP-PM-L2-002 Versi : 005 Tanggal berlaku : 29 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 29 Juli 2027
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.4 Formulir Persetujuan pemastian mutu Alat dan/atau BHP

FORMULIR PERSETUJUAN PEMASTIAN MUTU

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp. Kantor :
 No. Kontak Personal :

Nama dan Jenis Peralatan dan/atau Bahan habis Pakai (BHP):

(Wajib diisi dan dilengkapi dengan Brosur alat dan/atau BHP)

Setelah membaca surat persyaratan mengenai pemastian mutu peralatan dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) oleh Sub. Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat PMI, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menyetujui persyaratan yang diberlakukan untuk pemastian mutu alat.
2. Menyetujui untuk mengikuti peraturan tata tertib yang ditetapkan UDD Pusat PMI selama pelaksanaan pemastian mutu berlangsung.
3. Menyetujui anggaran biaya pemastian mutu yang telah ditetapkan oleh UDD Pusat PMI
4. Menyetujui untuk membuat surat persetujuan kerjasama apabila lulus pemastian mutu dan direkomendasikan untuk dipergunakan di lingkungan UDD PMI.
5. Tidak akan mengajukan penghentian proses pemastian mutu yang sedang berjalan.

***) Formulir wajib dikembalikan ke UDD Pusat PMI (Sub Bidang Pengawasan Mutu), setelah memahami dan menyetujui perjanjian kerjasama sebelum proses Pemastian Mutu dilaksanakan.**

Jakarta, 202..

Materai 10000

Nama: _____

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

MASTER