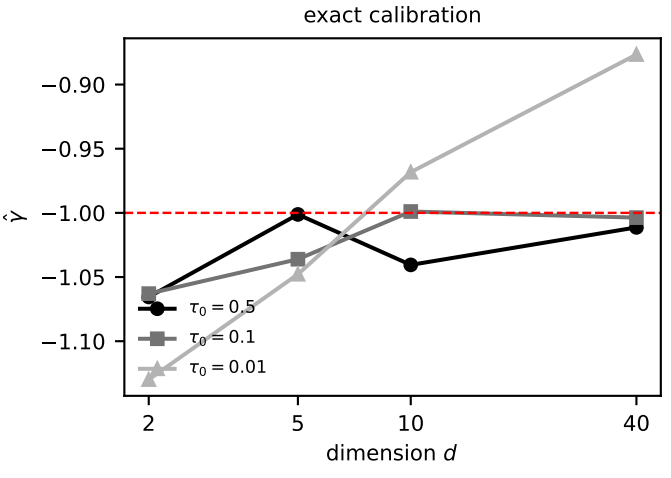
exact calibration
−0.90
−0.95
−1.00
−1.05
−1.10
$\hat{\gamma}$
$\tau_0 = 0.5$
$\tau_0 = 0.1$
$\tau_0 = 0.01$
2
5
10
40
dimension d

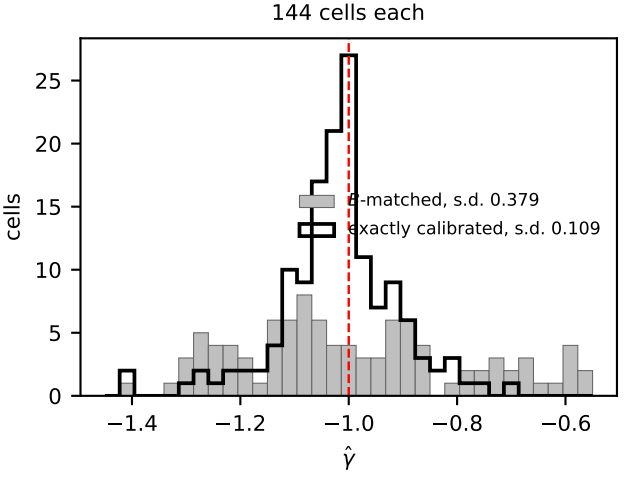
144 cells each
25
20
15
10
5
0
cells
B-matched, s.d. 0.379
exactly calibrated, s.d. 0.109
−1.4
−1.2
−1.0
−0.8
−0.6
$\hat{\gamma}$