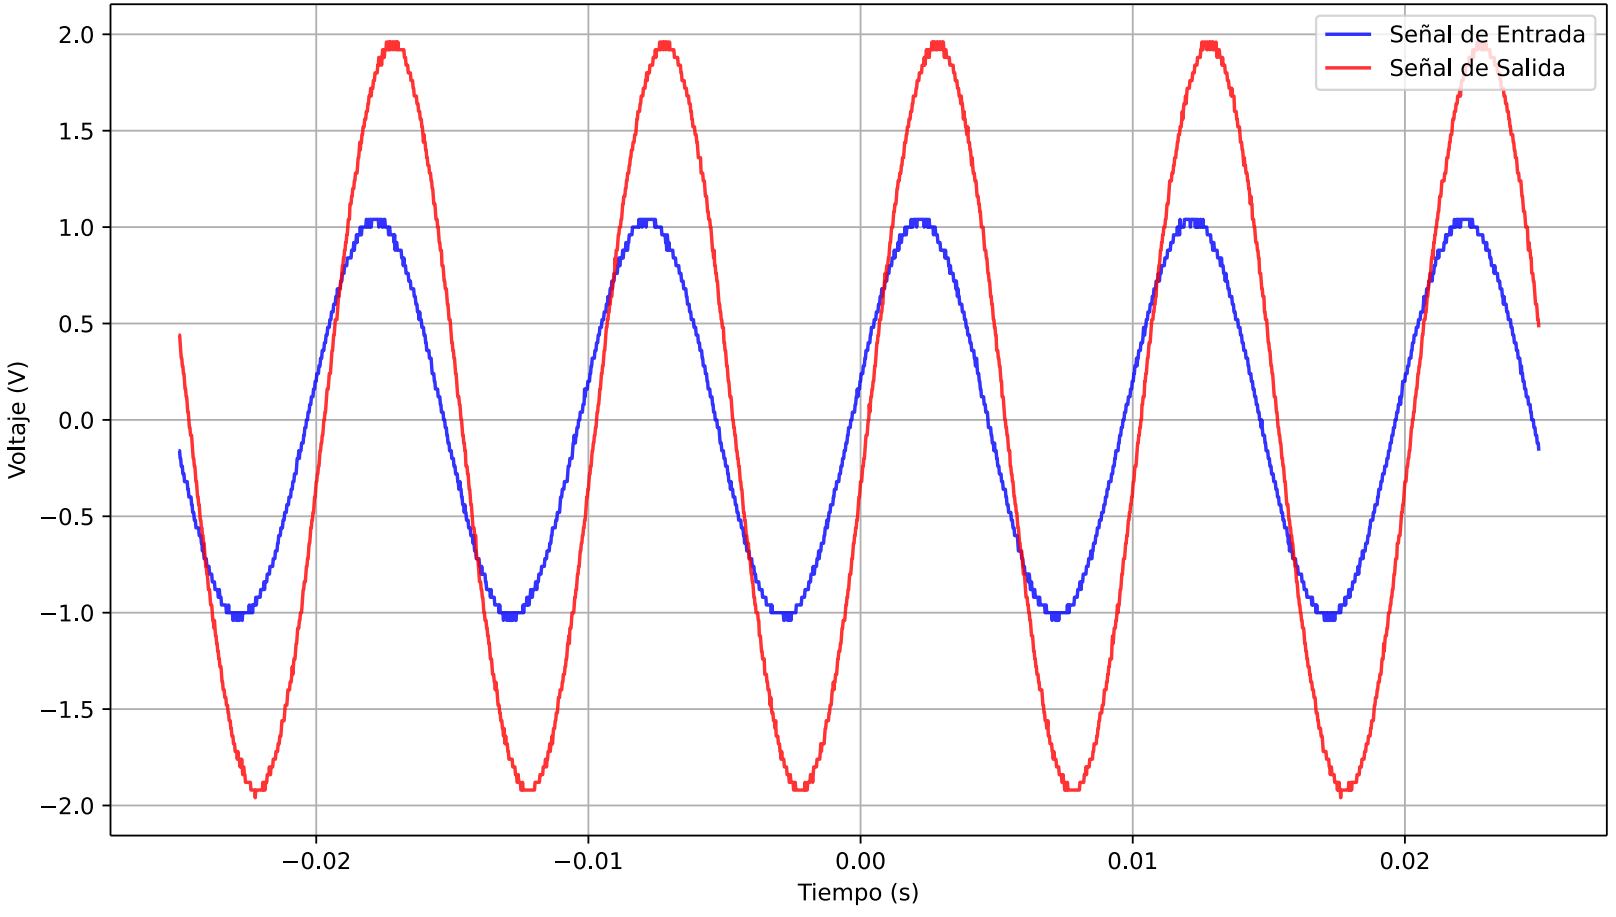

Filtro Pasa Bajas Sallen-Key (Frecuencia: 100.00 Hz) - Amplificación
Señal de Entrada
Señal de Salida
Voltaje (V)
Tiempo (s)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−0.02
−0.01
0.00
0.01
0.02