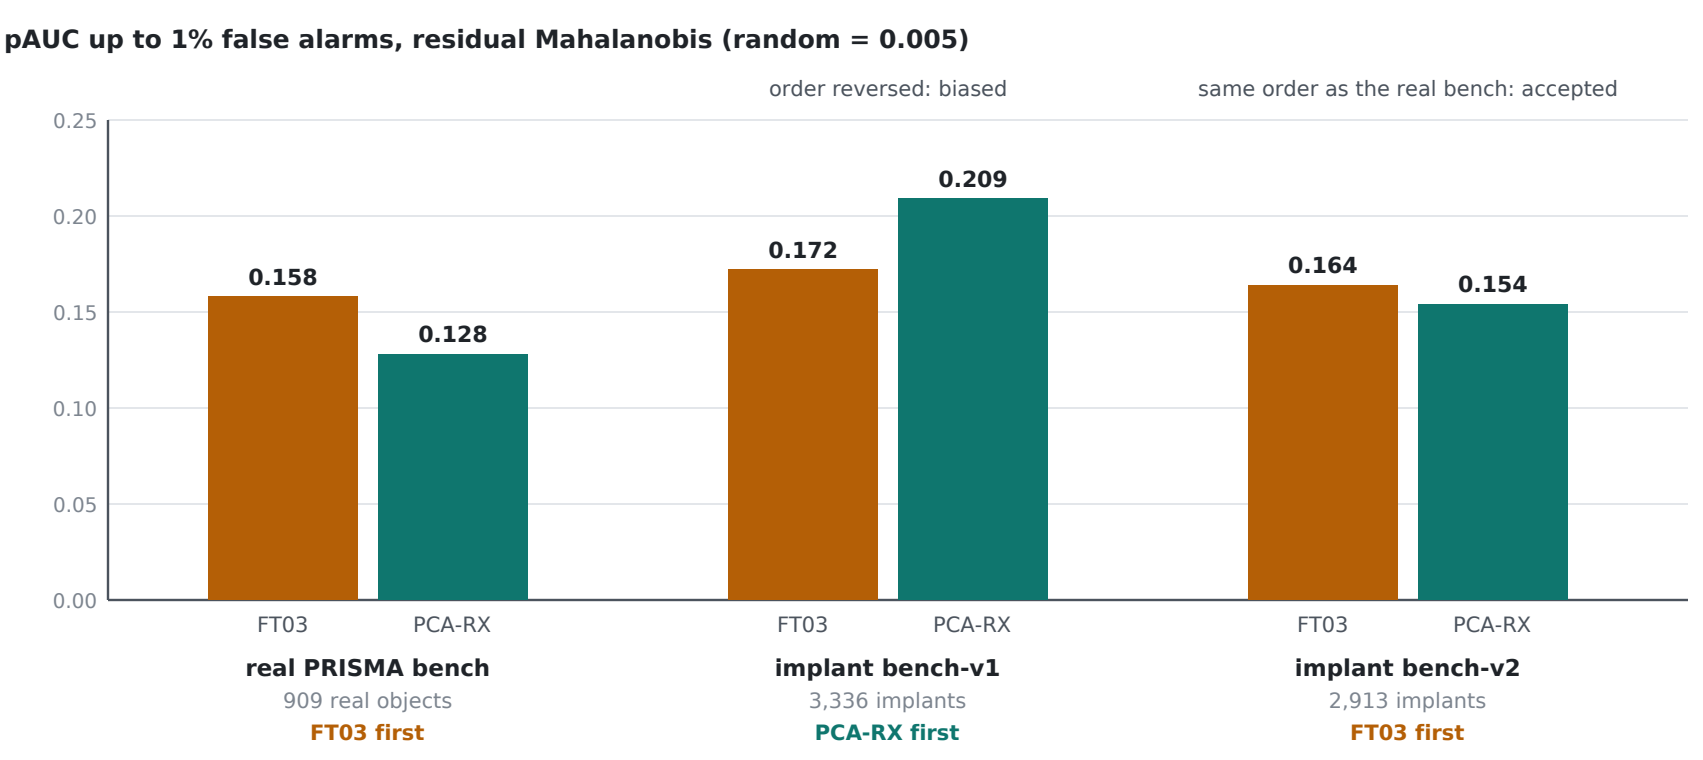
pAUC up to 1% false alarms, residual Mahalanobis (random = 0.005)
order reversed: biased
same order as the real bench: accepted
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.158
0.128
0.172
0.209
0.164
0.154
FT03
PCA-RX
FT03
PCA-RX
FT03
PCA-RX
real PRISMA bench
909 real objects
FT03 first
implant bench-v1
3,336 implants
PCA-RX first
implant bench-v2
2,913 implants
FT03 first