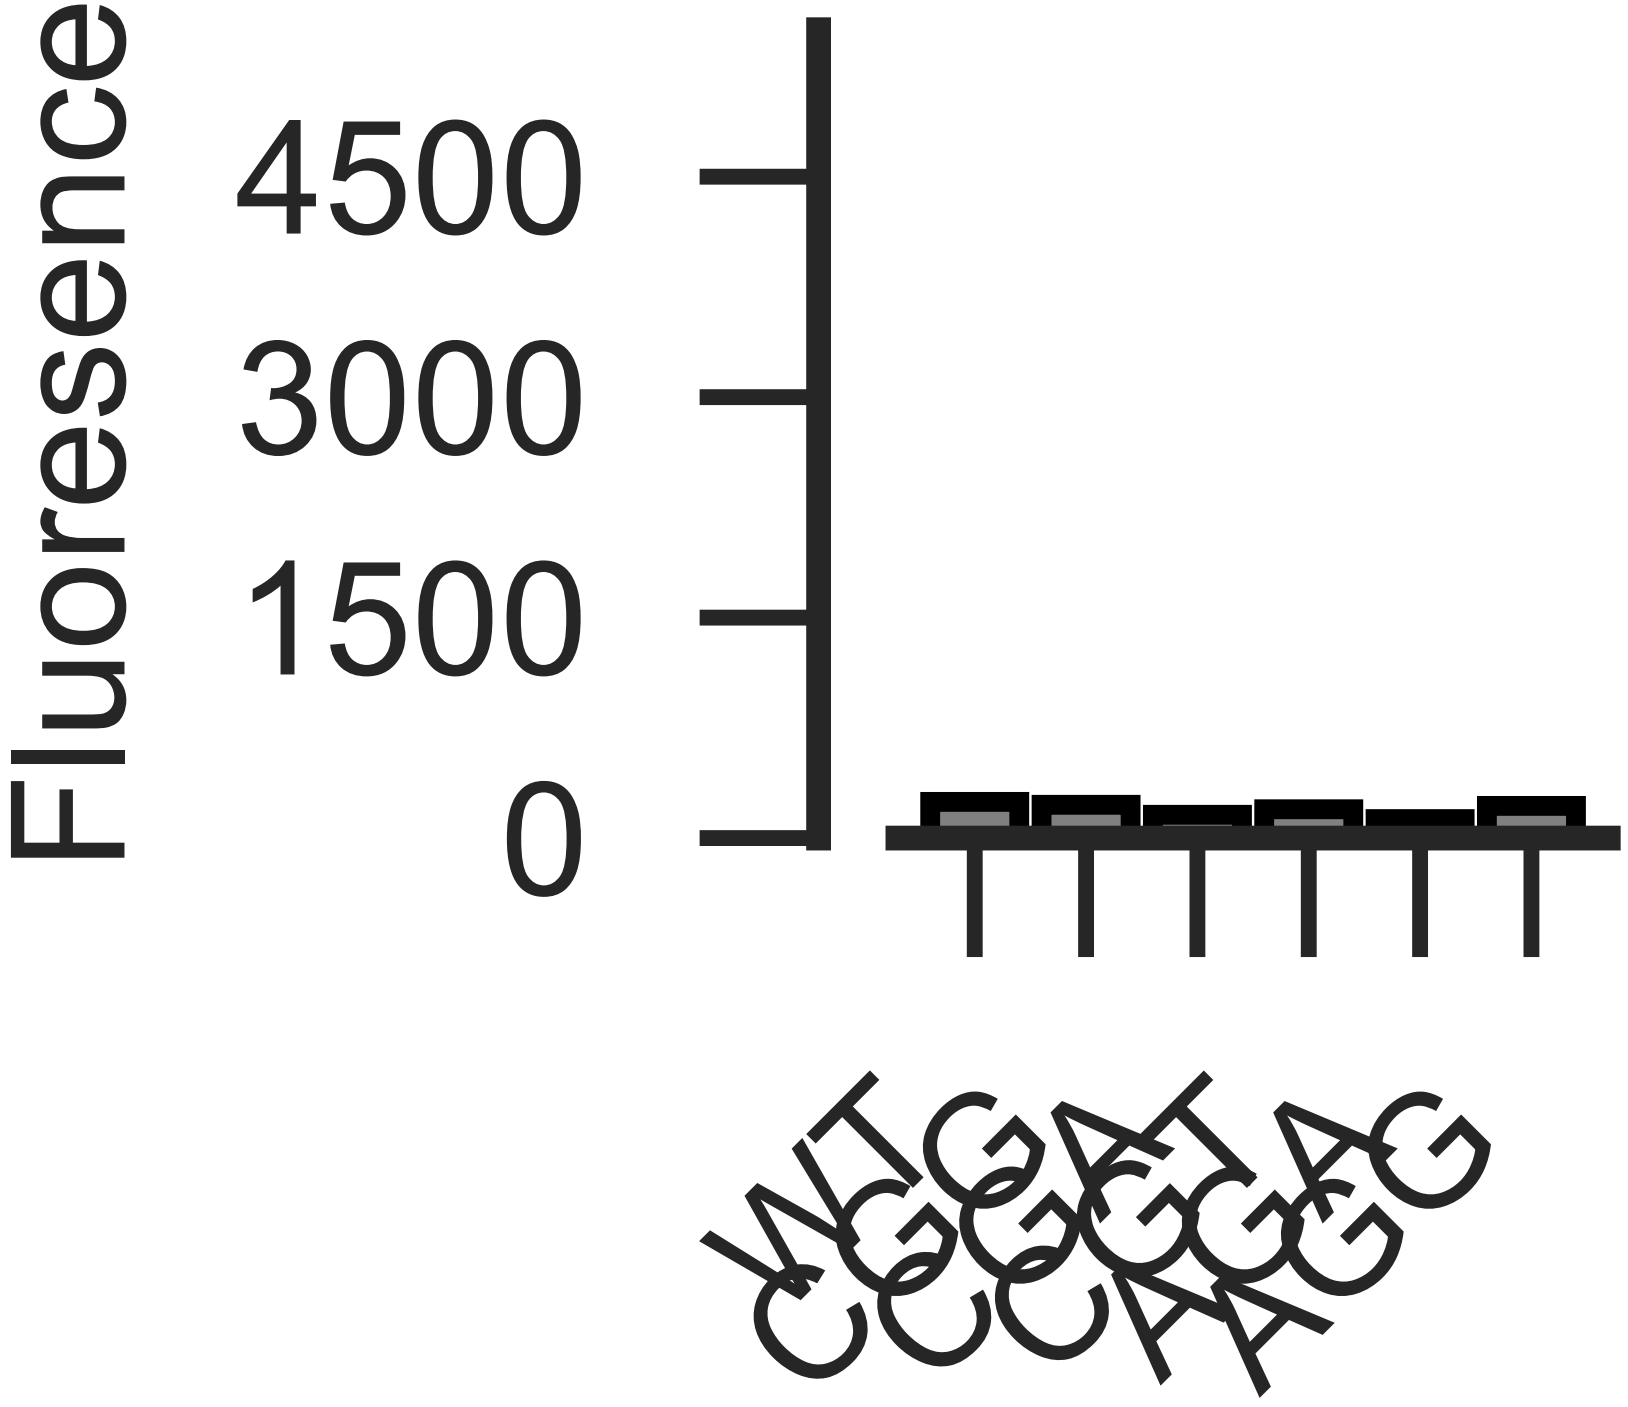
Fluoresence
4500
3000
1500
0
WT
GGA
CGGT
CCGA
AGG