

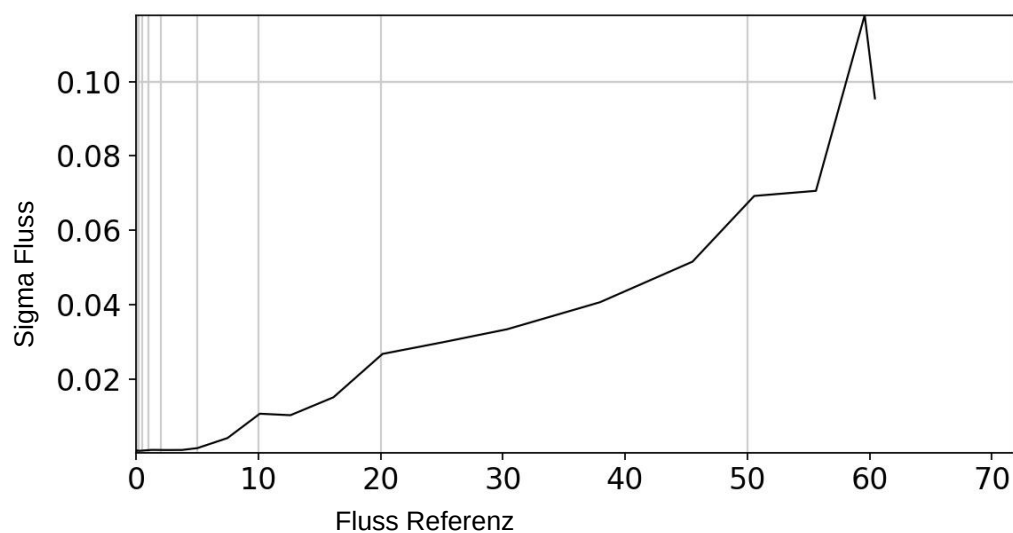
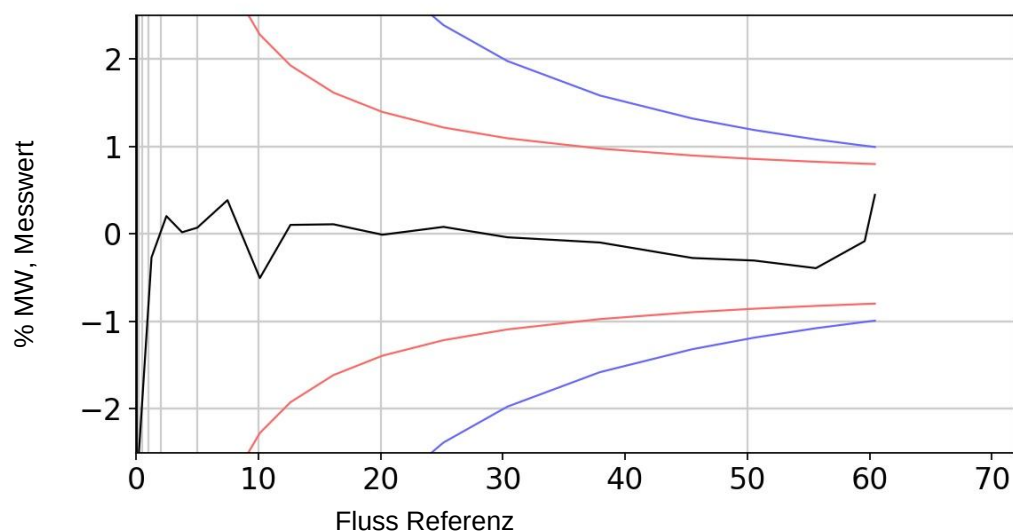


Kalibrierergebnis


Station	KS04 / A5 / 37	Datum	2022.07.11 13:38:29
Typ	Smart 6 / GSxxxxA_xxxx_Gas		Air
Seriennummer	284015		
Eingangsdruck	0.004 / 0.241 / 0.744 Bar	Ausgangsdruck	0.003 / 0.106 / 0.275 Bar
Kammertemperatur	18.6 / 19.3 °C	Plattentemperatur	23.0 / 23.3 °C
DATA Eintrag	[DATA2]		
LOOKUP Eintrag	[LOOKUP01]		

Hinweis: Wenn 2 Zahlenwerte angegeben sind, sind diese Minimum und Maximum, bei drei Werten sind es Minimum, Mittelwert und Maximum.

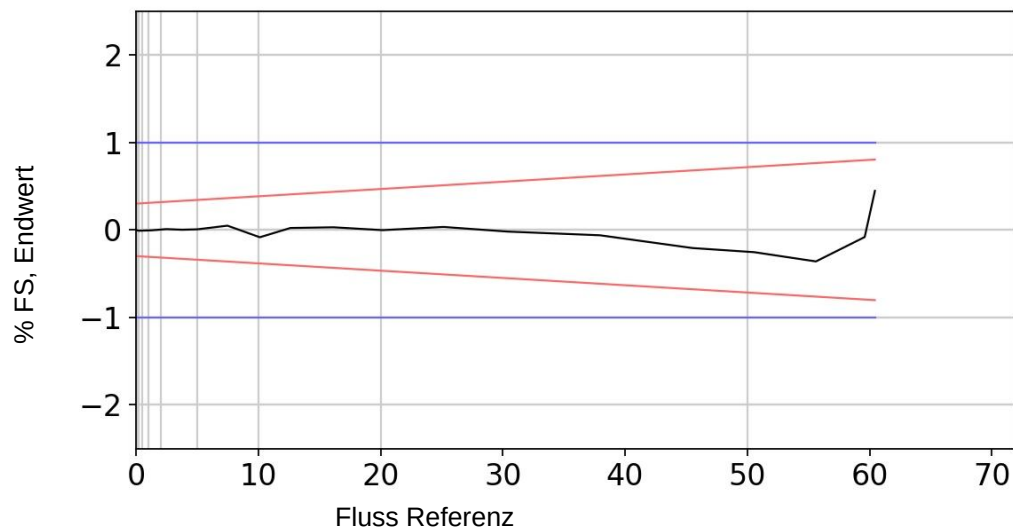


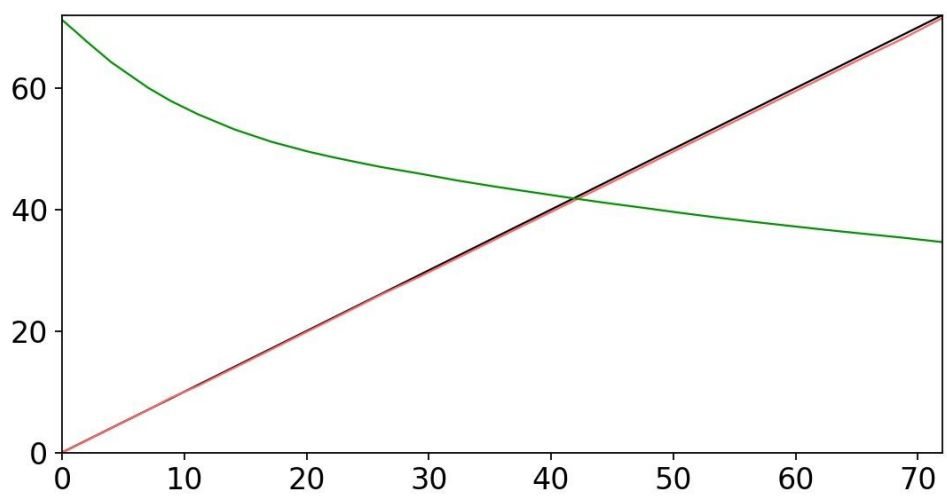


Lauf 1
 Sollwert
 Ref.Wert
 Rohwert normalisiert

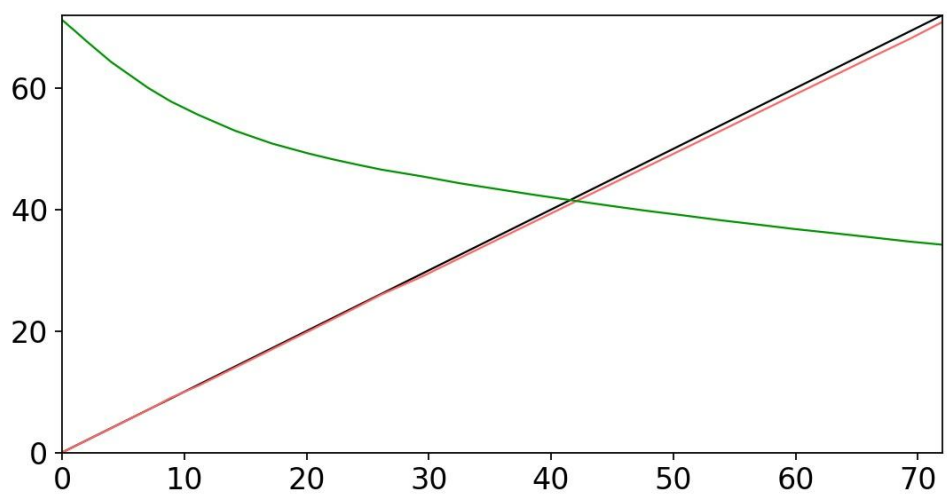

Lauf 2

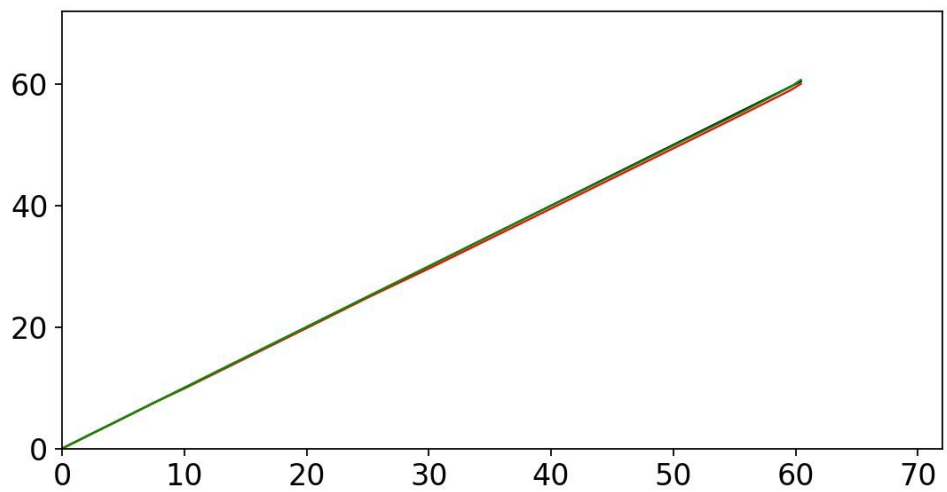

Verifikationslauf
 f DUP

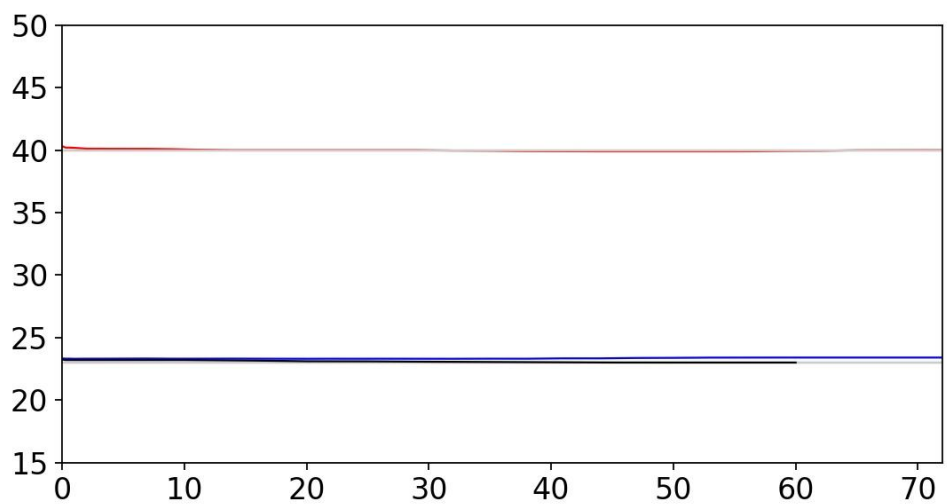

Plattentemperatur
 23 C Lauf
 40 C Lauf
 Verifikationslauf