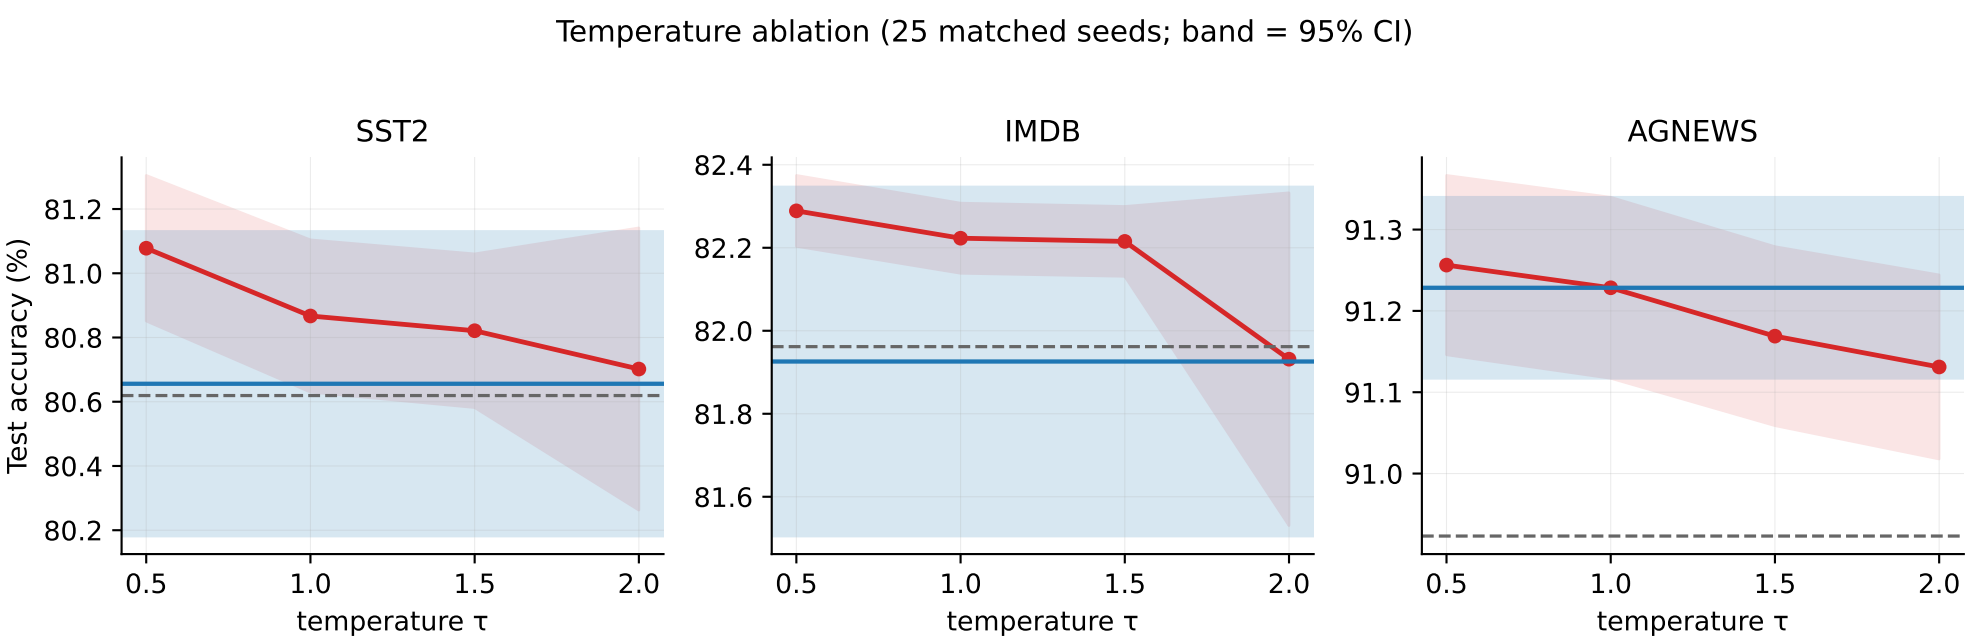
Temperature ablation (25 matched seeds; band = 95% CI)
SST2
IMDB
AGNEWS
Test accuracy (%)
81.2
81.0
80.8
80.6
80.4
80.2
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
91.3
91.2
91.1
91.0
0.5
1.0
1.5
2.0
temperature τ