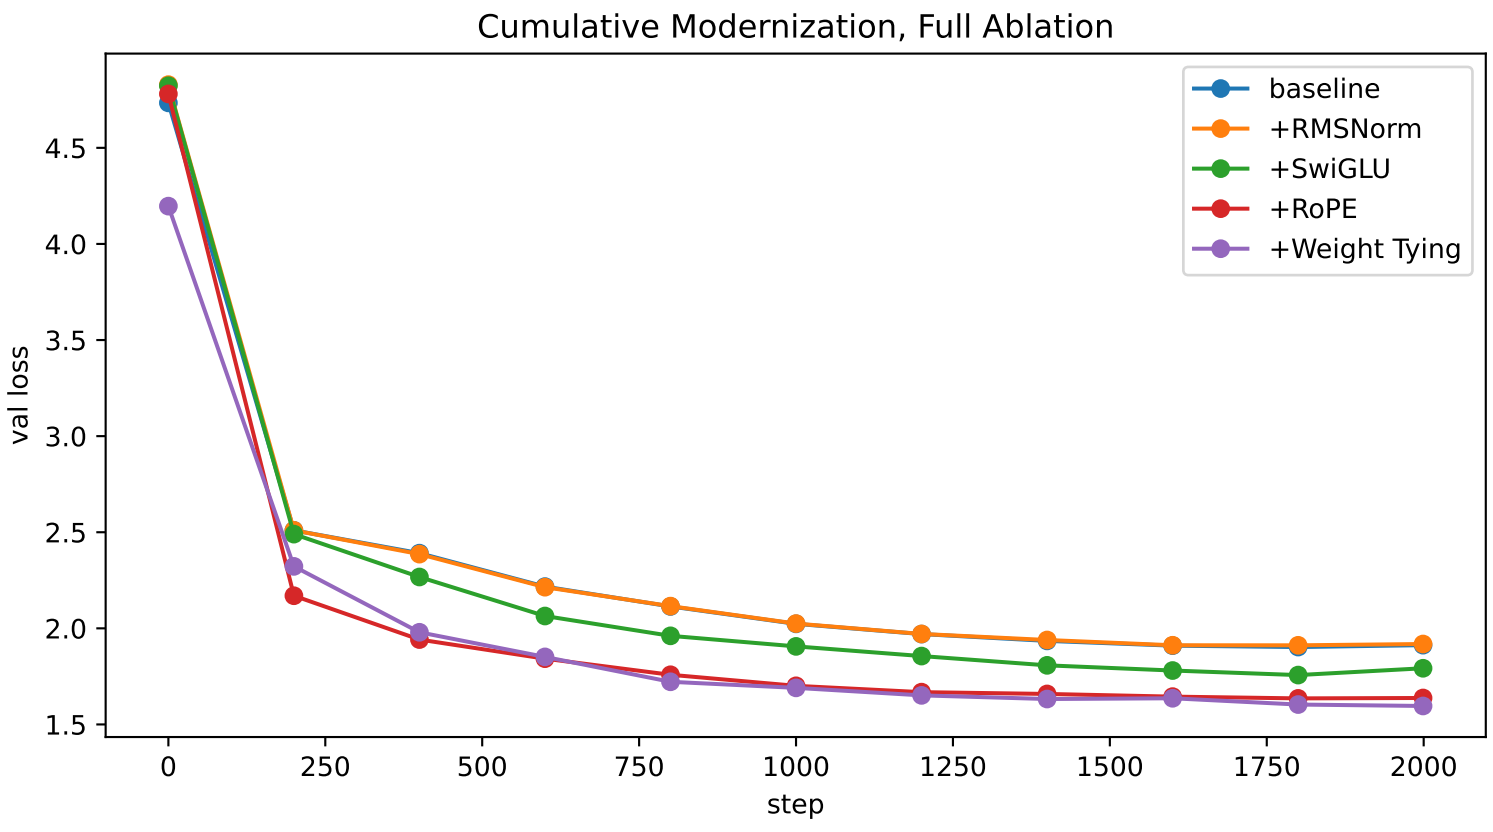
Cumulative Modernization, Full Ablation
baseline
+RMSNorm
+SwiGLU
+RoPE
+Weight Tying
val loss
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
step