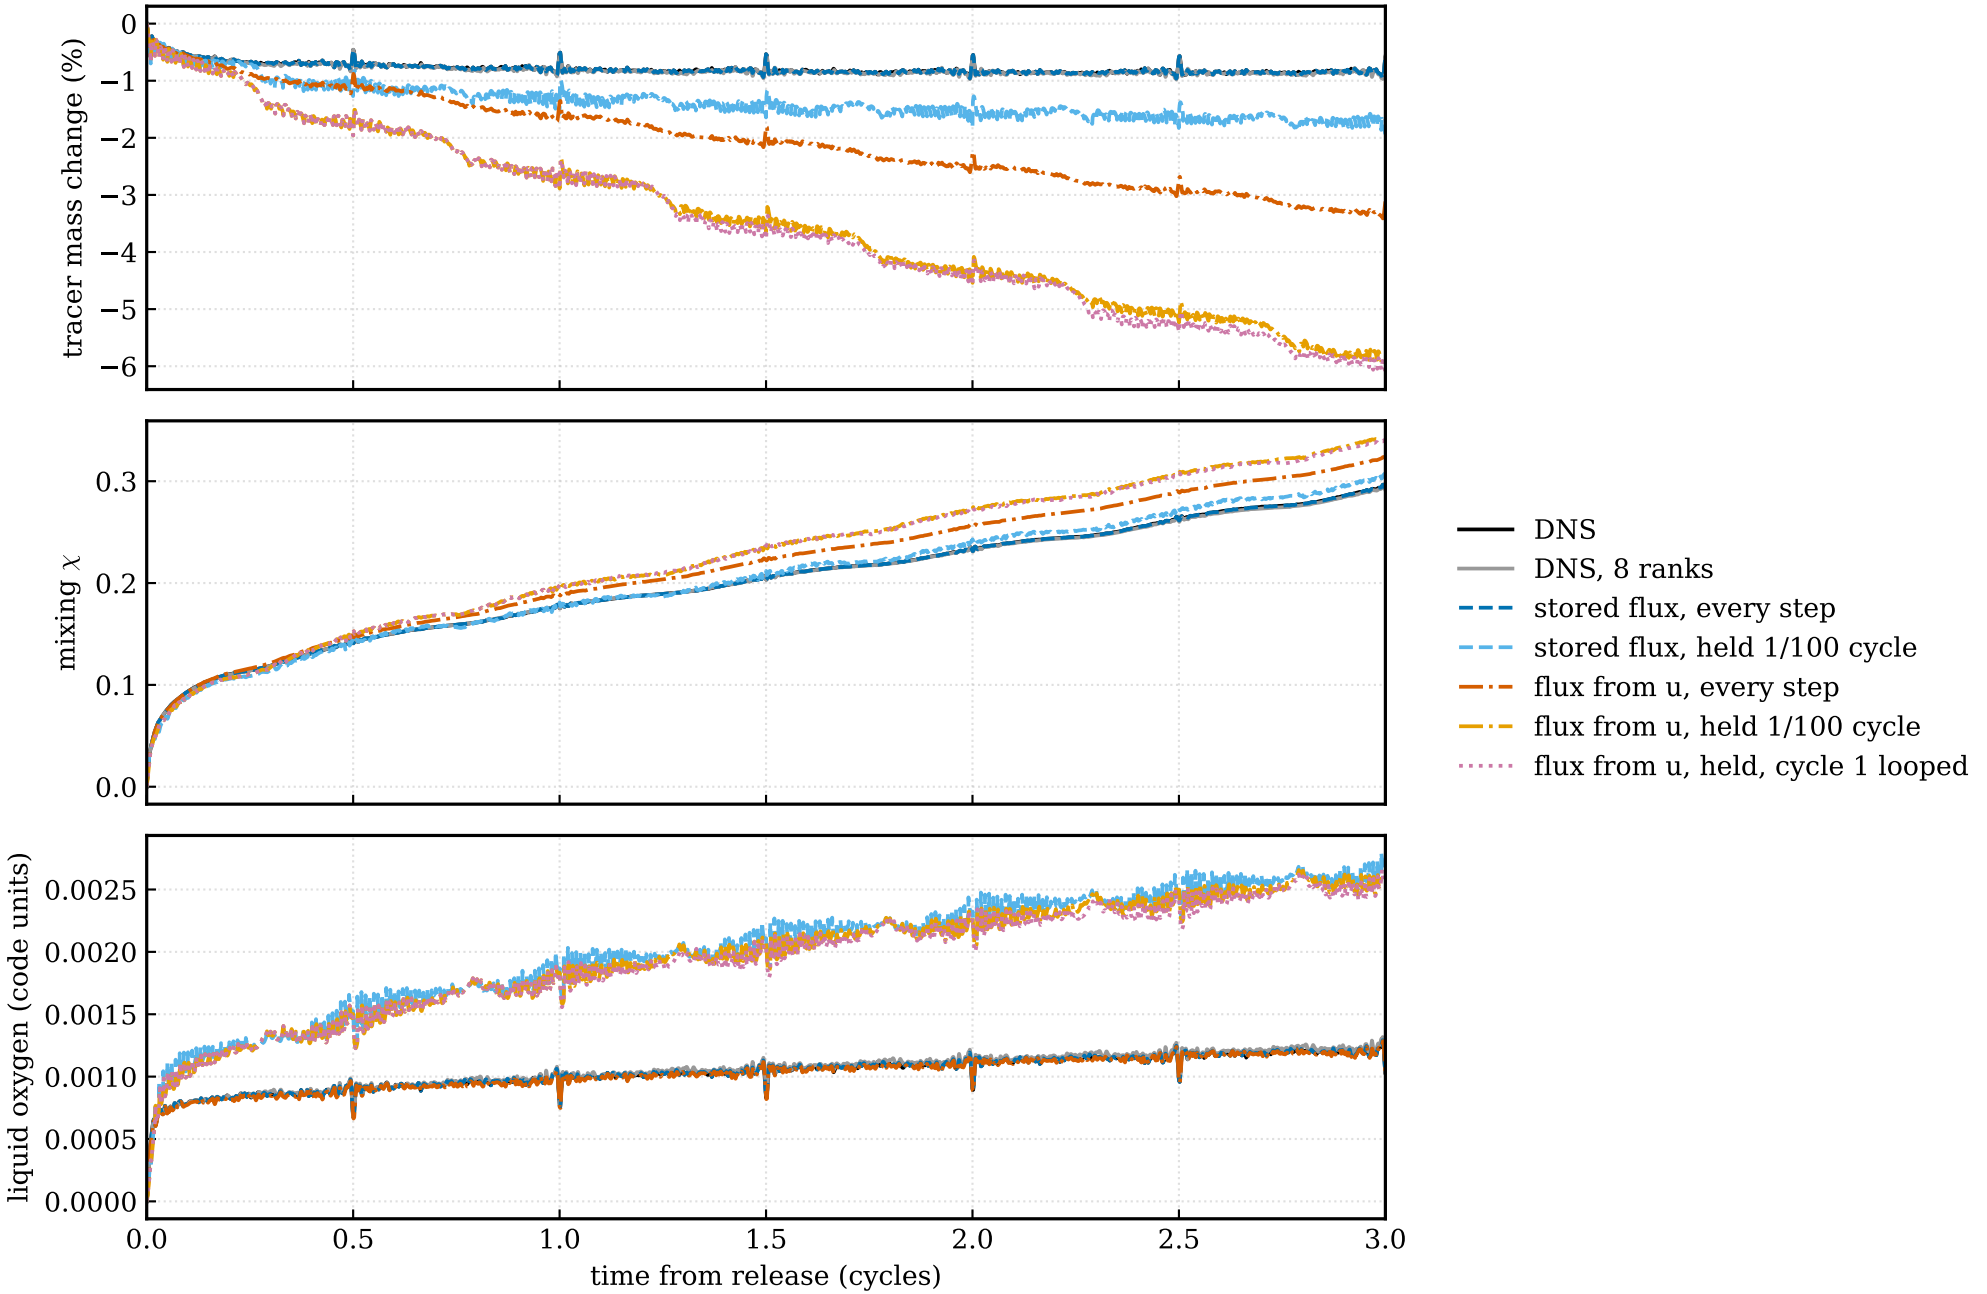

tracer mass change (%)
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
mixing χ
0.0
0.1
0.2
0.3
liquid oxygen (code units)
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
0.0025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
time from release (cycles)
DNS
DNS, 8 ranks
stored flux, every step
stored flux, held 1/100 cycle
flux from u, every step
flux from u, held 1/100 cycle
flux from u, held, cycle 1 looped