




DOC-0072242 verpresst Zieltarget.iam

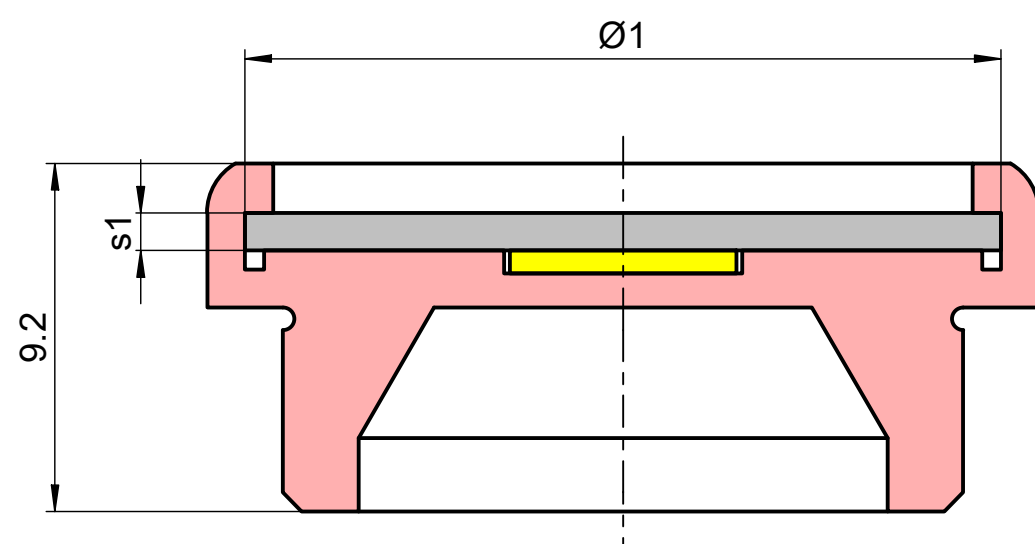


DOC-0072232 verpresst.iam

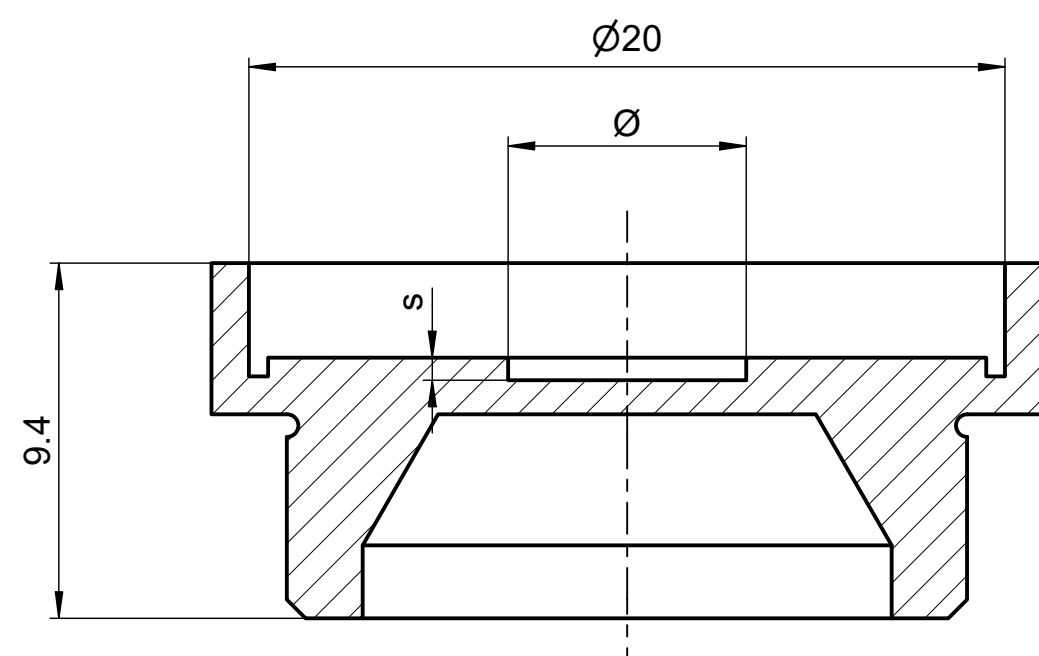


Targetkapsel mit Zieltarget für Target mit Diagnostikring



Targetkapselring				
Ø2	Ø3	s2	Zeichnung	Bemerkung
19.5	6.3	0.5	2015.07.22-01	
19.5	10.3	0.5	2019.02.26-01	
19.5	13.5	0.5	2016.11.02-02	Wasserstrahl
19.5	13.5	1	2016.11.02-01	Wasserstrahl
19.5	16.5	0.5	00101.25.739 A	Wasserstrahl
19.5	16.5	0.5	DOC-0072229	gelasert




Kapseldeckel			
Ø1	s1	Zeichnung	Bemerkung
20	0.5	00101.25.599 A	gedreht
20	1	00101.25.600 A	gedreht
20	1	10009.27.6695 C	gelasert
20	1	DOC-0072228	Zieltargetdeckel



Kapselboden			
Ø	s	Zeichnung	Bemerkung
6.3	0.5	2016.10.03-01	
6.3	0.6	DOC-0072224	
6.3	1	2017.05.18-1	
20	0	00101.25.1411	für Targetkapselring

Lieferant
Lasercut AG
Im Neuegg 3
8344 Bäretswil

Lieferant
Spalinger Präzisionsmechanik GmbH
Fohlochstrasse 5b
8460 Marthalen

Pos.	Menge	Dimension	Material	Benennung / Merkmale		
Ersatz für			Massstab 5:1	Gezeichnet	14.6.2024	GR22
Stüchl. Nr.				Geprüft		
Zusammenst.Nr.				Archiviert		
Anlage	Isotopenproduktion / Injektor II - IP II				<div>PAUL SCHERRER INSTITUT</div> <div></div>	
Bau- gruppe	Targetkapsel					
Titel	Targetkapseln Übersicht				Zeichnungs-Nr. DOC-0072232	