
FICHA 15

Medidor Coriolis

Mede massa diretamente a partir da torção de tubos vibrando.

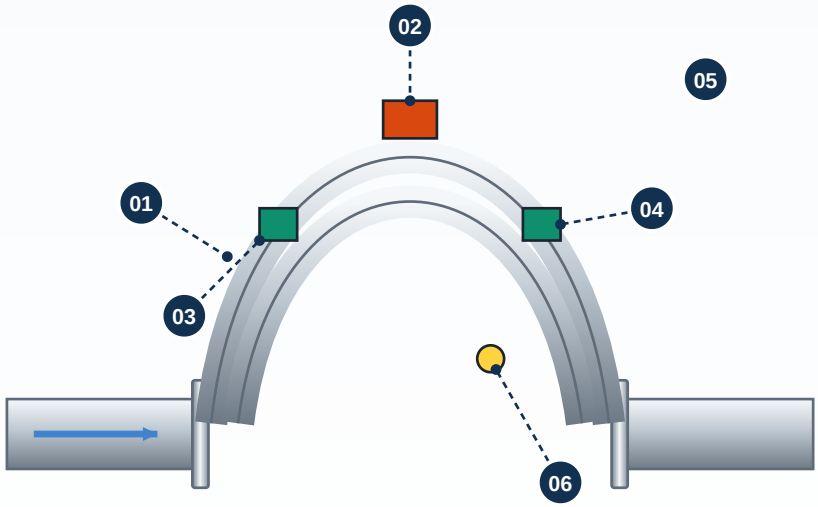

01 Tubos de medição
Vibram na frequência natural.

02 Bobina excitadora
Mantém a vibração dos tubos.

03 Sensor de entrada
Pick-off que lê o movimento no lado da entrada.

04 Sensor de saída
A defasagem entre os sensores é proporcional à vazão mássica.

05 Frequência
Varia com a densidade do fluido.

06 RTD
Mede a temperatura para compensar o tubo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vazão mássica	12 000 kg/h
Densidade	800 kg/m³
Volumétrica	15 m³/h
Exatidão típica	±0,1 %

CADEIA FUNCIONAL

Fluxo → Tubos torcem → Defasagem → kg/h

ATENÇÃO
Gás arrastado no líquido e vibração da tubulação prejudicam a medição.

PONTO-CHAVE
Mede massa direto, sem compensar pressão e temperatura.