


Title	: IMG1
Instrument	: 6510 (LA)
Volt	: 15.00 kV
Mag.	: x 1,000
Date	: 2023/12/23
Pixel	: 1024 x 768

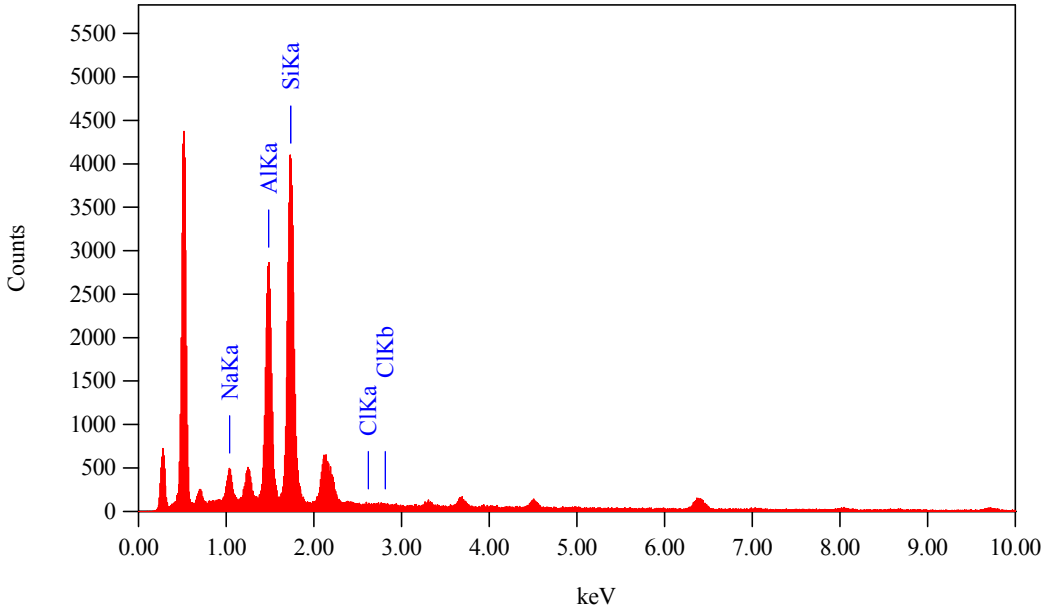

Acquisition Parameter	
Instrument	: 6510 (LA)
Acc. Voltage	: 15.0 kV
Probe Current	: 1.00000 nA
PHA mode	: T3
Real Time	: 51.53 sec
Live Time	: 50.00 sec
Dead Time	: 2 %
Counting Rate	: 3478 cps
Energy Range	: 0 - 20 keV

ZAF Method Standardless Quantitative Analysis							
Fitting Coefficient : 0.5951							
Element	(keV)	Mass%	Sigma	Atom%	Compound	Mass%	Cation K
Na K	1.041	4.41	0.11	5.27			5.9862
Al K	1.486	31.10	0.28	31.68			35.4136
Si K	1.739	64.21	0.47	62.83			58.3497
Cl K*	2.621	0.28	0.08	0.22			0.2506
Total		100.00		100.00			