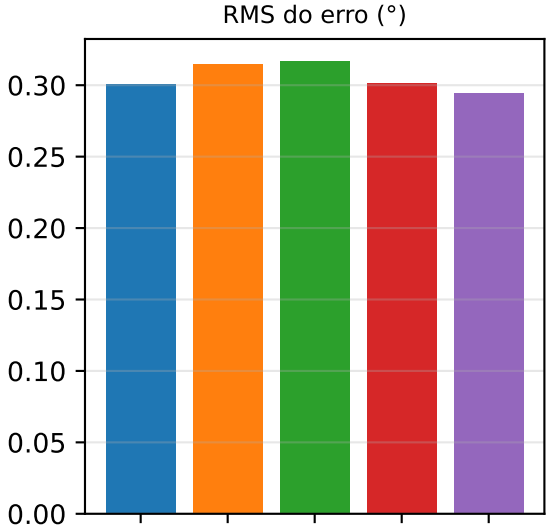
RMS do erro (°)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
T1
T2
T3
T4
T5

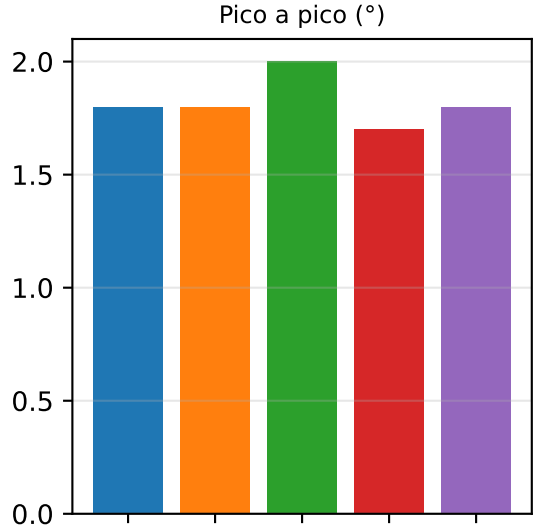
Pico a pico (°)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
T1
T2
T3
T4
T5

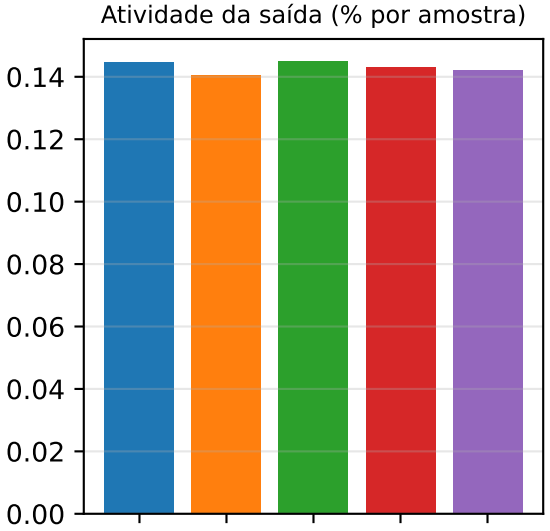
Atividade da saída (% por amostra)
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
T1
T2
T3
T4
T5