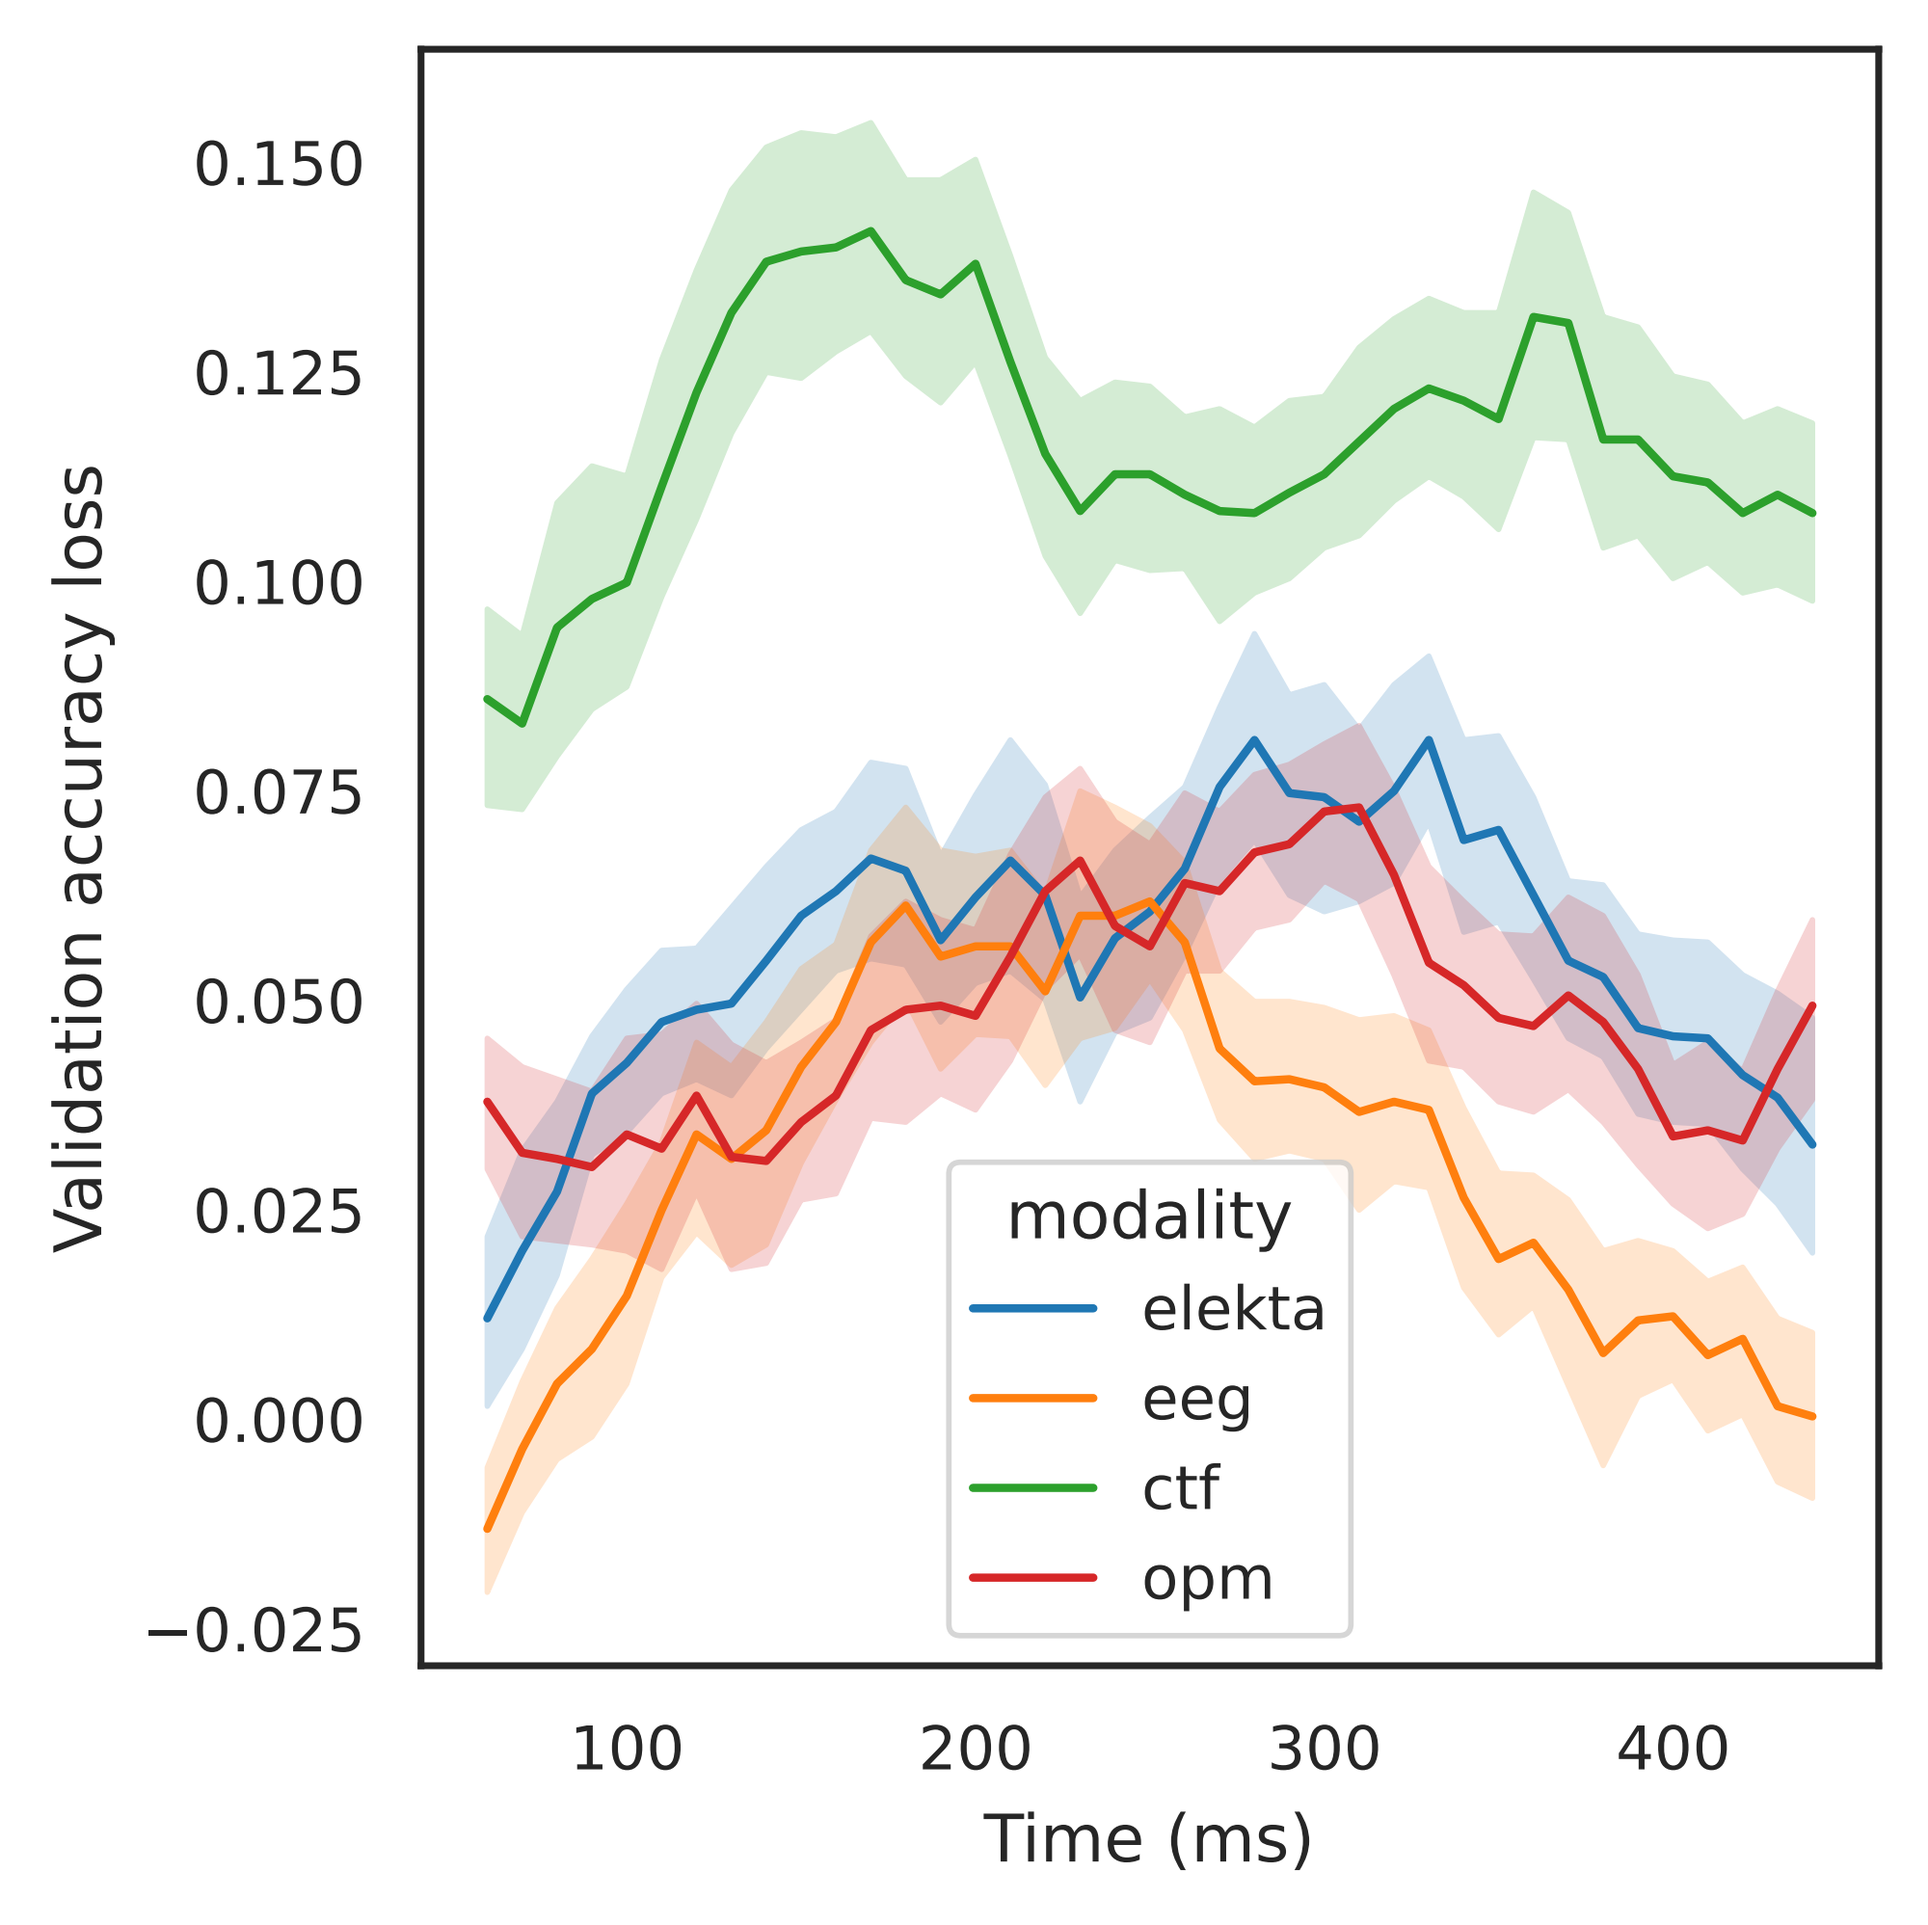
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
Validation accuracy loss
100
200
300
400
Time (ms)
modality
elekta
eeg
ctf
opm