Seit ich die t:slim X2 mit Control-IQ benutze, konnte ich meine Time in Range" (Zeit im Zielbereich) deutlich verbessern. In gewissen Situationen muss ich mir weniger Gedanken um meinen Diabetes machen, das ist für mich ein Gewinn an Lebensqualität!




Die clevere Insulinpumpe mit Control-IQ Technologie

Vorhersage und Hilfe bei der Prävention von Hypoglykämien ganz ohne Fingerstechen. Falls Glukose-Alarme und CGM-Werte nicht mit den Symptomen oder Erwartungen übereinstimmen, sollten Blutzuckermesswerte genutzt werden, um Therapieentscheidungen bei Diabetes zu treffen.




MEHR ÜBER DIE T:SLIM X2

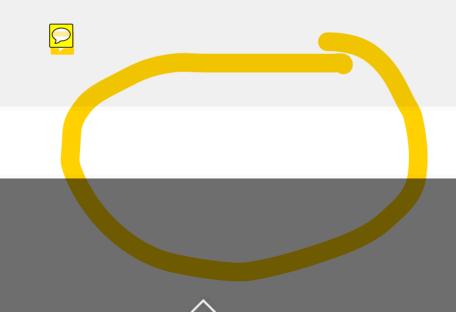



Van den comice Uilfe 0 Occupant Felature

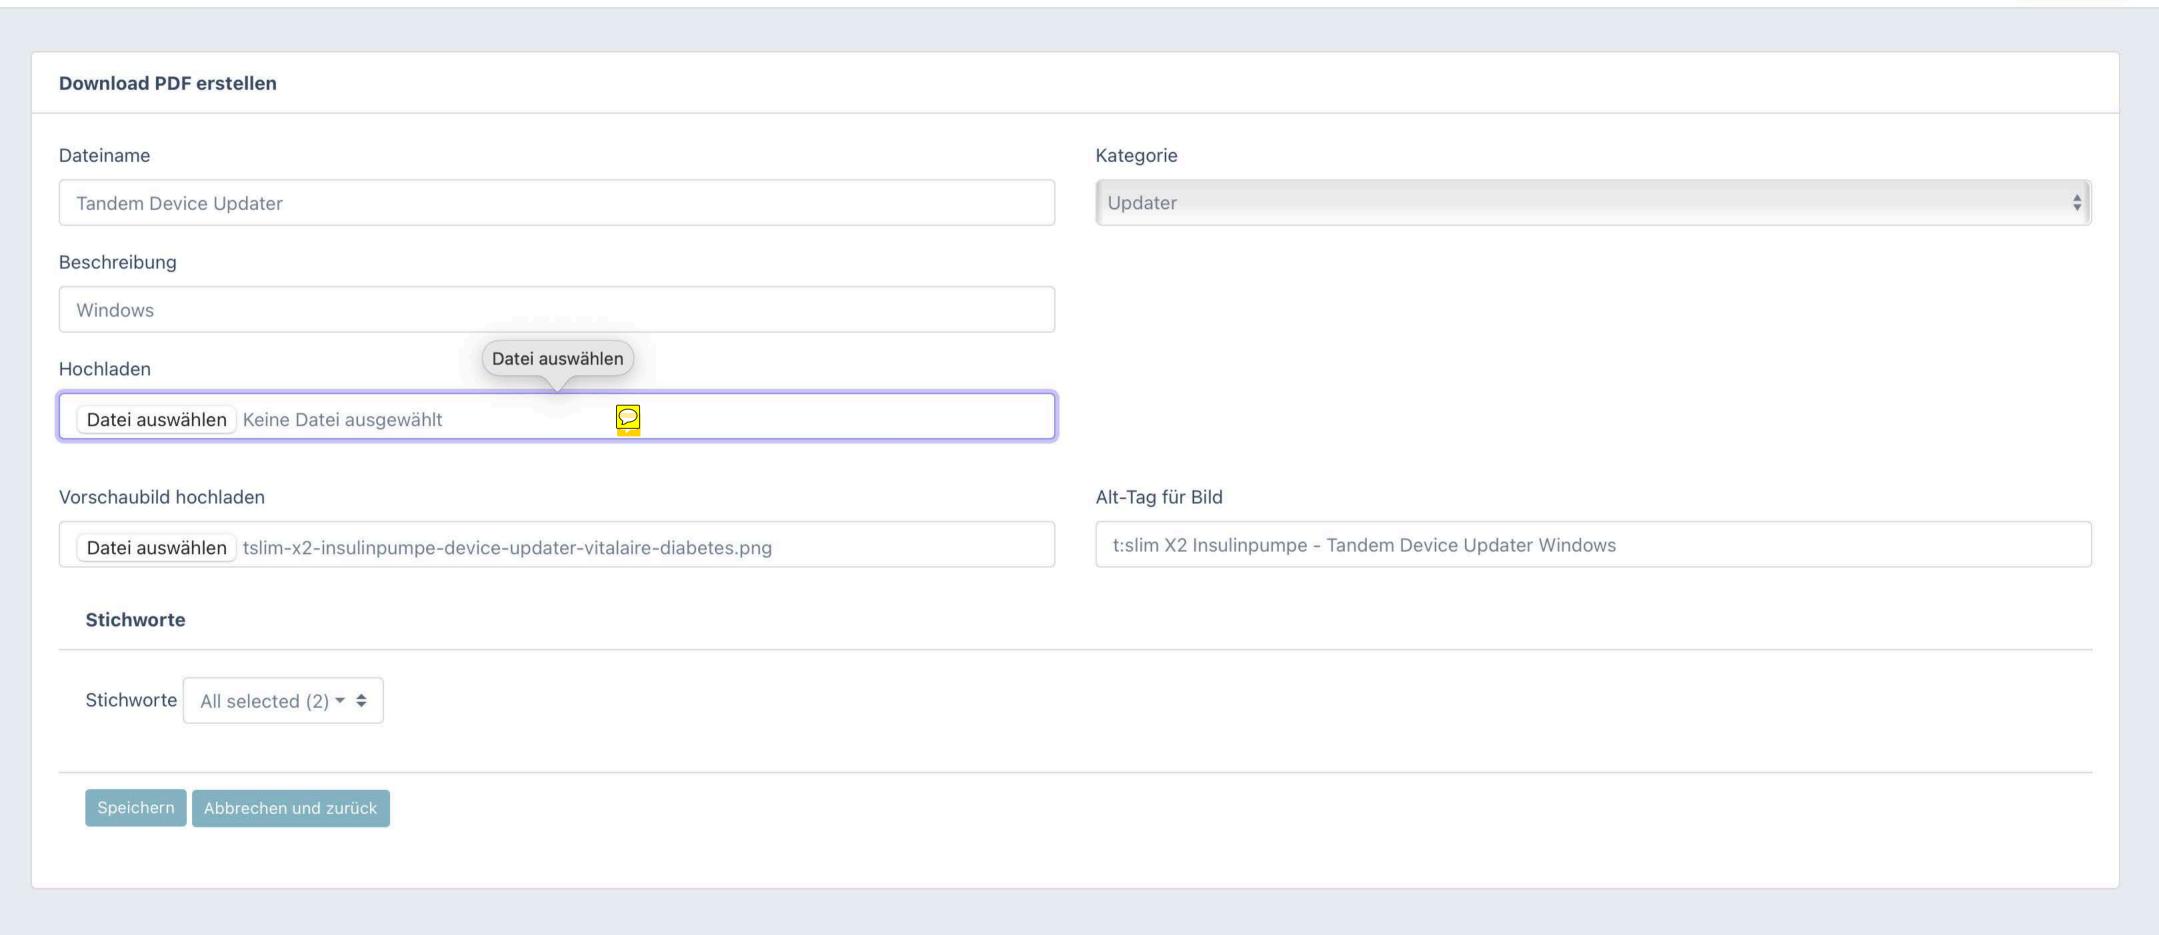

Q

» Blog

VitalAire Diabetes Blog zur t:slim X2 Insulinpumpe

De peleseq uaepelitis reculpa rumendit volorercimtem es etusam, quo bea

De peleseq uaepelitis reculpa rumendit volorercimet re licid erfero tem es etusam, quo beaDa senimusdam, santur sandelitam et omniatem repudit vel iur as elescium cum eri sinimus antur, atist assimus eos elent officip isciandunt, sin prent quundam que imolupt atistin nihit, quibus ero corercim fugit aces mi, ut facepudam alitem nis et lani ipit aut fugitas sectur sam ducitem hitatisquod mo omni odissit, quunt ut abo. Xima cus eos voluptiur alicides et dis aliquam, sint tiumquia voluptat erspe ent.



Blog-Artikel durchsuchen




Otatusti osaperitiunt od mi, il elessit ionseque laborpo reprate

Ibus con porepudis nemporrum adisqui odit, vellautet exeriam remque labore rerfere

von Maximilian Mustermann

secus, escid quiam, eum aces moluptatem nonsendi il modistrum res suntibea voloritis maxim dolupta quibus aut quid que et et el-

ARTIKEL LESEN

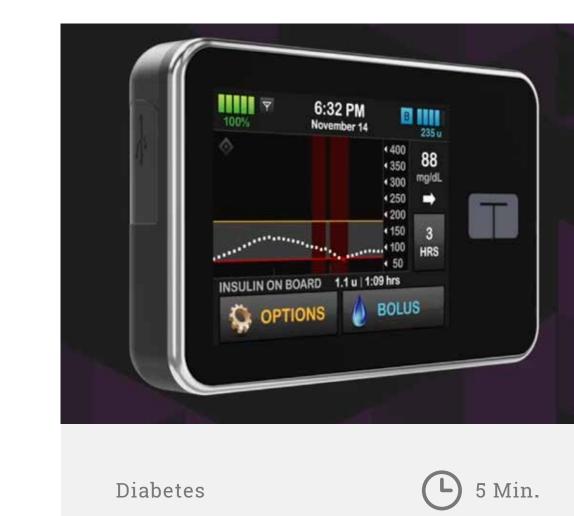


Otatusti osaperitiunt od mi, il elessit ionseque laborpo reprate

von Maximilian Mustermann Ibus con porepudis nemporrum adisqui odit, vellautet exeriam remque labore rerfere

secus, escid quiam, eum aces moluptatem nonsendi il modistrum res suntibea voloritis maxim dolupta quibus aut quid que et et el-

ARTIKEL LESEN

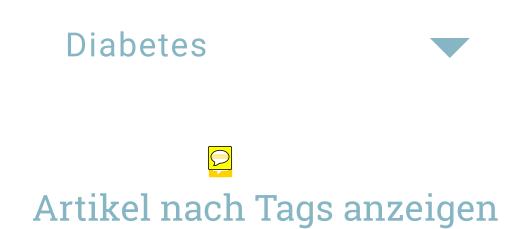

Nach Kategorie anzeigen

Basal-IQ) (Control-IQ) (Therapie Diabetes Tipps & Tricks

Otatusti osaperitiunt od mi, il elessit ionseque laborpo re-

prate

Otatusti osaperitiunt od mi, il

5 beliebtesten Artikel

2 elessit ionseque laborpo reprate Otatusti osaperitiunt od mi, il

elessit ionseque laborpo re-

prate

prate

- Otatusti osaperitiunt od mi, il 4 elessit ionseque laborpo re-
 - Otatusti osaperitiunt od mi, il elessit ionseque laborpo re-
- prate







Otatusti osa-

peritiunt od mi, il

elessit ionseque

Diabetes

maxim dolupta quibus aut quid que et et el-

5 Min.

ARTIKEL LESEN




Otatusti osa-

peritiunt od mi, il

Diabetes

ARTIKEL LESEN

5 Min.

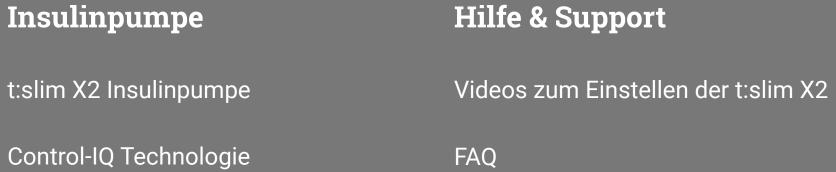

VitalAire

Basal-IQ Technologie Integration rtCGM Anwendung diasend by glooko Verbrauchsmaterialien & Zubehör

anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc.

© 2021 VitalAire GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kundenservice

0800/100 16 44*

*kostenlos aus dem deutschen Festznetz

+49 (0)421/48 63 18 63

*kostenlos aus dem deutschen Festznetz

diabetes@vitalaire.de

VitalAire GmbH

Mühleweg 5/1

Postadresse für Rezepte

Niederlassung Stuttgart

- Bereich Diabetes -

72800 Eningen u.A.

0800/884 78 63

24-Stunden-Hotline aus dem Ausland

Shop

FAQ Kontaktformular Downloads



Folgt uns auf





Datenschutz

Impressum

Insulinpumpe t:slim X2 Insulinpumpe

Medien

Newsletter


* Wenn Glukosewarnungen und CGM-Werte nicht zu den Symptomen oder Erwartungen passen, verwenden Sie für Entscheidungen zur Diabetesbehandlung ein Blutzuckermessgerät! Systeme wie die t:slim X2 Insulinpumpe mit Basal-IQ Technologie sind kein Ersatz für ein aktives Diabetes-Management, da es Situationen gibt, in denen auch automatische Systeme eine Hypoglykämie nicht verhindern können. Die Basal-IQ Funktion basiert auf kontinuierlichen CGM-Messwerten und kann weder den Glukosespiegel vorhersagen noch die Insulinabgabe unterbrechen, wenn das CGM nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nicht mit der Pumpe kommunizieren kann. 1. Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA, Pinsker JE, et al. Predictive low-glucose suspend reduces hypoglycemia in adults, adolescents, and children with type 1 diabetes in an at-home randomized crossover study: Results of the PROLOG trial. Diabetes Care. 2019;41(10):2155-2161. doi:10.2337/dc18-0771. 2. Vallis M, Jones A, Pouwer. Managing hypoglycemia in diabetes may be more fear management than glucose management: a practical guide for diabetes care providers. Curr Diabetes Rev. 2014;10(6):364-70. 3. Beck RW, et al. The association of biochemical hypoglycemia with the subsequent risk of a severe hypoglycemic event: analysis of the DCCT data set. Diabetes Technol Ther. TANDEM® © Tandem Diabetes Care und Basal-IQ sind Marken von Tandem Diabetes Care, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. t:slim X2 und t:simulator sind Marken von Tandem Diabetes Care, Inc.

Dexcom und Dexcom G6 ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Dexcom, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und

Q

site mit.

diabetes@vitalaire.de

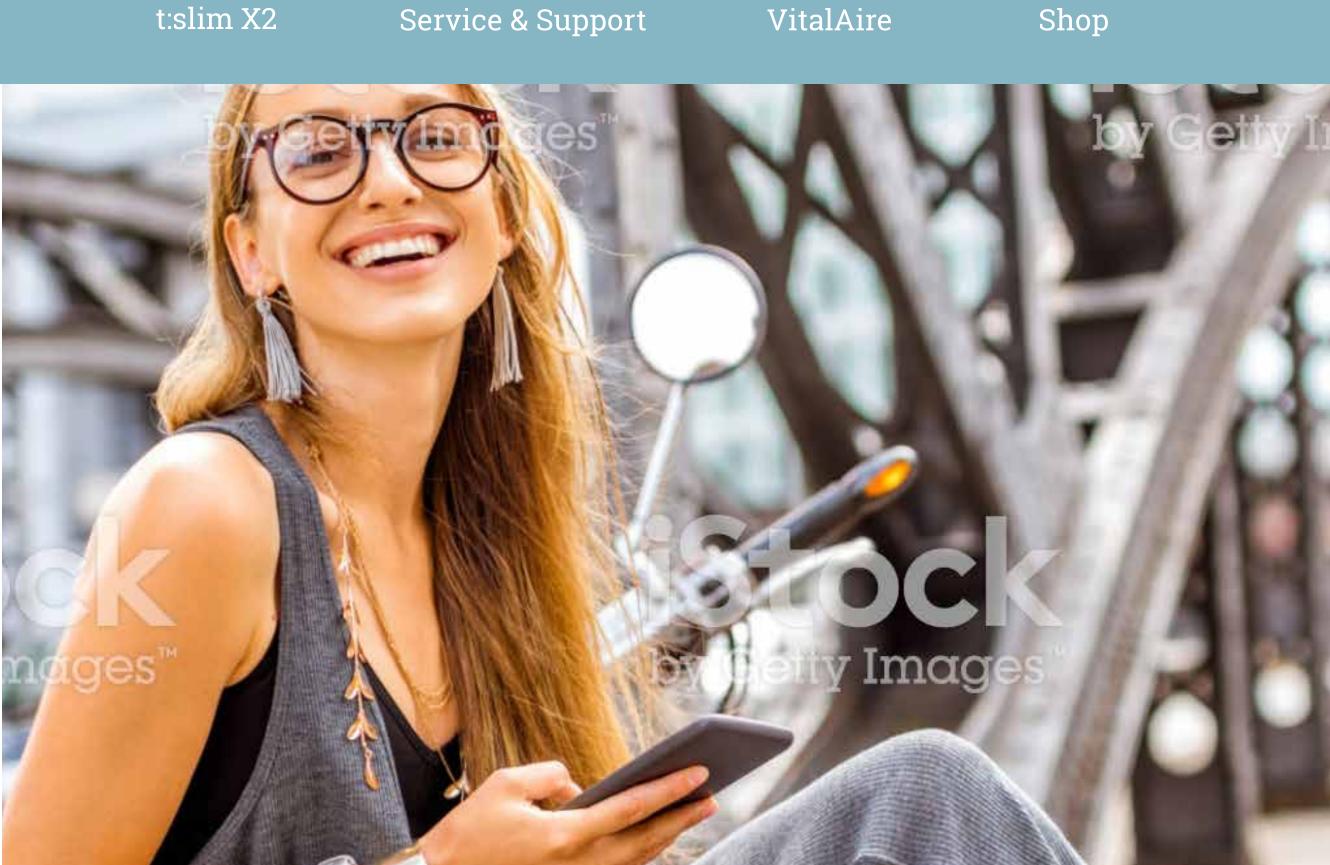

Kategoriename | 5 Min. Lesezeit

VitalAire Diabetes Blog zur t:slim X2 Insulinpumpe De peleseq uaepelitis reculpa rumendit volorercimtem es etusam, quo bea

De peleseq uaepelitis reculpa rumendit volorercimet re licid erfero tem es etusam, quo beaDa senimusdam, santur sandelitam et omniatem repudit vel iur as elescium cum eri sinimus antur, atist assimus eos elent officip isciandunt,

Lorum Ipsum

fugit aces mi, ut facepudam alitem nis et lani ipit aut fugitas sectur sam ducitem hitatisquod mo omni odissit, quunt ut abo. Xima cus eos voluptiur alicides et dis aliquam, sint tiumquia voluptat erspe ent. De peleseq uaepelitis reculpa rumendit volorercimet re licid erfe-

sin prent quundam que imolupt atistin nihit, quibus ero corercim

ro tem es etusam, quo beaDa senimusdam, santur sandelitam et omniatem repudit vel iur as elescium cum eri sinimus antur, atist assimus eos elent officip isciandunt, sin prent quundam que imolupt atistin nihit, quibus ero corercim fugit aces mi, ut facepudam alitem nis et lani ipit aut fugitas sectur sam ducitem hitatisquod mo omni odissit, quunt ut abo. Xima cus eos voluptiur alicides et dis aliquam, sint tiumquia voluptat erspe ent. De peleseq uaepelitis reculpa rumendit volorercimet re licid erfero tem es etusam, quo beaDa senimusdam, santur

 vel iur as elescium • cum eri sinimus antur, atist assimus eos

sandelitam et


omniatem repudit

- elent officip isciandunt, sin prent quundam que imolupt atistin nihit, quibus ero corercim fugit aces mi, ut facepudam alitem nis
- odissit, quunt ut abo. Xima cus eos voluptiur alicides et dis aliquam, sint tiumquia voluptat erspe ent. sinimus antur, atist assimus eos elent officip isciandunt, sin prent quundam que imolupt

et lani ipit aut fugitas sectur sam ducitem hitatisquod mo omni


atistin nihit, quibus ero corercim fugit aces mi, ut facepudam alitem nis et lani ipit aut fugitas sectur sam ducitem hitatisquod mo omni odissit, quunt ut abo. Xima cus eos voluptiur alicides et dis aliquam, sint tiumquia voluptat erspe ent.



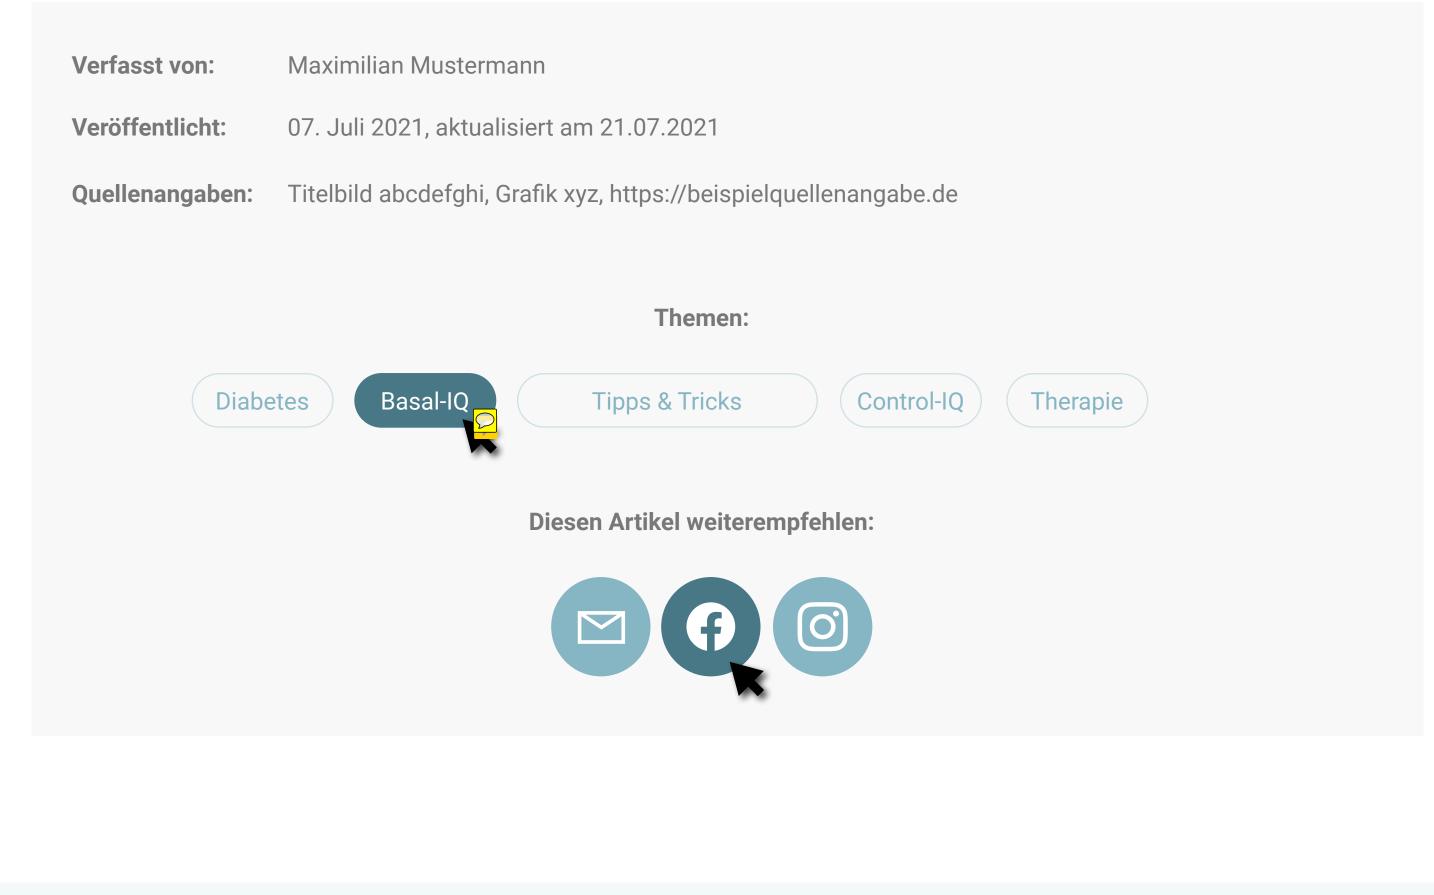

46

Hat dir dieser Artikel gefallen?





Artikel zu ähnlichen Themen



elessit ionseque laborpo reprate **ARTIKEL LESEN**



ARTIKEL LESEN

laborpo reprate



ARTIKEL LESEN

laborpo reprate



VitalAire



0800/100 16 44*

*kostenlos aus dem deutschen Festznetz

Kundenservice



Postadresse für Rezepte

*kostenlos aus dem deutschen Festznetz

VitalAire GmbH Niederlassung Stuttgart - Bereich Diabetes -Mühleweg 5/1 72800 Eningen u.A.

Integration rtCGM Anwendung diasend by glooko

t:slim X2 Insulinpumpe

Control-IQ Technologie


Basal-IQ Technologie

Verbrauchsmaterialien & Zubehör Shop

FAQ Kontaktformular Downloads

Videos zum Einstellen der t:slim X2

Hilfe & Support

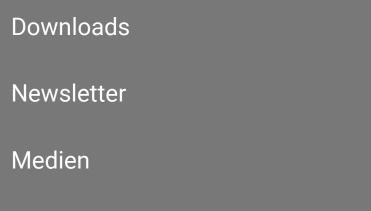

Folgt uns auf



* Wenn Glukosewarnungen und CGM-Werte nicht zu den Symptomen oder Erwartungen passen, verwenden Sie für Entscheidungen zur Diabetesbehandlung ein Blutzuckermessgerät! Systeme wie die t:slim X2 Insulinpumpe mit Basal-IQ Technologie sind kein Ersatz für ein aktives Diabetes-Management, da es Situationen gibt, in denen auch automatische Systeme eine Hypoglykämie nicht verhindern können. Die Basal-IQ Funktion basiert auf kontinuierlichen CGM-Messwerten und kann weder den Glukosespiegel vorhersagen noch die Insulinabgabe unterbrechen, wenn das CGM nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nicht mit der Pumpe kommunizieren kann. 1. Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA, Pinsker JE, et al. Predictive low-glucose suspend reduces hypoglycemia in adults, adolescents, and children with type 1 diabetes in an at-home randomized crossover study: Results of the PROLOG trial. Diabetes Care. 2019;41(10):2155-2161. doi:10.2337/dc18-0771. 2. Vallis M, Jones A, Pouwer. Managing hypoglycemia in diabetes may be more fear management than glucose management: a practical guide for diabetes care providers. Curr Diabetes Rev. 2014;10(6):364-70.

TANDEM® © Tandem Diabetes Care und Basal-IQ sind Marken von Tandem Diabetes Care, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. t:slim X2 und t:simulator sind Marken von Tandem Diabetes Care, Inc. Dexcom und Dexcom G6 ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Dexcom, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc.

© 2021 VitalAire GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Impressum

Datenschutz