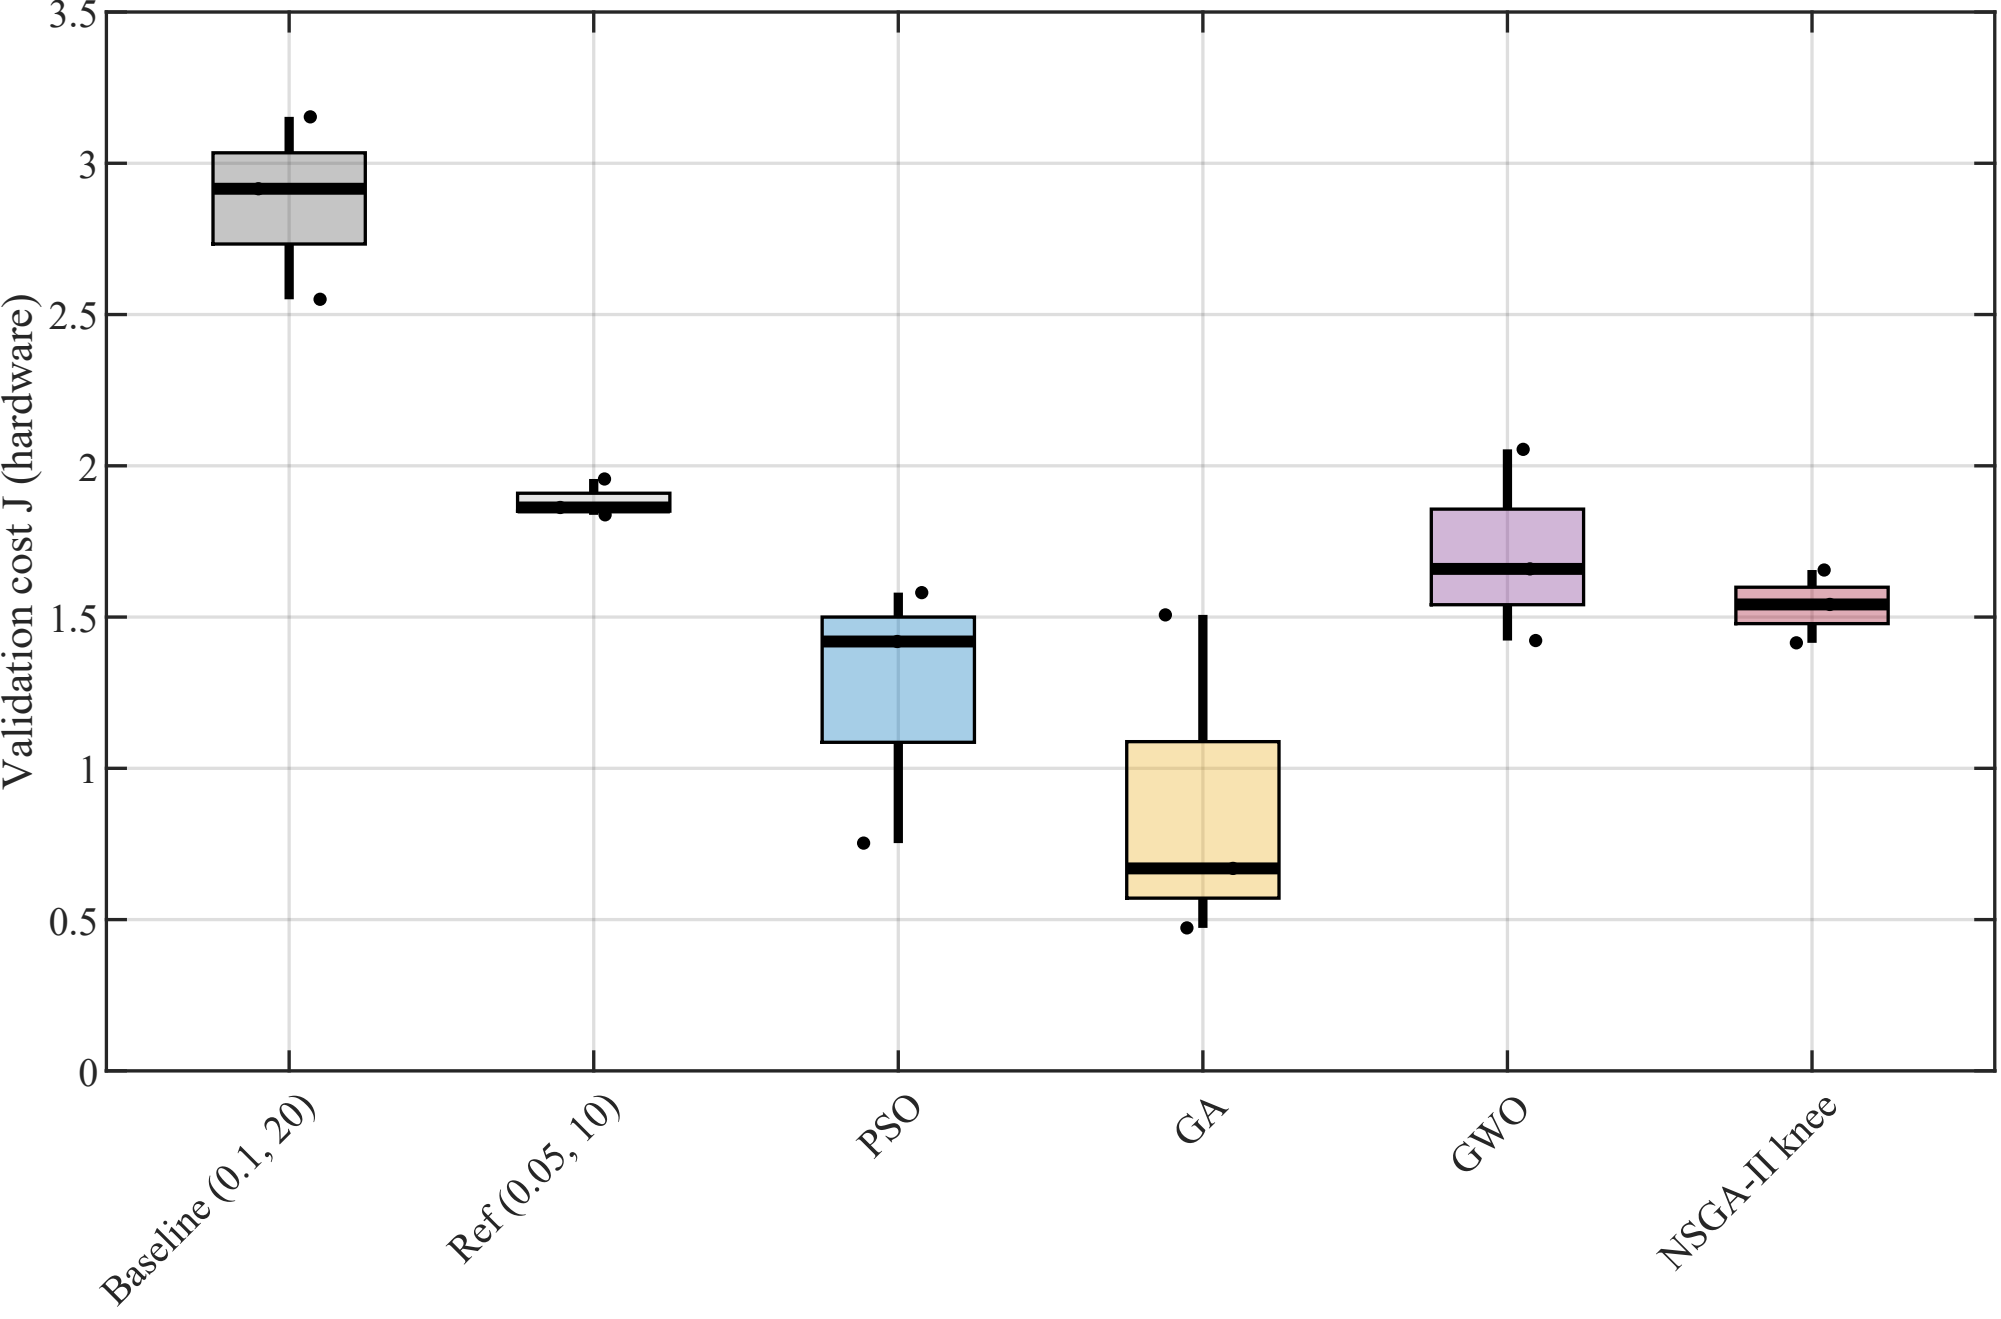
Validation cost J (hardware)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Baseline (0.1, 20)
Ref (0.05, 10)
PSO
GA
GWO
NSGA-II knee