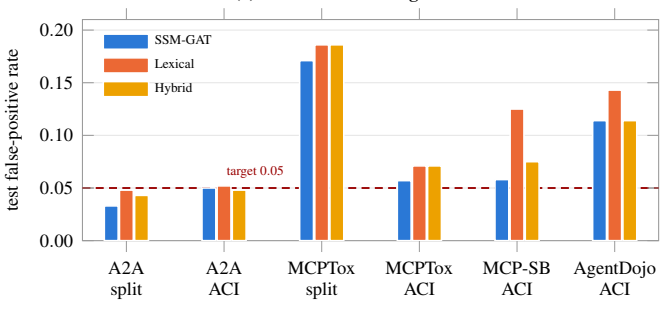
(a) False alarms at target $\alpha = 0.05$
test false-positive rate
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
SSM-GAT
Lexical
Hybrid
target 0.05
A2A split
A2A ACI
MCPTox split
MCPTox ACI
MCP-SB ACI
AgentDojo ACI

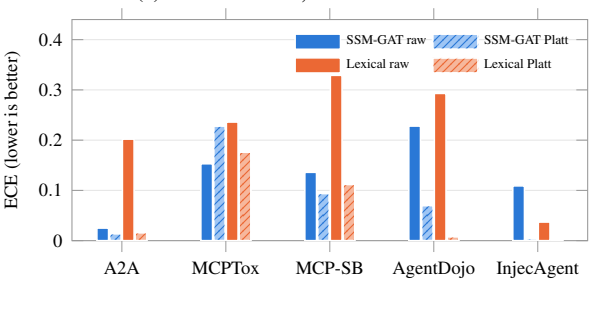
(b) Calibration error, raw and Platt-recalibrated
ECE (lower is better)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
SSM-GAT raw
SSM-GAT Platt
Lexical raw
Lexical Platt
A2A
MCPTox
MCP-SB
AgentDojo
InjecAgent