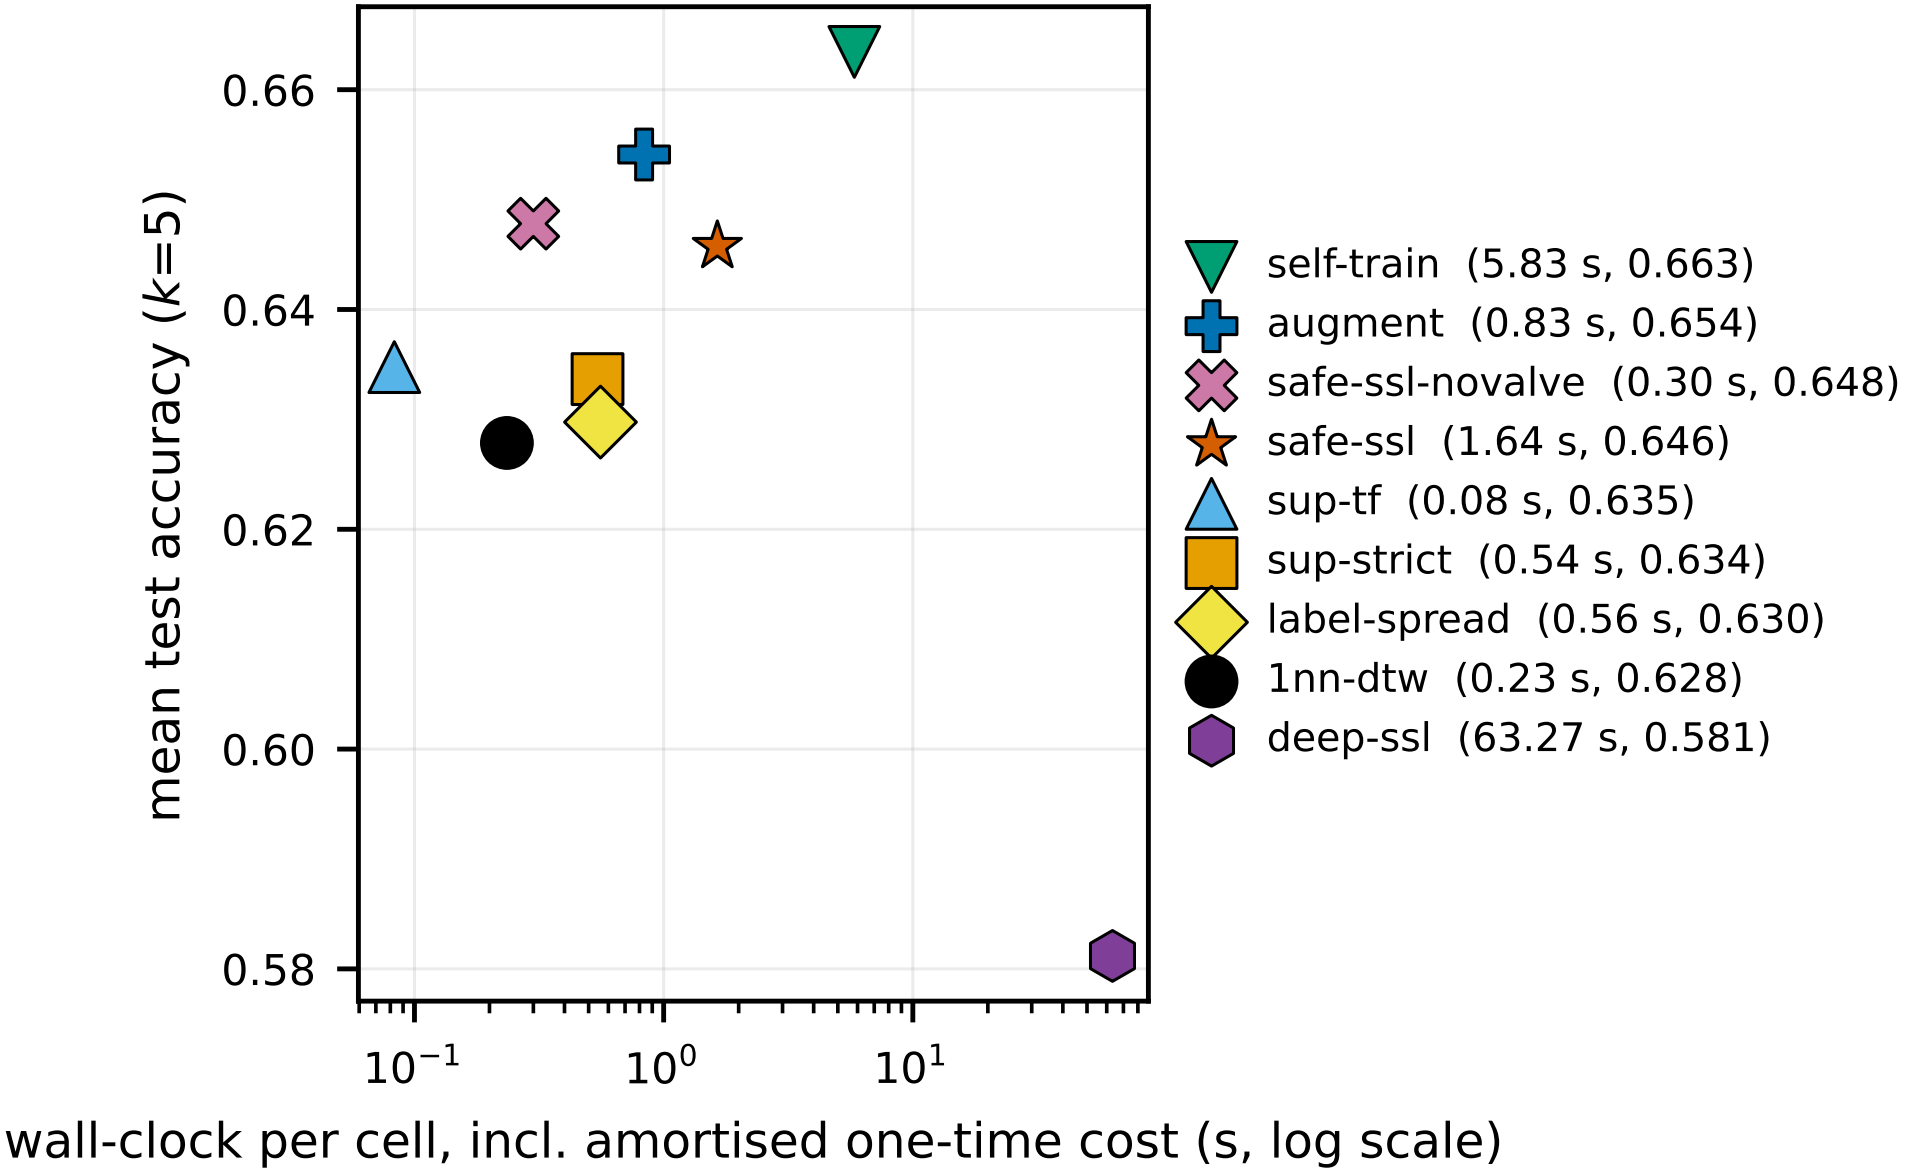
mean test accuracy (k=5)
0.66
0.64
0.62
0.60
0.58
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
wall-clock per cell, incl. amortised one-time cost (s, log scale)
self-train (5.83 s, 0.663)
augment (0.83 s, 0.654)
safe-ssl-novalve (0.30 s, 0.648)
safe-ssl (1.64 s, 0.646)
sup-tf (0.08 s, 0.635)
sup-strict (0.54 s, 0.634)
label-spread (0.56 s, 0.630)
1nn-dtw (0.23 s, 0.628)
deep-ssl (63.27 s, 0.581)