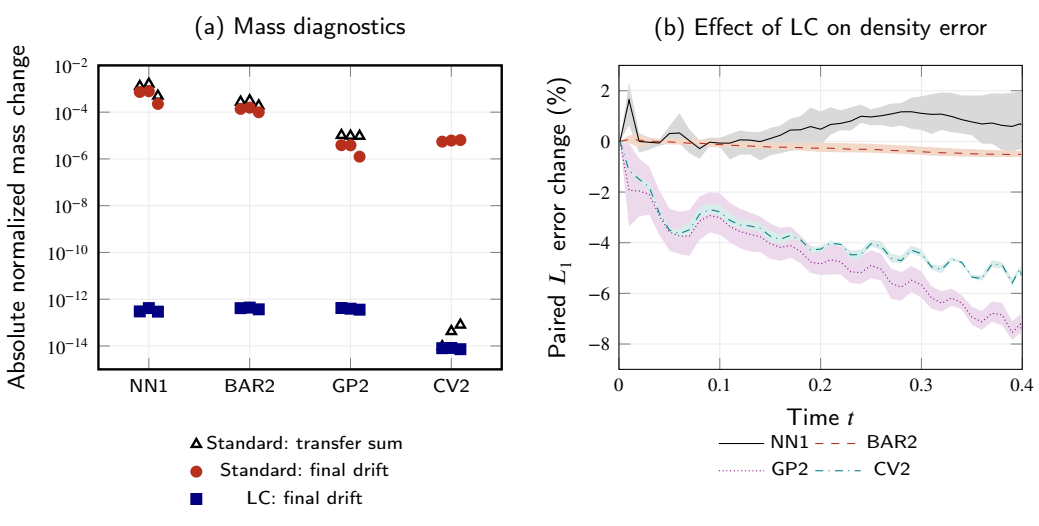
(a) Mass diagnostics
Absolute normalized mass change
$10^{-2}$
$10^{-4}$
$10^{-6}$
$10^{-8}$
$10^{-10}$
$10^{-12}$
$10^{-14}$
NN1
BAR2
GP2
CV2
Standard: transfer sum
Standard: final drift
LC: final drift
(b) Effect of LC on density error
Paired $L_1$ error change (%)
2
0
−2
−4
−6
−8
0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time $t$
NN1
BAR2
GP2
CV2