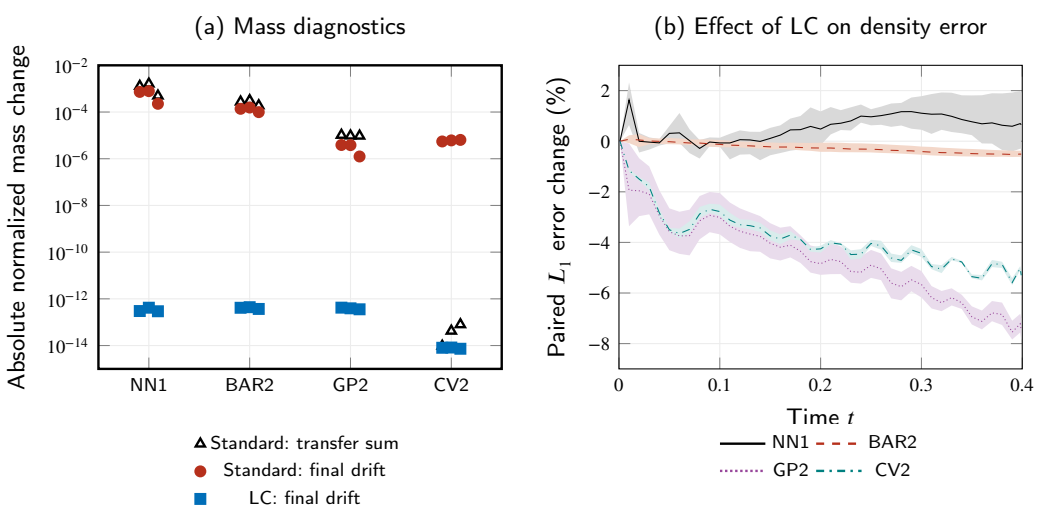
(a) Mass diagnostics
Absolute normalized mass change
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
NN1
BAR2
GP2
CV2
Standard: transfer sum
Standard: final drift
LC: final drift
(b) Effect of LC on density error
Paired L_1 error change (%)
2
0
−2
−4
−6
−8
0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time t
NN1
BAR2
GP2
CV2