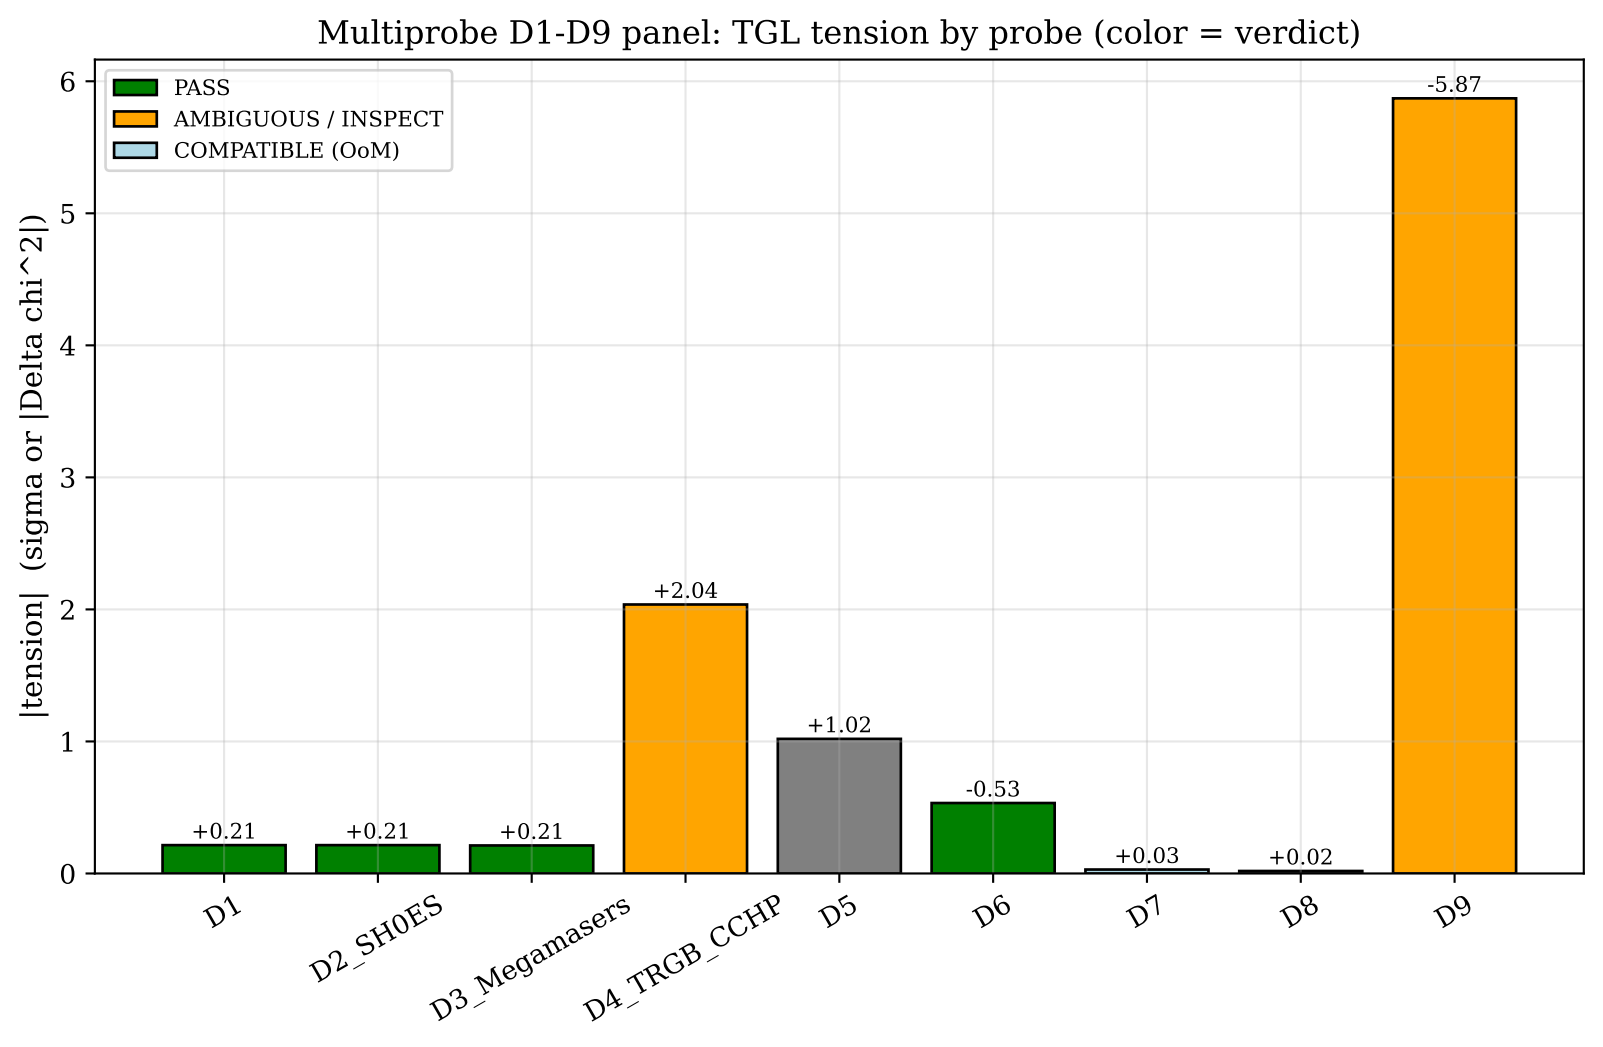
Multiprobe D1-D9 panel: TGL tension by probe (color = verdict)
PASS
AMBIGUOUS / INSPECT
COMPATIBLE (OoM)
|tension| (sigma or |Delta chi^2|)
0
1
2
3
4
5
6
+0.21
+0.21
+0.21
+2.04
+1.02
-0.53
+0.03
+0.02
-5.87
D1
D2_SH0ES
D3_Megamasers
D4_TRGB_CCHP
D5
D6
D7
D8
D9