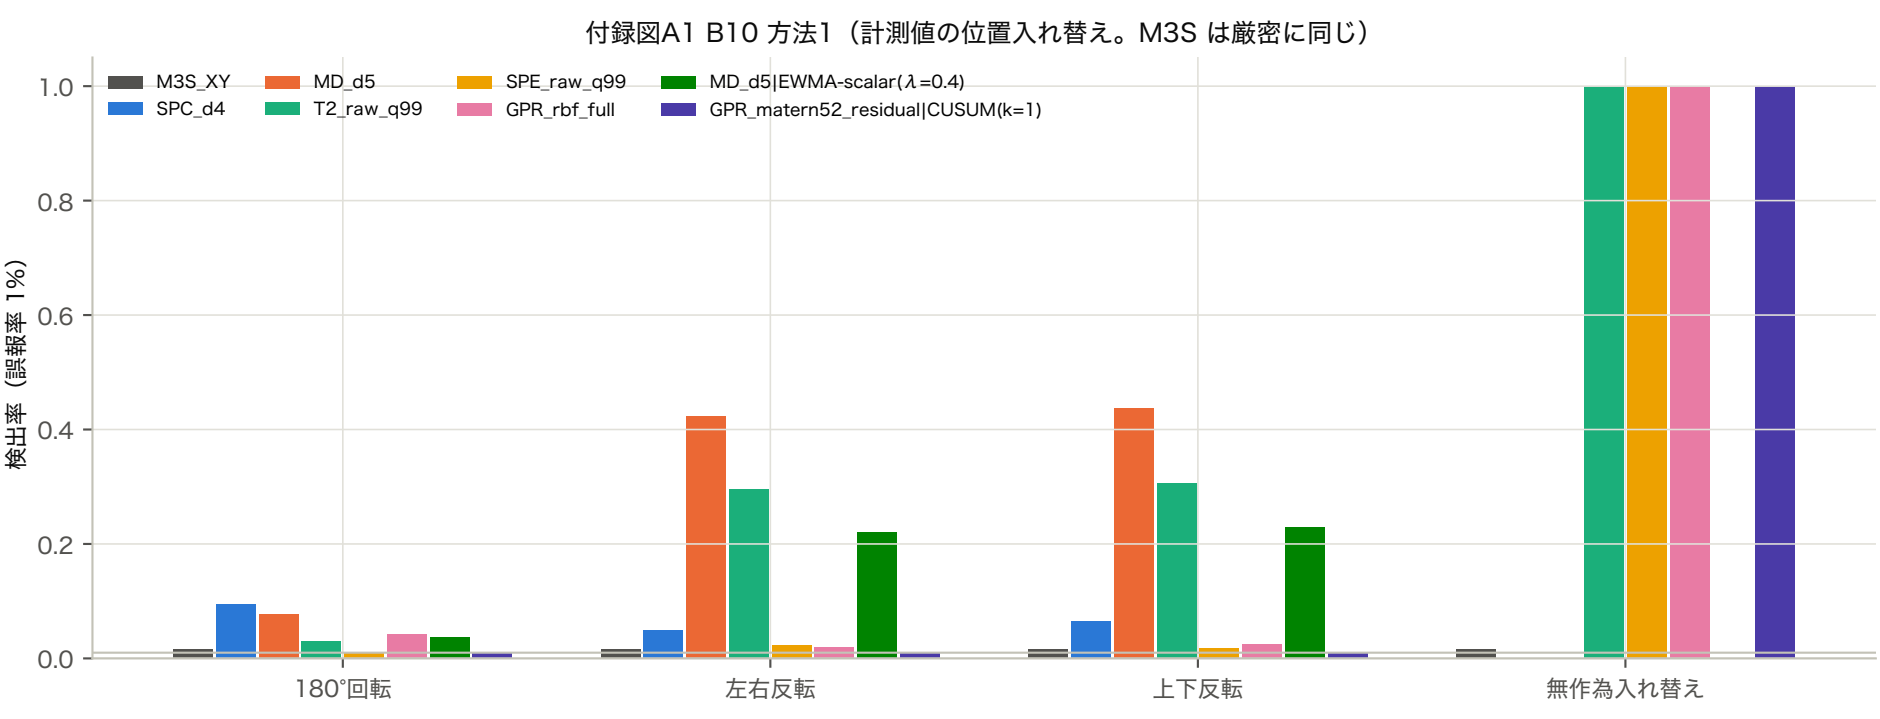
付録図A1 B10 方法1（計測値の位置入れ替え。M3S は厳密に同じ）
M3S_XY
SPC_d4
MD_d5
T2_raw_q99
SPE_raw_q99
GPR_rbf_full
MD_d5|EWMA-scalar(λ=0.4)
GPR_matern52_residual|CUSUM(k=1)
検出率（誤報率 1%）
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
180°回転
左右反転
上下反転
無作為入れ替え