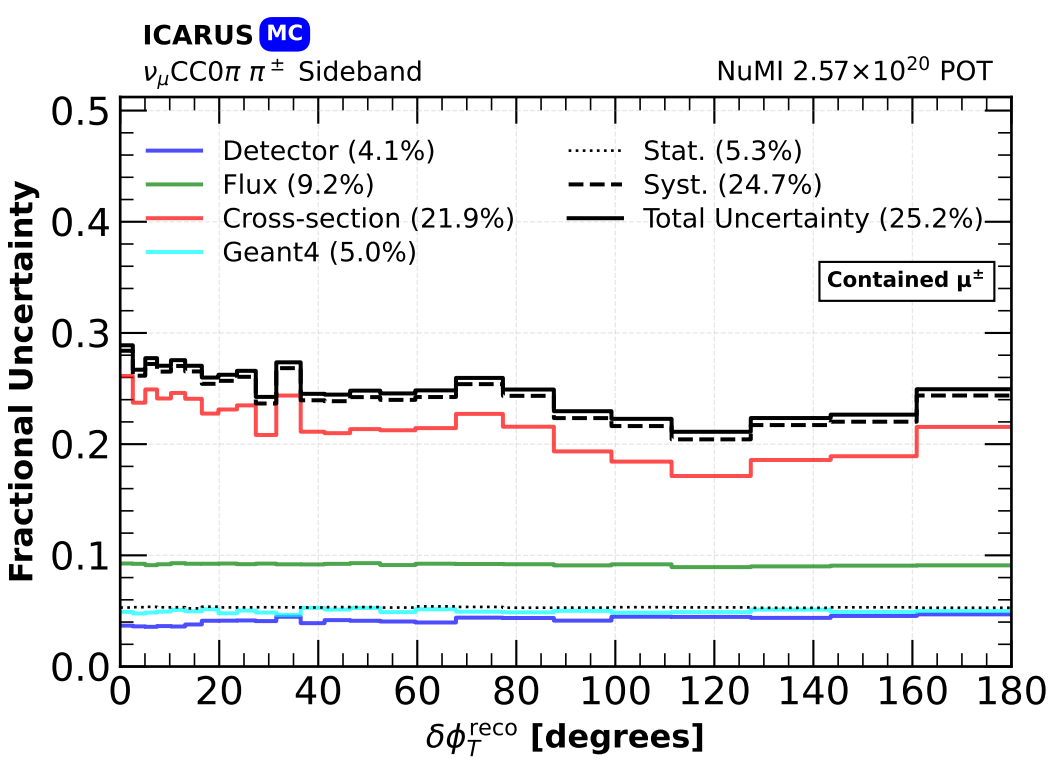
ICARUS MC
ν_μCC0π $\pi^\pm$ Sideband
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.1%)
Flux (9.2%)
Cross-section (21.9%)
Geant4 (5.0%)
Stat. (5.3%)
Syst. (24.7%)
Total Uncertainty (25.2%)
Contained μ$^\pm$
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]