

Praktikum V - Kern- und Teilchenphysik
Versuch 529 - Dosimetrie und Aufnahme eines
Computertomogramms

Tom Chelius und Alican Özcagi

04. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
2.1	Röntgenstrahlung	3
2.1.1	Erzeugung	3
2.2	Dosimetrische Messgrößen	4
2.2.1	Ionendosis	4
2.2.2	Ionendosisleistung	4
2.2.3	Äquivalentdosis	4
2.3	Messgeräte	4
2.3.1	Geiger-Müller-Zählrohr	5
2.3.2	Kondensator	6
2.3.3	Stabdosisimeter	6
2.4	Relevante Gesetze	6
2.4.1	Abstandsquadratgesetz	6
2.4.2	Lambertsches Strahlungsgesetz	7
2.5	Computertomographie	7
3	Durchführung	7
3.1	Dosimetrie	7
3.2	Abstandsquadratgesetz	9
3.3	Totzeit	10
3.4	Abschirmung	11
3.5	Computertomogramm	12
4	Auswertung	12
4.1	Dosimetrie	12
4.2	Abstandsquadratgesetz	19
4.3	Totzeit	20
4.4	Abschirmung	21
4.5	Computertomogramm	22
5	Fazit	22
6	Anhang	22
6.1	Messwerte	22
6.1.1	Dosimetrie	22
6.1.2	Abstand	26
6.1.3	Totzeit	27
6.1.4	Abschirmung	28
	Literatur	30

1 Einleitung

In dem Versuch 529 beschäftigen wir uns mit Röntgenstrahlung. Dabei wollen wir zuerst eine dosimetrische Größen anhand eines Röntgengerätes bestimmen: Dazu zählen die mittlere Ionendosisleistung und die Äquivalentdosis. Danach wird mit einem Stabdosisimeter das Abstandsquadratgesetz überprüft. Als nächstes wird ein Geiger-Müller-Zählrohr verwendet und dessen Totzeit bestimmt. Dann wird die Abschwächung der Strahlung durch Abschirmung gemessen und als letztes wird ein Computertomogramm eines Frosches gemacht.

2 Theorie

2.1 Röntgenstrahlung

Röntgenstrahlung ist eine hochenergetische Form elektromagnetischer Strahlung. Ihr Wellenlängenbereich reicht ungefähr von 1 nm am unteren Ende der Energie bis zu 1 pm am hochenergetischen Ende [5]. Röntgenstrahlung kann durch zwei verschiedene physikalische Prozesse entstehen. Wir unterteilen das Röntgenspektrum somit in das charakteristische und das kontinuierliche Röntgenspektrum. Das charakteristische Röntgenspektrum entsteht durch hochenergetische Übergänge von Elektronen in den inneren Atomhüllen. Das kontinuierliche Röntgenspektrum entsteht durch Bremsstrahlung.

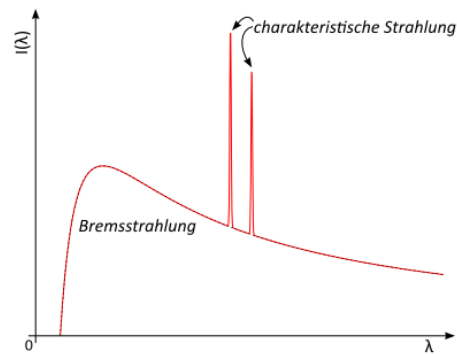


Abbildung 1: Charakteristisches und kontinuierliches Röntgenspektrum [1]

2.1.1 Erzeugung

Möchte man Röntgenstrahlung erzeugen, verwendet man eine sogenannte Röntgenröhre. Sie besteht erstens aus einer Glühkathode an der eine Heizspannung anliegt, bzw. durch die ein Emissionsstrom I fließt. Am anderen Ende der Röhre befindet sich eine Anode zu welcher die aus der Kathode gelösten Elektronen durch die Anoden- bzw. Röhrenspannung U hinbeschleunigt werden. In der Anode lösen die Elektronen zum einen andere Elektronen aus den inneren Atomhüllen, was zu charakteristischer Röntgenstrahlung führt. Zum anderen werden sie stark

abgebremst, was zum kontinuierlichen Röntgenspektrum führt. Die Anode und Kathode befinden sich in einem evakuierten Glaskolben.

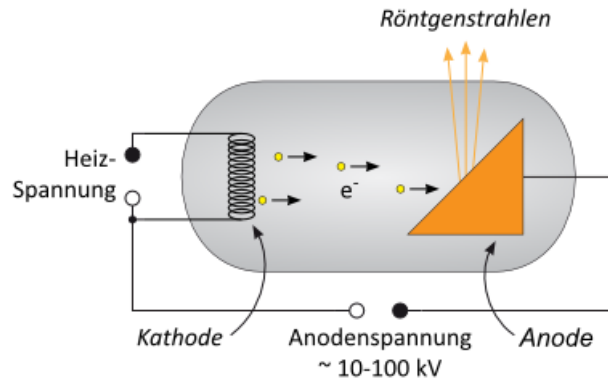


Abbildung 2: Aufbau einer Röntgenröhre [1]

2.2 Dosimetrische Messgrößen

2.2.1 Ionendosis

Die Ionendosis J gibt die mittlere elektrische Ladung Q gleichen Vorzeichens an, die durch ionisierende Strahlung in Materie der Masse m entsteht.

$$D = \frac{dQ}{dm}$$

2.2.2 Ionendosisleistung

Die Ionendosisleistung j ist die Ionendosis J die pro Zeitintervall Δt erzeugt wird.

$$j = \frac{dJ}{dt}$$

2.2.3 Äquivalentdosis

Die Äquivalentdosis H **HIER TEXT EINFÜGEN...**

2.3 Messgeräte

Zum Nachweis der Röntgenstrahlung werden in dem Versuch drei verschiedene Messgeräte verwendet. Dazu zählt das Geiger-Müller-Zählrohr, ein Kondensator über welchen man eine Spannungsänderung messen kann und ein Stabdosisimeter.

2.3.1 Geiger-Müller-Zählrohr

Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Anodendraht in einer zylinderförmigen Metallrohr-Kathode. Der Zylinder ist gefüllt mit einem sogenanntem Zählgas, wie Xenon zum Beispiel. Des weiteren wird ein sogenanntes Löschgas, wie zum Beispiel Ethanolampf, zur Verkürzung der Totzeit beigemischt.

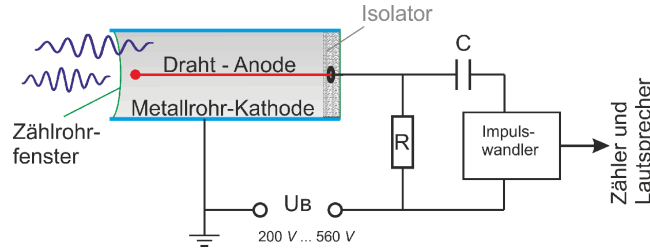


Abbildung 3: Aufbau des Geiger-Müller-Zählrohrs [2]

Trifft Röntgenstrahlung auf das Zählgas wird letzteres ionisiert und die freigesetzten Elektronen werden richtung Anode beschleunigt, wo sie sich sammeln. Dies erzeugt eine Spannungsänderung über dem Kondensator C, die gemessen werden kann.

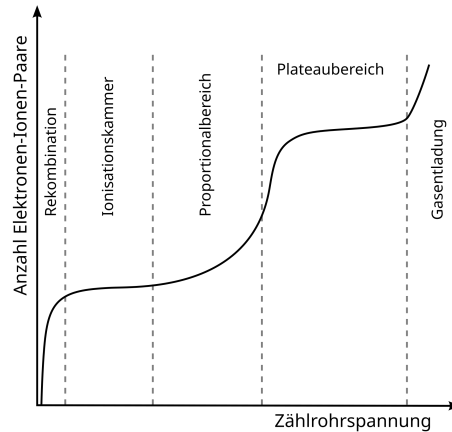


Abbildung 4: Arbeitsbereiche des Zählrohrs [7]

Zwischen Anodendraht und Kathode wird eine Betriebsspannung U_B angelegt. Je nach eingestellter Betriebsspannung arbeitet das Zählrohr in verschiedenen Arbeitsbereichen. Interessant für uns ist das Geiger-Müller-Bereich (Plateaubereich in Abbildung 4): Trifft hier Röntgenstrahlung auf das Zählgas, führt es zu einer vollständigen Entladung des Gases, was als ein Tick gezählt wird.

Nach dieser Auslösung ist das Zählrohr für eine Zeit nicht empfänglich für ein weiteres Signal, bis der Anfangszustand des Gases widerhergestellt ist. Diese

Zeit wird als Totzeit τ bezeichnet.

2.3.2 Kondensator

Trifft Röntgenstrahlung auf Atome des Mediums zwischen den Kondensatorplatten, werden freie Ladungsträger erzeugt, die zu den Platten hin beschleunigt werden. Diese Ladungsträger, Elektronen zum Beispiel, sammeln sich auf den Kondensatorplatten, was eine Spannungsänderung erzeugt, die gemessen werden kann.

Auch bei dem Kondensator gibt es verschiedene Arbeitsbereiche. Im Rekombinationsbereich reicht die Spannung nicht aus um in 100 % der Fälle einfallender Röntgenstrahlung ein Ereignis zu messen. Im Ionisationsbereich ist die Spannung ausreichend um jedes (nicht in der Totzeit) einfallende Röntgenquant zu messen zu können.

2.3.3 Stabdosisimeter

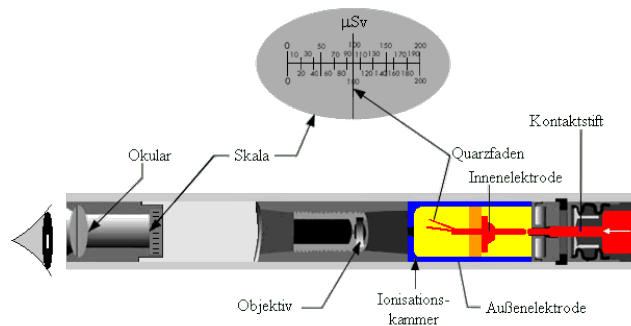


Abbildung 5: Aufbau des Stabdosisimeters [3]

Der Stabdosisimeter funktioniert indem man eine Spannung zwischen Innen- und Außenelektrode (Abbildung 5) anlegt, sodass der Quarzfaden die Nullstellung annimmt. Trifft nun ionisierende Strahlung in den Gasraum, verringern die dabei entstehenden Ladungen die angelegte Spannung, was durch die neue Position des Quarzfadens abzulesen ist.

2.4 Relevante Gesetze

2.4.1 Abstandsquadratgesetz

Das Abstandsquadratgesetz besagt, dass die Intensität I eines sphärisch divergierenden Strahles invers proportional zu dem Quadrat des Abstandes r zu der Quelle ist. Dies ist intuitiv klar, da sich der Strahl auf die Kugel mit Radius r aufteilt, und die Fläche dieser Kugel mit dem Quadrat des Radius r skaliert.

$$I \propto r^{-2} \quad (1)$$

2.4.2 Lambertsches Strahlungsgesetz

Das Lambertsche Strahlungsgesetz beschreibt welcher Anteil der Strahlung durch einen Absorber transmittiert wird. Sei T der Transmissionsgrad, μ die Absorptionskoeffizient des Absorbermaterials und d die Dicke des Absorbers. Desweiteren sei I_0 die Intensität des Strahles vor Durchgang des Absorbers und I die Intensität nach Durchgang.

$$T = e^{-\mu d} \quad \text{und} \quad I = I_0 \cdot T \quad (2)$$

2.5 Computertomographie

Bei der Computertomographie wird Röntgenstrahlung verwendet um Schnittbilder eines Objektes zu erzeugen, ohne dieses zu beschädigen. Sie findet hauptsächlich in der Medizin ihren Gebrauch. Dabei wird ausgenutzt, dass verschiedene Bioelemente verschiedene Absorptionskoeffizienten haben.

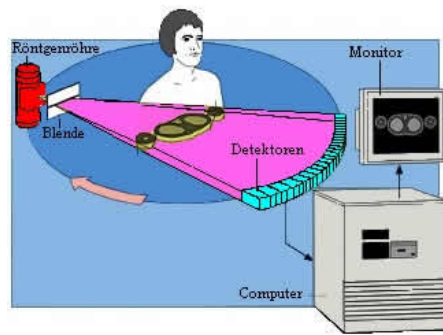


Abbildung 6: Computertomographie Funktionsweise [4]

Wie in Abbildung 6 zu sehen wird Röntgenstrahlung durch das zu untersuchende Objekt (hier Mensch) gestrahlt. Auf gegenüberliegender Seite befinden sich mehrere Detektoren, die zusammen ein Winkelverteilung der Transmissionsgrade messen. Dreht man nun diesen Aufbau um das Objekt und macht man eine Reihe dieser Aufnahmen, kann ein Computer diese Aufnahmen zusammensetzen und das Schnittbild rekonstruieren.

3 Durchführung

3.1 Dosimetrie

In dem ersten Versuchsteil beschäftigen wir uns mit der Dosimetrie. Hierbei messen wir die aus der Röntgenröhre austretende Röntgenstrahlung anhand eines Kondensators. Dabei variieren wir das Material der Anode der Röntgenröhre, die Röhrenspannung U und den Emissionsstrom I . Auch variieren wir die Kondensatorspannung U_C und wir messen den Ionisationsstrom I_C .

Dazu ist ein Elektrometerverstärker mit Widerstand R in unserem Aufbau an den Kondensator geschaltet, über dessen Ausgangsspannung U_E wir den Ionisationsstrom durch

$$I_C = \frac{U_E}{R} \quad (3)$$

berechnen können.

Hierbei wurden U und I an dem Röntengerät abgelesen und werden als Fehlerfrei betrachtet. U_C und U_E wurden mit einem Digitalmultimeter gemessen, wobei U_C schwankungsfrei war während das Ablesen von U_E komplizierter war. Daher bekommt U_C einen absoluten Fehler von $\Delta U_C = 1 \text{ V}$ da wir die Werte auf 1 V genau abgelesen haben. Der Fehler auf U_E wurde für jede Messung bestimmt durch das Schwanken der abzulesenden Werte auf dem DMM.

Beim Arbeiten mit der Molybdän-Röntgenröhre haben wir einen Widerstand von $R = 1 \text{ G}\Omega$ und mit der Kupfer-Röntgenröhre einen Widerstand von $R = 100 \text{ M}\Omega$ verwendet.

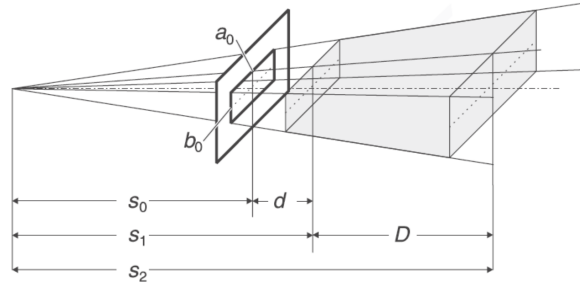


Abbildung 7: Dimensionen des durchstrahlten Volumens im Plattenkondensators [6]

Die Dimensionen des im Plattenkondensators von Röntgenstrahlung durchströmten Volumens sind mit Abbildung 7 in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1: Dimensionen des durchstrahlten Volumens im Plattenkondensators mit Bildbeschreibung der Größen in Abbildung 7 [6]

Name	Länge / cm
s_0	15,5
a_0	4,5
b_0	0,6
d	2,5
D	16,0

Während der Durchführung dieses Versuchsteils wurde mehrfach der Luftdruck p und die Raumtemperatur T gemessen. Beide Werte blieben konstant auf $p = (990 \pm 3) \text{ hPa}$ und $T = (26,0 \pm 1,5) ^\circ\text{C} = (299,15 \pm 1,50) \text{ K}$.

Zuerst sollte ermittelt werden in welchem Spannungsbereich der Kondensator als Ionisationsdetektor arbeitet. Dazu wurde die Kondensatorspannung U_C variiert und die Ausgangsspannung U_E des Elektrometerverstärker gemessen. Dies wurde jeweils für die Kupfer- sowie für die Molybdän-Röhre für drei verschiedene Röhrenspannungen ($U \in \{10, 15, 25\} \text{ kV}$) durchgeführt. Dabei haben wir jeweils so viele Messwerte aufgenommen, wie es der Regler zum Einstellen der Kondensatorspannung erlaubte, oder bis der Wert von U_E stagnierte. Die zugehörigen Messwerte sind im Anhang in Tabelle 2 bis Tabelle 7 eingetragen.

Danach wurde die Ausgangsspannung U_E des Elektrometerverstärker in Abhängigkeit des Emissionsstroms I gemessen. Dabei wurde die Molybdän-Röhre verwendet und die Röhrenspannung betrug $U = 35 \text{ kV}$. Die Messwerte sind in Tabelle 8 zu finden.

Dann wurde noch die Ausgangsspannung U_E des Elektrometerverstärker in Abhängigkeit der Röhrenspannung U gemessen. Für diese Messung wurde die Kupfer-Röhre eingesetzt und der Emissionsstrom auf $I = 1 \text{ mA}$ festgehalten. Man findet die zugehörigen Messwerte in Tabelle 9.

In der Versuchsanleitung stand, man solle die Messung in Abhängigkeit des Emissionsstroms, sowie die Messung in Abhängigkeit der Röhrenspannung jeweils für beide Röntgenröhren durchführen. Leider haben wir dies falsch gelesen und es so verstanden als solle man die Strommessung mit der Molybdän-Röhre und die Spannungsmessung mit der Kupfer-Röhre machen. Deswegen haben wir zwei Messreihen zu wenig aufgenommen. In dem Auswertungsteil wird darauf eingegangen, was man bei diesen beiden Messungen erwarten würde.

3.2 Abstandsquadratgesetz

Als nächstes sollte das Abstandsquadratgesetz anhand eines Stabdosimeters verifiziert werden. Dazu wurde der Kondensator aus dem Röntgengerät ausgebaut und mit einer Experimentierschiene mit eingezeichneter Zentimeter-Skala ersetzt. Der Nullpunkt der Zentimeter-Skala war dabei ca. 110 mm von der Anode der Röntgenröhre entfernt. Nun wurde vor jeder Messung das Stabdosimeter geeicht, indem die Elektroden auf die korrekte Spannung gesetzt wurden. Dann haben wir das Stabdosimeter auf eine gewisse Position x auf die Experimentierschiene gestellt und für eine bestimmte Zeitdauer Δt bestrahlt. Danach haben wir auf der im Dosimeter eingebauten Skala die Äquivalentdosis abgelesen, die das Dosimeter in der Zeit Δt abbekommen hat.

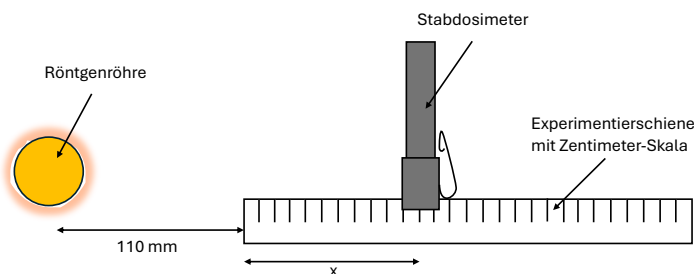


Abbildung 8: Aufbau zum Bestätigen des Abstandsquadratgesetzes

Dies wurde zuerst für die Kupfer-Röhre bei einer Integrationszeit von $\Delta t = 1$ s durchgeführt. Dabei betrug der Emissionsstrom $I = 0,1$ mA und die Röhrenspannung $U = 35$ kV. Die Messwerte sind im Anhang in Tabelle 10 zu finden.

Danach wurde die Messung mit der Molybdän-Röhre mit $I = 0,2$ mA und $\Delta t = 2$ s wiederholt. Die Röhrenspannung blieb gleich und die Messwerte sind in Tabelle 11 eingetragen.

3.3 Totzeit

Im Versuchsteil zur Totzeit wollen wir die Totzeit des Geiger-Müller-Zählrohrs abschätzen. Dazu wurde die Experimentierschiene wieder entfernt und ein Goniometer eingebaut. Des weiteren wurde auch ein Kollimator eingebaut, die Kupfer-Röhre eingesetzt und ein Zählrohr an das Goniometer angeschlossen.

Nun konnte man die vertikale Position des Zählrohrs durch Einstellen des Winkels des Goniometers variieren. Zuerst wurde dieser Winkel so eingestellt, dass das Zählrohr auf der optischen Achse lag und die Zählrate somit maximal wurde. Dieser Winkel lag bei $-0,6^\circ$ (Abbildung 9) und wurde im Weiteren fest auf dieser Einstellung gehalten.

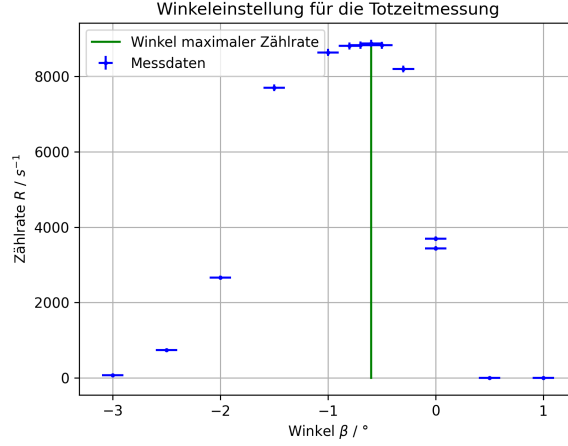


Abbildung 9: Bestimmung des Winkels β der maximalen Zählrate R für die Totzeitmessung (Messwerte: Tabelle 12)

Als nächstes wurde der Emissionsstrom I variiert und die mittlere Zählrate R jeweils über eine Integrationszeit von $\Delta t = 30$ s aufgenommen. Die zugehörigen Messwerte sind im Anhang in Tabelle 13 abzulesen.

3.4 Abschirmung

Als nächstes wird der Effekt von abschirmenden Materialien auf die Röntgenstrahlung betrachtet. Dabei blieb der Kollimator, sowie das Goniometer mit dem Zählrohr eingebaut und es wurde zusätzlich ein Targethalter zum Befestigen der Abschirmungen eingesetzt. Auch wurde die Kupfer-Röhre wieder mit der Molybdän-Röhre ersetzt.

In den Targethalter können zwei verschiedene Absorbersätze eingesetzt werden. Der Absorbersatz I besteht aus einem Loch und sechs Absorbern aus gleichem Material aber mit verschiedener Dicke d . Der Absorbersatz II besteht aus einem Loch und sechs Absorbern gleicher Dicke d_{II} aber verschiedener Materialien. Des weiteren konnte man einen Zirkoniumfilter auf den Kollimator stecken.

Zuerst wurde wie im vorherigen Teil eine Winkelmessung durchgeführt um das Zählrohr in die optische Achse der Röntgenstrahlung zu positionieren. Der optimale Winkel wurde auf $\beta = -1,5^\circ$ festgelegt (Abbildung 10) und blieb im Folgenden fest bei diesem Wert.

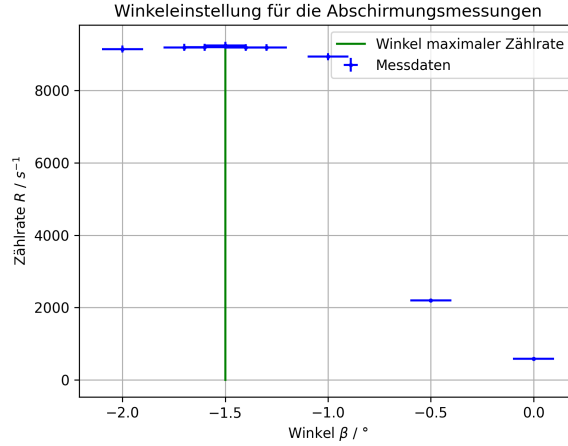


Abbildung 10: Bestimmung des Winkels β der maximalen Zählrate R für die Abschirmungsmessungen (Messwerte: Tabelle 14)

Dann wurde für die mittlere Zählrate R für beide Absorbersätze jeweils einmal mit Zirkoniumfilter und einmal ohne Filter gemessen. Dies wurde wieder über eine Integrationszeit von $\Delta t = 30$ s gemittelt. Dabei sollte versucht werden, dass die Zählrate nicht 3000/s überschreitet. Dies wurde erreicht indem der Emissionsstrom I angepasst wurde. Die vier Werte der vier Messreihen sind im Anhang in Tabelle 15 bis Tabelle 18 eingetragen.

3.5 Computertomogramm

HIER TEXT EINFÜGEN...

4 Auswertung

4.1 Dosimetrie

Nach Gleichung 3 kann die Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E direkt in den Ionisationsstrom I_C umgerechnet werden. Da für die Molybdän-Röhre ein Widerstand R von $1\text{ G}\Omega$ verwendet wurde, ergibt sich der direkte Zusammenhang:

$$1\text{ V} \hat{=} 1\text{ nA} \quad (\text{Molybdän-Röhre})$$

Und mit einem Widerstand von $R = 100\text{ M}\Omega$ ergibt sich für die Kupfer-Röhre:

$$1\text{ V} \hat{=} 10\text{ nA} \quad (\text{Kupfer-Röhre})$$

Somit können wir den Ionisationsstrom I_C gegen die Kondensatorspannung U_C auftragen. In Abbildung 11 ist dies für die Molybdän-Röhre bei einer Röhrenspannung von $U = 15\text{ kV}$ abgebildet.

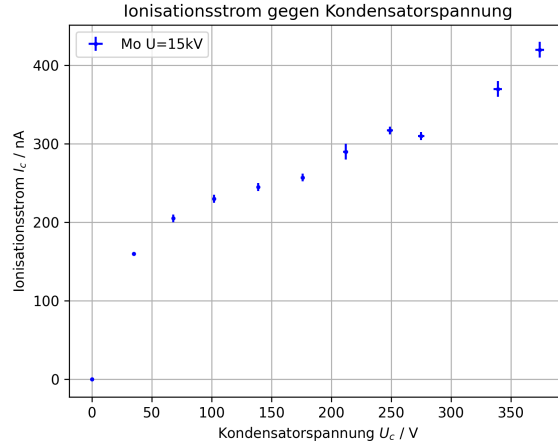


Abbildung 11: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für Röhrenspannung $U = 15 \text{ kV}$ (Molybdän-Röhre, $I = 1 \text{ mA}$)

Man erkennt, dass ohne Kondensatorspannung auch kein Ionisationsstrom fließt. Dies ist natürlich klar, da in diesem Fall auch keine freien Ladungen an den Elektroden sammeln. Zusätzlich sieht man, dass der Ionisationsstrom unterhalb von $U_C = 100 \text{ V}$ rasch ansteigt. Dies ist der Rekombinationsbereich, in dem noch nicht alle durch die Röntgenstrahlung entstandenen Ladungen die Elektroden erreichen. Bis eine Kondensatorspannung von ungefähr $U_C = 300 \text{ V}$ scheint die Kurve dann langsamer zu steigen. Über $U_C = 300 \text{ V}$ steigt die Kurve dann wieder schneller an.

Erwarten würde man einen raschen Anstieg im Rekombinationsbereich und dann eine Abflachung im Ionisationsbereich. Diese Kurve entsteht dadurch, dass ab einer gewissen Spannung quasi jede durch die Röntgenstrahlung erzeugte freie Ladung zwischen den Kondensatorplatten auch diese Platten erreicht.

Wieso wir keine solche Abflachung sehen könnte daran liegen, dass sich die freien Ladungen wegen der Impulserhaltung von der Röntgen-Röhre wegbewegen. Am hinteren Ende des Kondensators erreichen somit nicht alle Ladungen noch eine Kondensatorplatte. Bei steigender Kondensatorspannung können immer weniger Ladungen dem Kondensator entkommen. Der rasche Anstieg überhalb von $U_C = 300 \text{ V}$ könnte daran liegen, dass ab einer gewissen Spannung die Photonen die durch die Compton-Streuung auf die negativ geladene Platte treffen die Elektronen direkt herauslösen, sodass diese auf die positiv geladene Platte treffen.

In Abbildung 12 erkennt man, wie die Kurve sich für verschiedene Röhrenspannungen U verändert.

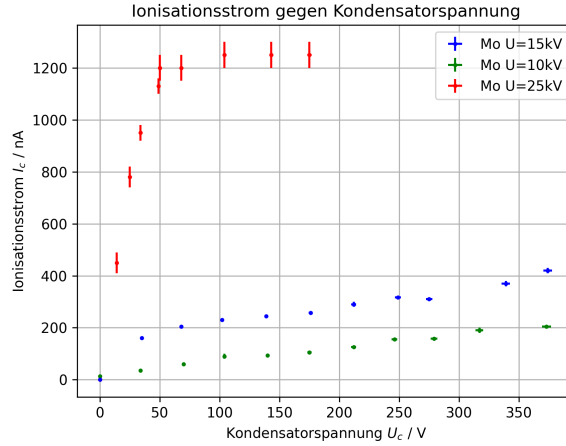


Abbildung 12: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für drei verschiedene Röhrenspannungen (Molybdän-Röhre, $I = 1 \text{ mA}$)

Wir sehen, dass bei höherer Röhrenspannung U der Ionisationsstrom I_C höher für gleiche Kondensatorspannung U_C ist. Dies liegt daran, dass die Röntgen-Photonen bei höherer Röhrenspannung mehr Energie besitzen und somit mehr freie Ladungen erzeugen können. Jedoch sieht der Verlauf der Kurve außer der vertikalen Skalierung ähnlich aus. Die Kurve steigt in allen Fällen rascher an unterhalb von $U_C = 100 \text{ V}$. Dies macht Sinn, da die Breite des Rekombinationsbereichs nicht abhängig von der Röhrenspannung ist. Für eine Röhrenspannung von $U = 25 \text{ kV}$ ist die Abflachung deutlicher zu erkennen. Die $U = 10 \text{ kV}$ -Kurve sieht der $U = 15 \text{ kV}$ -Kurve sehr ähnlich.

In Abbildung 13 ist die $U = 15 \text{ kV}$ -Kurve für die Kupfer-Röhre abgebildet.

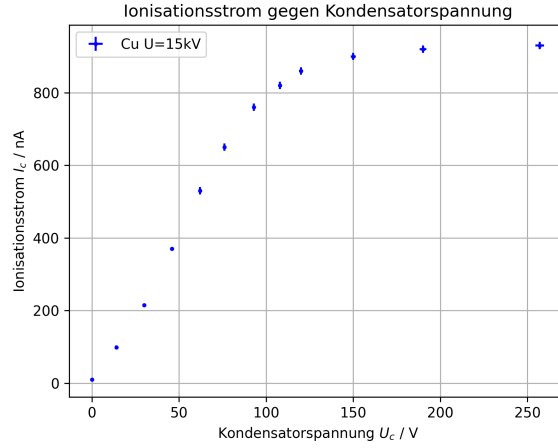


Abbildung 13: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für Röhrenspannung $U = 15$ kV (Kupfer-Röhre, $I = 1$ mA)

Wir erkennen, dass die Kurve für die Kupfer-Röhre deutlich klarer unserer Erwartung folgt. Hier haben wir einen klaren Anstieg bis ungefähr $U_C = 150$ V, wo die Kurve dann abflacht.

In Abbildung 14 ist der Verlauf des Ionisationsstroms I_C gegen die Kondensatorspannung U_C für drei verschiedene Röhrenspannungen U mit der Kupfer-Röhre zu sehen.

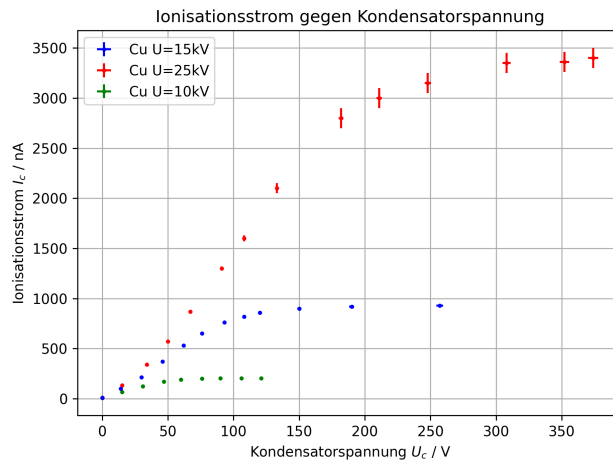


Abbildung 14: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für drei verschiedene Röhrenspannungen (Kupfer-Röhre, $I = 1$ mA)

Hier sehen wir wieder, dass bei höherer Röhrenspannung U der maximale Ionisationsstrom höher liegt. Auch erkennen wir diesmal deutlich, dass die Kurve bei höherer Röhrenspannung erst bei einer höheren Kondensatorspannung abflacht. Dies bedeutet, dass der Rekombinationsbereich größer für höhere Röhrenspannung ist. Der Grund dafür könnte wieder sein, dass die freien Ladungen mehr kinetische Energie bei höherer Röhrenspannung bekommen. Dann braucht man wieder eine höhere Kondensatorspannung um alle freie Ladungen auf den Elektroden zu sammeln, bevor sie dem Kondensator entkommen.

Aus diesen Messungen haben wir uns überlegt, dass in jedem Fall der Ionisationsstrom maximal wird bei der maximalen Kondensatorspannung. Deswegen haben wir im folgenden die Kondensatorspannung bei maximaler Einstellung gehalten.

Nun wollen wir uns ansehen, wie sich die mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ unter Variation des Emissionsstroms I und der Röhrenspannung U verhält. Die mittlere Ionendosisleistung lässt sich hier berechnen durch

$$\langle j \rangle = \frac{I_C}{m}$$

, wobei I_C der Ionisationsstrom zwischen den Kondensatorplatten und m die Masse der durchstrahlten Materie im Kondensator ist. Der Ionisationsstrom I_C wurde wie im Vorherigen bestimmt. Im verwendeten Versuchsaufbau war der Innenraum des Kondensators nicht abgeschirmt und somit muss die Masse der Luft im Volumen des Kondensators bestimmt werden. Die Masse der Luft m wird berechnet durch $m = \rho \cdot V$, wobei ρ die Dichte der Luft und V das im Kondensator durchstrahlte Volumen ist.

Die Luftdichte hängt von der Temperatur T und dem Luftdruck p an dem Versuchszeitpunkt ab. Sie berechnet sich als:

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T} \cdot \frac{p}{p_0}$$

, wobei gilt: $\rho_0 = 1,293 \text{ kg/m}^3$, $T_0 = 273 \text{ K}$, $p_0 = 1013 \text{ hPa}$. Die Temperatur am Versuchstag wurde als $T = (299,15 \pm 1,50) \text{ K}$ und der Luftdruck als $p = (990 \pm 3) \text{ hPa}$ gemessen. Damit erhalten wir:

$$\rho = (1,154 \pm 0,066) \text{ kg/m}^3$$

Das durchstrahlte Volumen im Kondensator lässt sich mit Abbildung 7 und den Werten in Tabelle 1 berechnen. Die x-Achse sei die Verbindungsachse der Quelle und der Mitte des Fensters mit dem $x = 0$ -Punkt im Fenster und positiver Richtung zum Kondensator hin. Dann erkennen wir durch den Strahlensatz folgenden Zusammenhang für a :

$$\frac{a_0}{s_0} = \frac{a(x)}{s_0 + x} \quad \Rightarrow \quad a(x) = a_0 \left(1 + \frac{x}{s_0} \right)$$

und identisch für $b(x)$.

Das durchstrahlte Volumen berechnet sich dann als das folgende Integral:

$$V = \int_d^{d+D} a(x) \cdot b(x) dx$$

Die Lösung dieses Integrals ist folgende:

$$V = \frac{a_0 b_0}{3s_0^2} [(s_0 + d + D)^3 - (s_0 + d)^3]$$

und setzt man die Werte aus Tabelle 1 ein findet man ein Volumen von:

$$V = 125,39 \text{ cm}^3$$

Nun kann man die Masse m der im Kondensator von Röntgenstrahlung durchströmten Luft berechnen und man findet:

$$m = (144,7 \pm 8,3) \text{ mg}$$

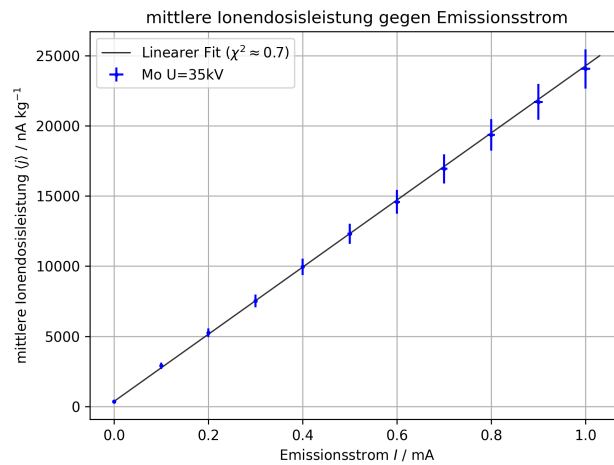


Abbildung 15: mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Molybdän-Röhre, $I = 35 \text{ kV}$)

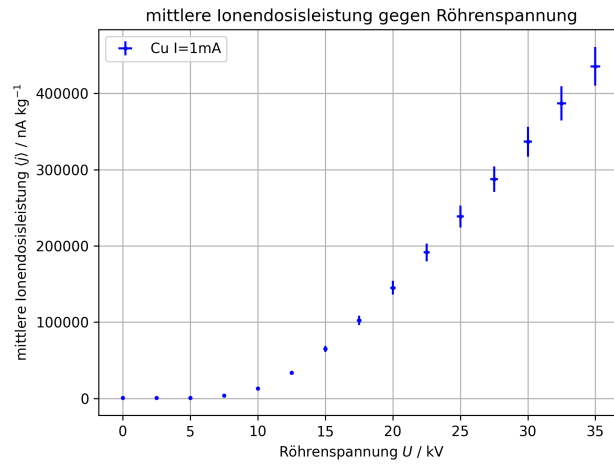


Abbildung 16: mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ in Abhängigkeit der Röhrenspannung U (Kupfer-Röhre, $I = 1$ mA)

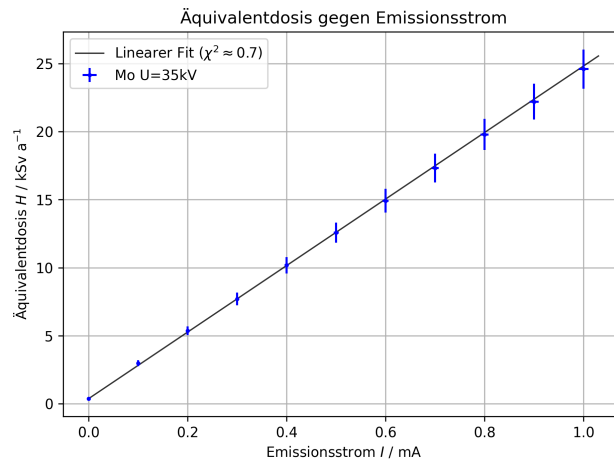


Abbildung 17: Äquivalentdosis H pro Jahr in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV)

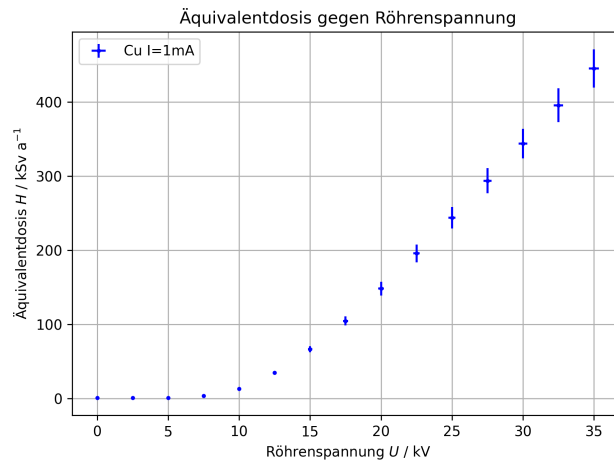


Abbildung 18: Äquivalentdosis H pro Jahr in Abhängigkeit der Röhrenspannung U (Kupfer-Röhre, $I = 1$ mA)

4.2 Abstandsgesetz

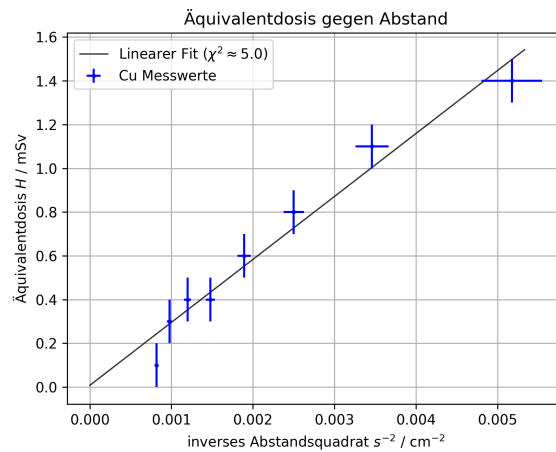


Abbildung 19: Linearer Fit der Äquivalentdosis H über Integrationszeit $\Delta t = 1$ s gegen inverses Abstandsquadrat s^{-2} (Kupfer-Röhre, $I = 0,1$ mA, $U = 35$ kV)

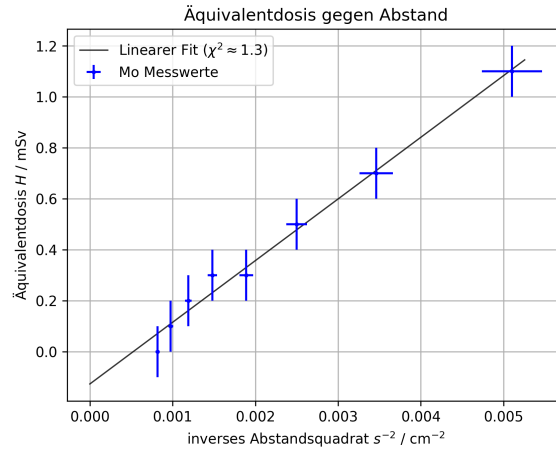


Abbildung 20: Linearer Fit der Äquivalentdosis H über Integrationszeit $\Delta t = 2$ s gegen inverses Abstandsquadrat s^{-2} (Molybdän-Röhre, $I = 0,2$ mA, $U = 35$ kV)

4.3 Totzeit

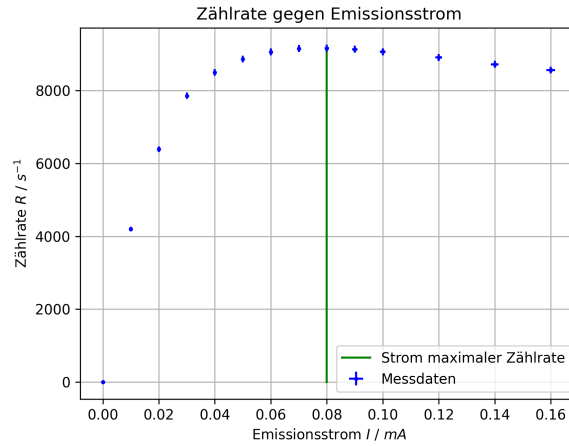


Abbildung 21: Zählrate R gegen Emissionsstrom I (Kupfer-Röhre, $U = 35$ kV)

4.4 Abschirmung

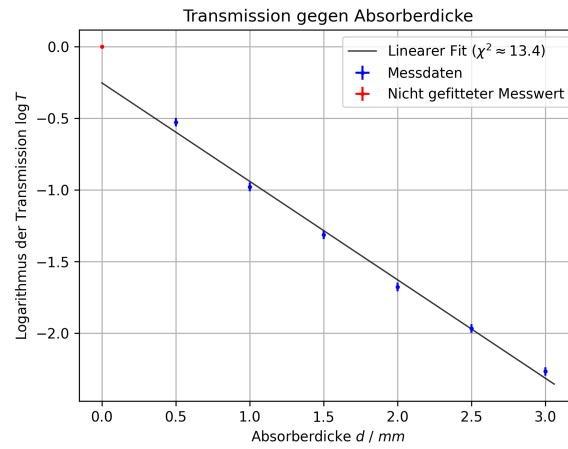


Abbildung 22: Linearer Fit des Transmissionsgrads T gegen Absorberdicke d (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, ohne Zirkoniumfilter)

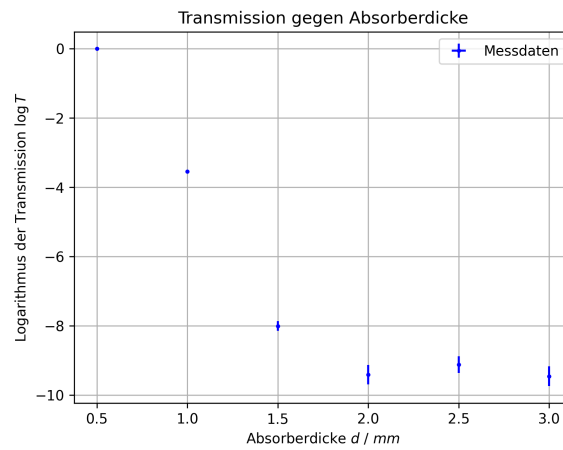


Abbildung 23: Transmissionsgrad T gegen Absorberdicke d (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, mit Zirkoniumfilter)

4.5 Computertomogramm

5 Fazit

6 Anhang

6.1 Messwerte

6.1.1 Dosimetrie

Tabelle 2: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Molybdän-Röhre, $U = 15 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	0	1
35	160	1
68	205	5
102	230	5
139	245	5
176	257	5
212	290	10
249	317	5
275	310	5
339	370	10
374	420	10

Tabelle 3: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Molybdän-Röhre, $U = 10 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	13	1
34	36	2
70	60	5
104	90	10
140	93	2
175	105	5
212	126	3
246	155	5
279	158	5
317	190	10
373	205	5

Tabelle 4: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Molybdän-Röhre, $U = 25 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	0	1
14	450	40
25	780	40
34	950	30
49	1130	30
50	1200	50
68	1200	50
104	1250	50
143	1250	50
175	1250	50

Tabelle 5: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Kupfer-Röhre, $U = 15 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	10	1
14	99	5
30	215	5
46	370	5
62	530	10
76	650	10
93	760	10
108	820	10
120	860	10
150	900	10
190	920	10
257	930	10

Tabelle 6: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Kupfer-Röhre, $U = 25$ kV)

U_C / V	U_E / mV	ΔU_E / mV
0	10	1
15	135	2
34	340	5
50	570	10
67	870	10
91	1300	20
108	1600	30
133	2100	50
182	2800	100
211	3000	100
248	3150	100
308	3350	100
352	3360	100
374	3400	100

Tabelle 7: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Kupfer-Röhre, $U = 10$ kV)

U_C / V	U_E / mV	ΔU_E / mV
0	8	1
15	66	2
31	125	2
47	170	5
60	190	5
76	200	5
90	205	5
106	205	10
121	205	10

Tabelle 8: Messwerte der Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$)

I / mA	U_E / V	$\Delta U_E / \text{V}$
0,0	0,053	0,002
0,1	0,42	0,02
0,2	0,76	0,01
0,3	1,09	0,02
0,4	1,44	0,02
0,5	1,78	0,02
0,6	2,11	0,02
0,7	2,45	0,05
0,8	2,8	0,02
0,9	3,14	0,04
1,0	3,48	0,03

Tabelle 9: Messwerte der Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E in Abhängigkeit der Röhrenspannung U (Kupfer-Röhre, $I = 1 \text{ mA}$)

U / kV	U_E / V	$\Delta U_E / \text{V}$
0,0	0,0115	0,0002
2,5	0,0113	0,0002
5,0	0,0124	0,0002
7,5	0,053	0,0001
10,0	0,188	0,002
12,5	0,49	0,01
15,0	0,94	0,02
17,5	1,48	0,01
20,0	2,1	0,05
22,5	2,77	0,05
25,0	3,45	0,05
27,5	4,16	0,03
30,0	4,87	0,02
32,5	5,6	0,03
35,0	6,3	0,03

6.1.2 Abstand

Tabelle 10: Messwerte der Äquivalentdosis H in Abhängigkeit der Position x des Stabdosimeters (Kupfer-Röhre, $I = 0,1 \text{ mA}$, $U = 35 \text{ kV}$, $\Delta t = 1 \text{ s}$)

x / cm	H / mSv
3	1,3
6	1,1
9	0,8
12	0,6
15	0,4
18	0,3
21	0,3
24	0,1

Tabelle 11: Messwerte der Äquivalentdosis H in Abhängigkeit der Position x des Stabdosimeters (Molybdän-Röhre, $I = 0,2 \text{ mA}$, $U = 35 \text{ kV}$, $\Delta t = 2 \text{ s}$)

x / cm	H / mSv
3	1,1
6	0,7
9	0,5
12	0,3
15	0,3
18	0,2
21	0,1
24	0,0

6.1.3 Totzeit

Tabelle 12: Messwerte zur Bestimmung des Winkel β der maximalen Zählrate R für die Totzeitmessung (Kupfer-Röhre, $I = 0,5 \text{ mA}$, $U = 35 \text{ kV}$)

$\beta / ^\circ$	$R / 1/\text{s}$
0,0	3695
-3,0	75,7
-2,5	741,3
-2,0	2661
-1,5	7700
-1,0	8639
-0,8	8810
-0,7	8831
-0,6	8877
-0,5	8829
-0,3	8198
0,0	3441
0,5	3
1,0	1,7

Tabelle 13: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Kupfer-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$)

$I / \mu\text{A}$	$R / 1/\text{s}$
0	0,23
10	4197
20	6392
30	7860
40	8503
50	8866
60	9061
70	9155
80	9164
90	9136
100	9067
120	8908
140	8724
160	8560

6.1.4 Abschirmung

Tabelle 14: Messwerte zur Bestimmung des Winkel β der maximalen Zählrate R für die Abschirmungsmessungen (Molybdän-Röhre, $I = 0,6 \text{ mA}$, $U = 35 \text{ kV}$)

$\beta / ^\circ$	$R / 1/\text{s}$
0,0	584
-0,5	2198
-1,0	8932
-1,3	9186
-1,4	9185
-1,5	9246
-1,6	9194
-1,7	9188
-2,0	9144

Tabelle 15: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit der Dicke d des Absorbers und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$, ohne Filter)

d / mm	$R / 1/\text{s}$	I / mA
0	2907	0,05
0,5	2747	0,08
1,0	2838	0,13
1,5	2812	0,18
2,0	2715	0,25
2,5	2846	0,35
3,0	2769	0,46

Tabelle 16: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit des Absorbermaterials und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$, ohne Filter)

Material	$R / 1/\text{s}$	I / mA
C	3133	0,02
Al	2728	0,60
Fe	52,27	1,00
Cu	12,8	1,00
Zr	17,13	1,00
Ag	12,3	1,00

Tabelle 17: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit der Dicke d des Absorbers und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, mit Filter)

d / mm	R / 1/s	I / mA
0	2950	0,15
0,5	2798	0,25
1,0	3023	0,45
1,5	3000	0,63
2,0	2692	0,80
2,5	2635	1,00
3,0	2144	1,00

Tabelle 18: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit des Absorbermaterials und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, mit Filter)

Material	R / 1/s	I / mA
C	2731	0,15
Al	2940	0,40
Fe	92,73	1,00
Cu	18,37	1,00
Zr	23,93	1,00
Ag	3,83	1,00

Literatur

- [1] LP Georg-August-Universität Göttingen. *Röntgenröhre*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://lp.uni-goettingen.de/get/text/6639>.
- [2] Ulf Konrad. *Geiger-Müller-Zählrohr*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.ulfkonrad.de/physik/geiger-mueller-zaehlrohr>.
- [3] LEIFiPhysik. *Dosimeter*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/radioaktivitaet-einfuehrung/ausblick/dosimeter>.
- [4] LEIFiPhysik. *RÖNTGEN-Computertomographie*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/roentgen-strahlung/ausblick/roentgen-computertomographie>.
- [5] LEIFiPhysik. *RÖNTGEN-Strahlung*. letzter Zugriff: 14.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/roentgen-strahlung>.
- [6] *Physikalisches Praktikum Teil V: Kern- und Teilchenphysik - Versuchsbeschreibung*. April 2025. Universität Bonn.
- [7] Wikipedia. *Zählrohr*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlrohr>.