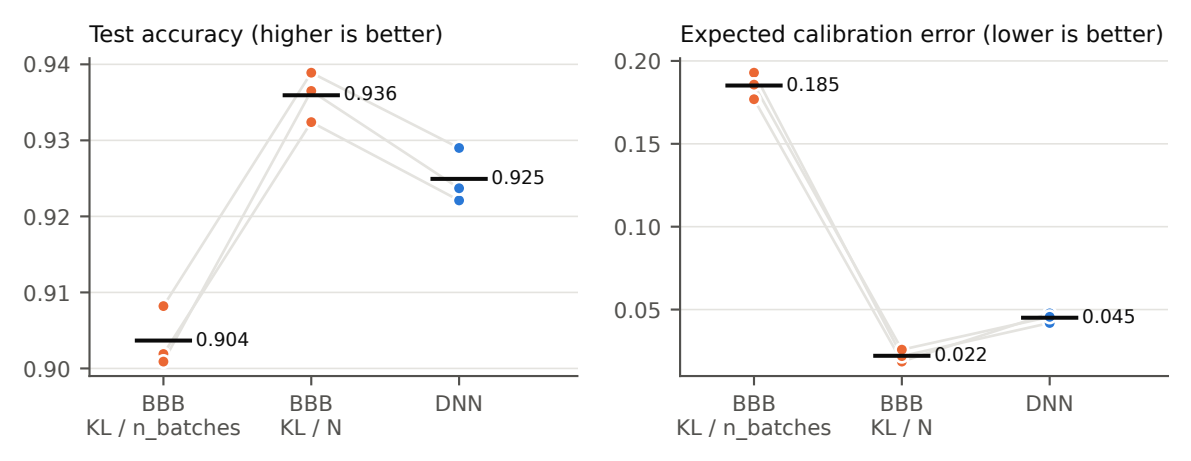
Test accuracy (higher is better)
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.936
0.925
0.904
BBB
KL / n_batches
BBB
KL / N
DNN
Expected calibration error (lower is better)
0.20
0.15
0.10
0.05
0.185
0.045
0.022
BBB
KL / n_batches
BBB
KL / N
DNN