
MTP-101 원디바이스 항온 시험기

MTP-101

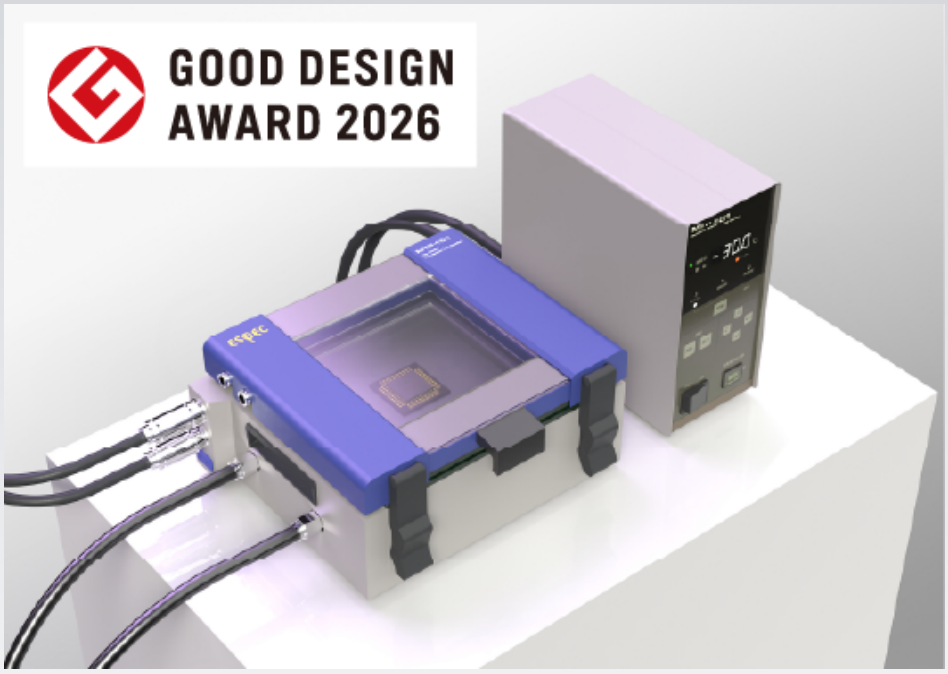

바람 없이 조용하게 온도를 바꾸는 탁상형 시험기입니다. 열변형을 관찰하고 전기 특성을 측정하는 시험에 알맞습니다.

-30 ~ +150°C	무풍·저진동	100V AC
온도 범위	펠티어 소자 방식	탁상 설치

주요 특징

- **챔버 바닥의 펠티어 소자**
  가열과 냉각을 챔버 바닥의 펠티어 소자로 합니다. 무풍, 저진동 환경이라 열변형 관찰에 알맞습니다.
- **2026년 2월 리뉴얼**
  온도 범위가 -30 ~ +150°C로 확대되었습니다. 100V AC 전원으로 책상 위에 둘 수 있는 공간 절약 설계입니다.
- **건조 공기 도입**
  건조 공기를 넣어 결로와 관찰창 김서림을 막습니다.
- **신규 컨트롤러, 전용 PC 소프트웨어**
  프로그램 운전과 표준 통신 기능이 있습니다. 냉각수 순환 장치의 급수 펌프와 연동한 자동 열 사이클, 목표 온도 도달 신호로 열변형 측정 카메라 자동 촬영이 가능합니다.

MTP-101 원디바이스 항온 시험기

주요 사양

항목	내용
온도 범위	-30 ~ +150°C (2026년 2월 리뉴얼로 확대)
전원	100V AC, 책상 위 설치 가능
가열·냉각 방식	챔버 바닥 펠티어 소자 (무풍, 저진동)
결로 방지	건조 공기 도입으로 결로, 관찰창 김서림 방지
컨트롤러	신규 컨트롤러, 전용 PC 소프트웨어로 프로그램 운전, 표준 통신 기능
크기, 소비 전력	문의 시 안내 [확인 필요]

출처: ESPEC 공식 소식 (영문), 수집일 2026-10-29

주요 용도

열변형 관찰과 전기 측정
무풍, 저진동 환경에서 시험품의 열변형을 관찰하고 전기 특성을 측정합니다.

광학·고주파 디바이스 평가
광학 디바이스와 고주파 디바이스의 열 특성을 확인합니다.

열설계·열관리 평가
고발열 부품과 고밀도 실장 기판의 열설계, 열관리를 평가합니다.

패키지·기판 신뢰성 평가
반도체 패키지와 전자 회로 기판의 신뢰성을 평가합니다.

적용 분야: 반도체, 전기전자

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.