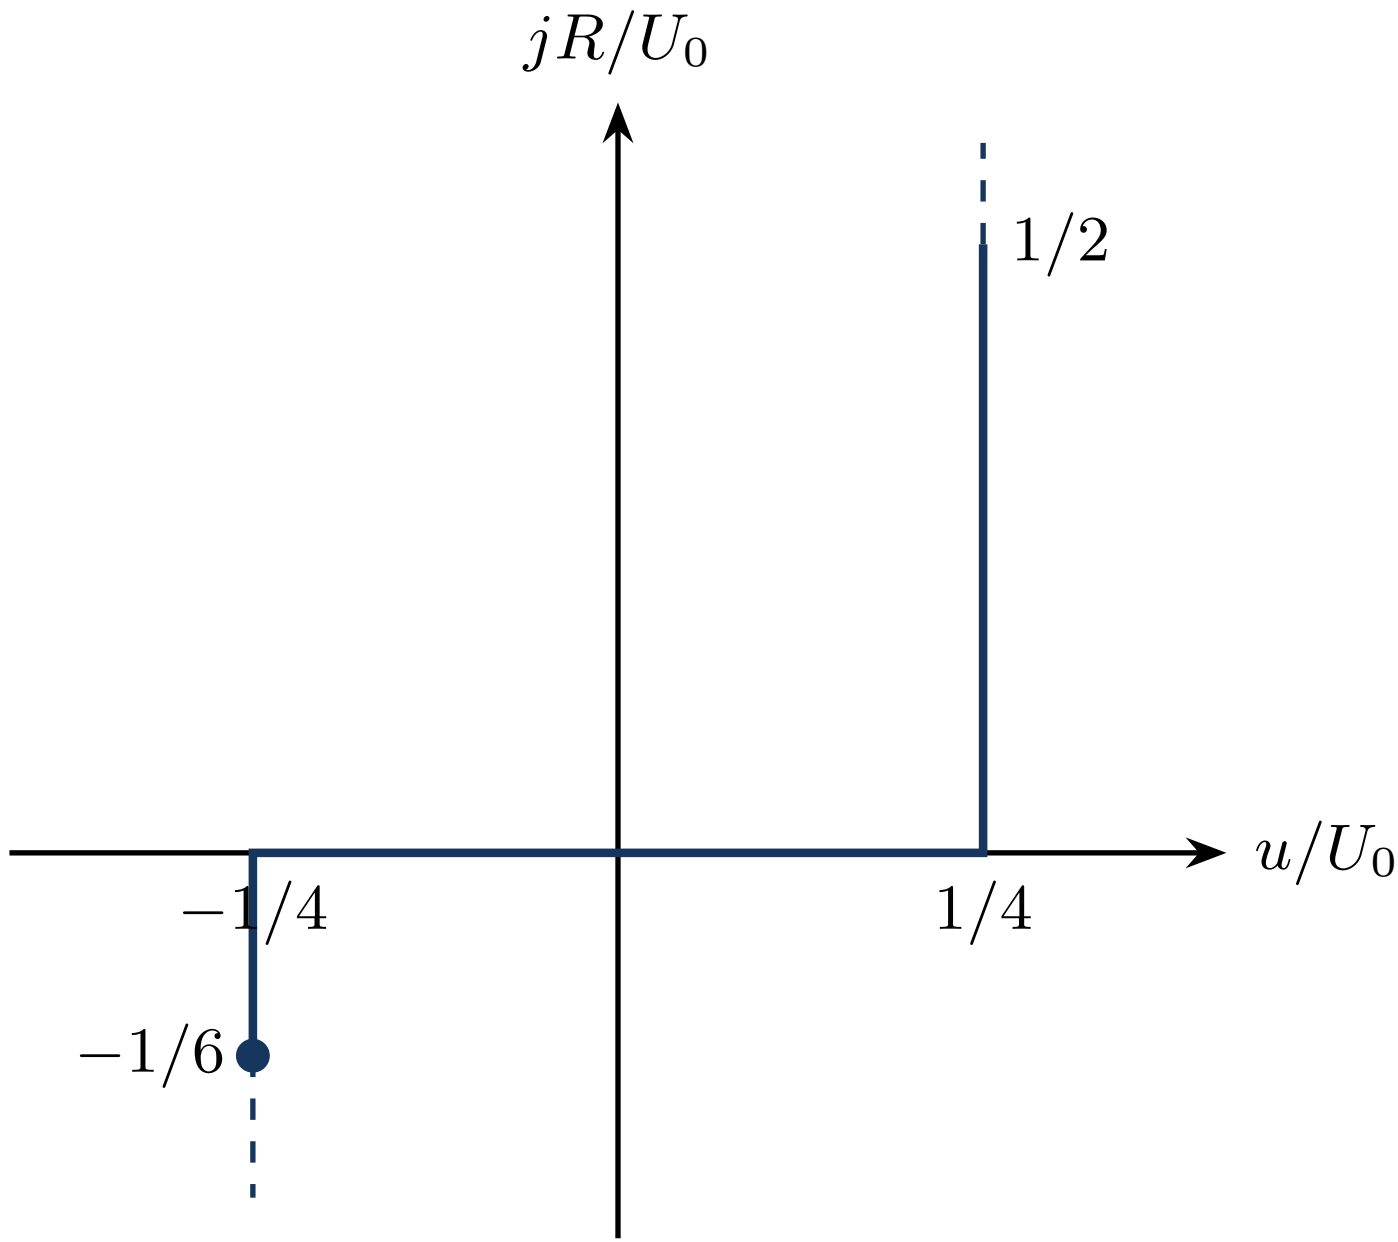

实线：本次扫描覆盖；空心点：仅趋近的极限

虚线：可选的理想钳位延长