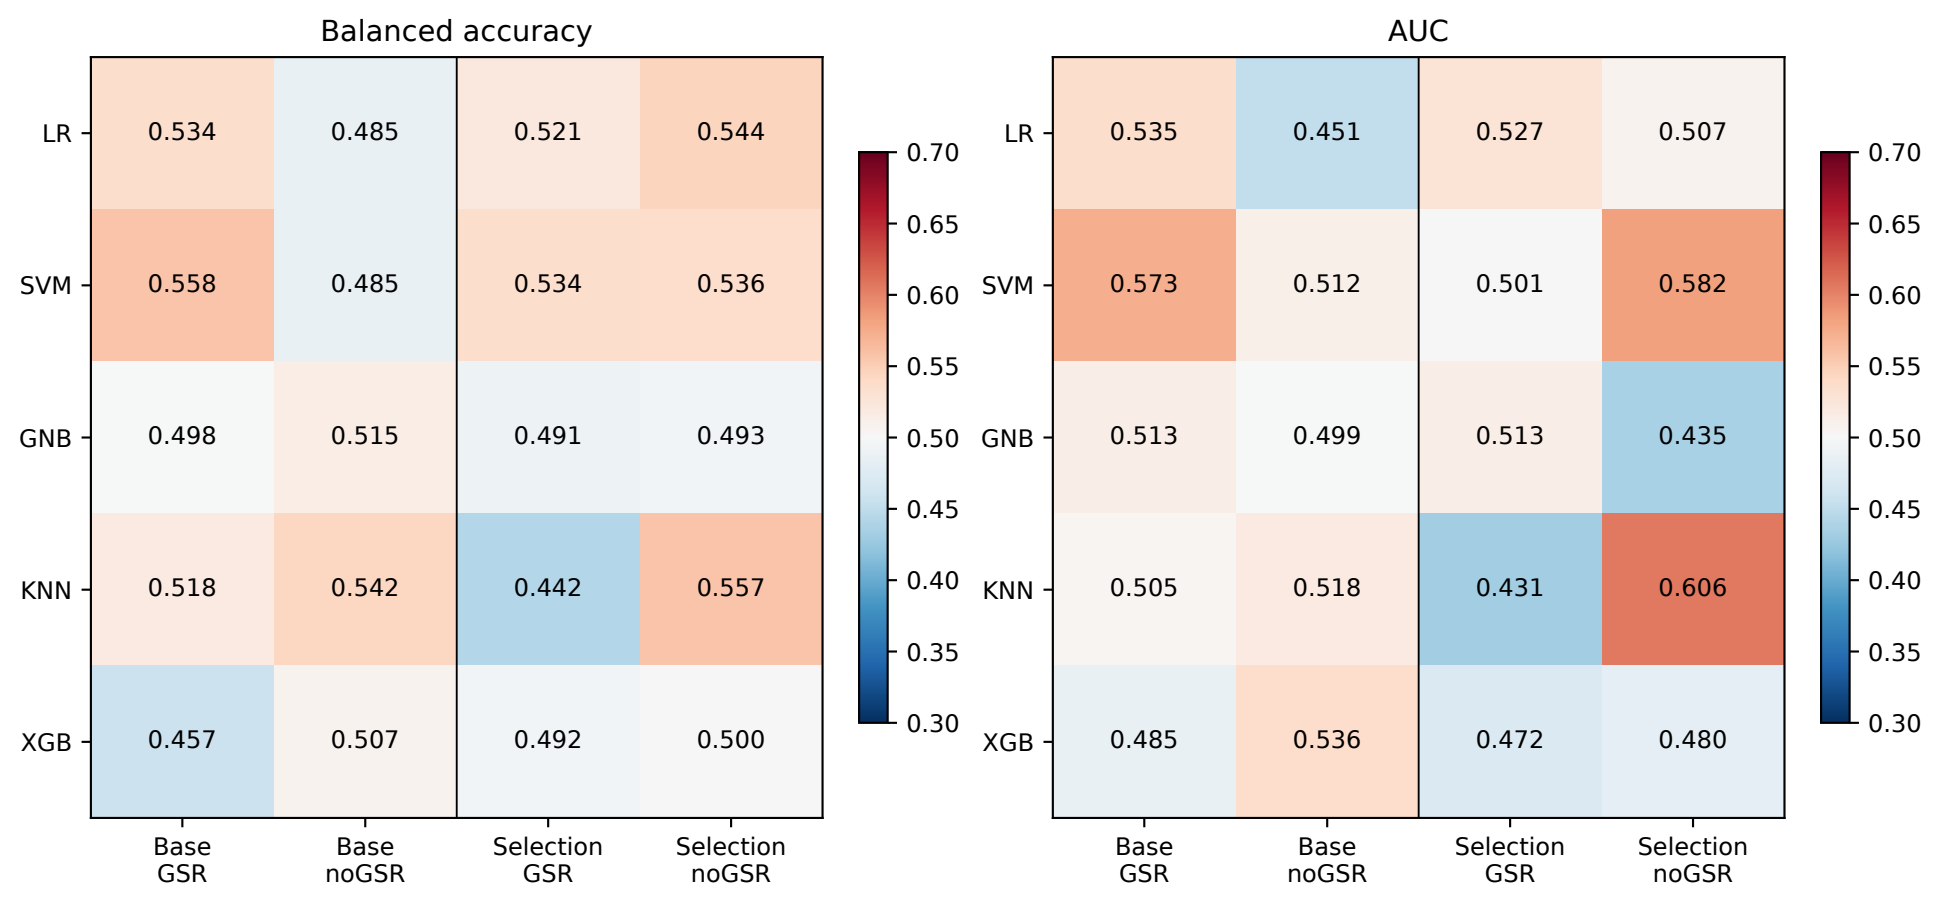
Balanced accuracy
LR
SVM
GNB
KNN
XGB
0.534
0.485
0.521
0.544
0.558
0.485
0.534
0.536
0.498
0.515
0.491
0.493
0.518
0.542
0.442
0.557
0.457
0.507
0.492
0.500
Base GSR
Base noGSR
Selection GSR
Selection noGSR
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
AUC
LR
SVM
GNB
KNN
XGB
0.535
0.451
0.527
0.507
0.573
0.512
0.501
0.582
0.513
0.499
0.513
0.435
0.505
0.518
0.431
0.606
0.485
0.536
0.472
0.480
Base GSR
Base noGSR
Selection GSR
Selection noGSR
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30