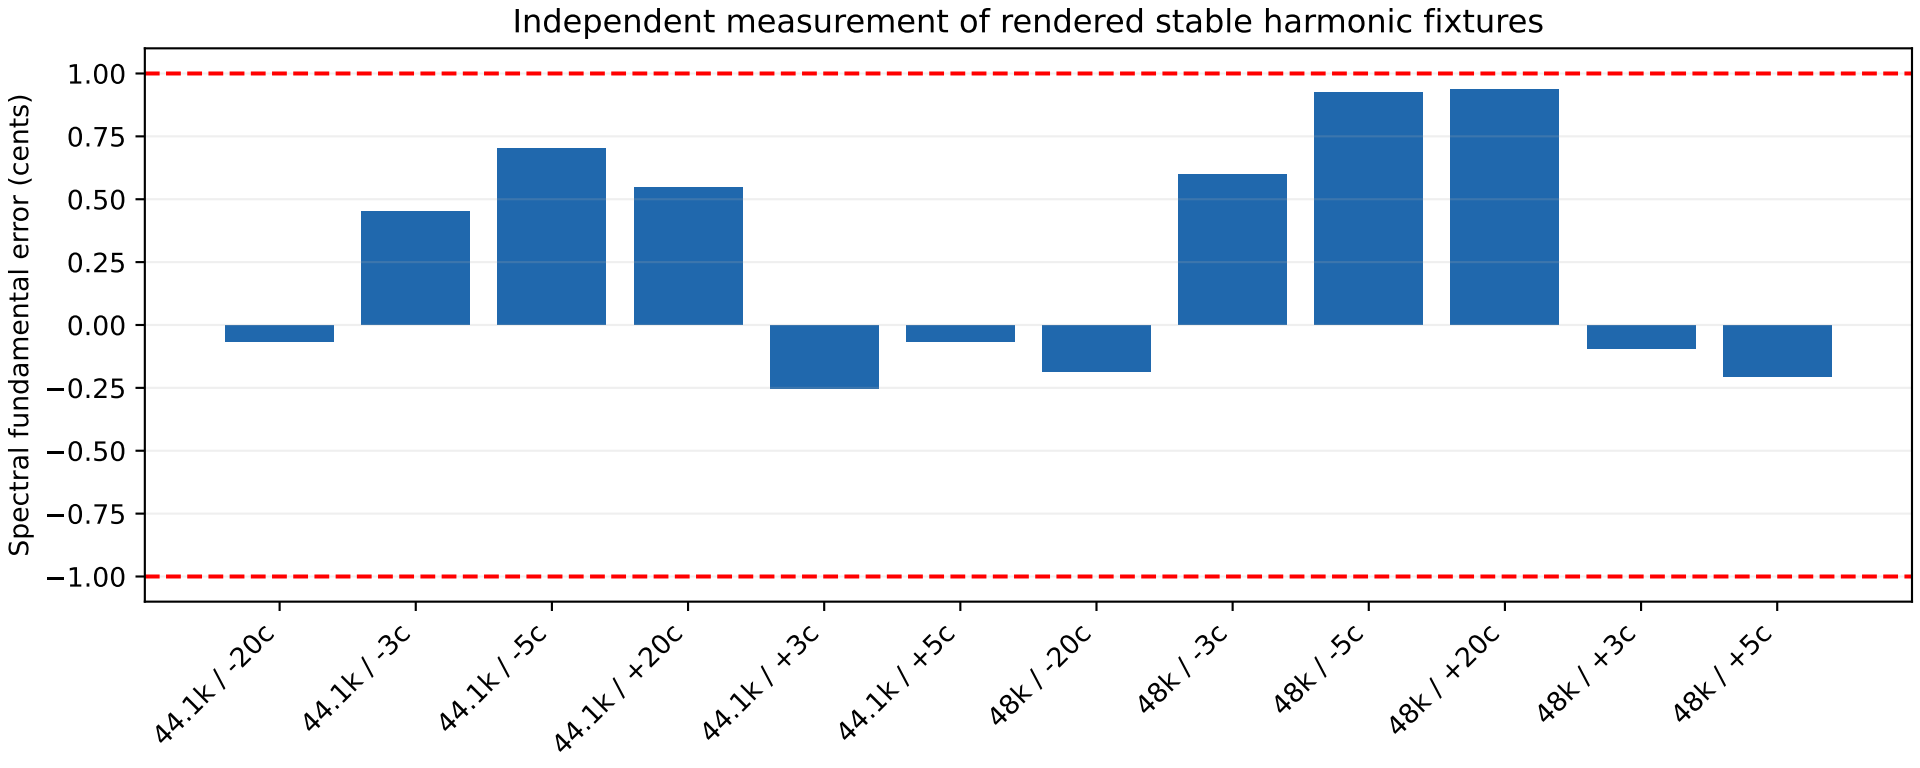
Independent measurement of rendered stable harmonic fixtures
Spectral fundamental error (cents)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
44.1k / -20c
44.1k / -3c
44.1k / -5c
44.1k / +20c
44.1k / +3c
44.1k / +5c
48k / -20c
48k / -3c
48k / -5c
48k / +20c
48k / +3c
48k / +5c