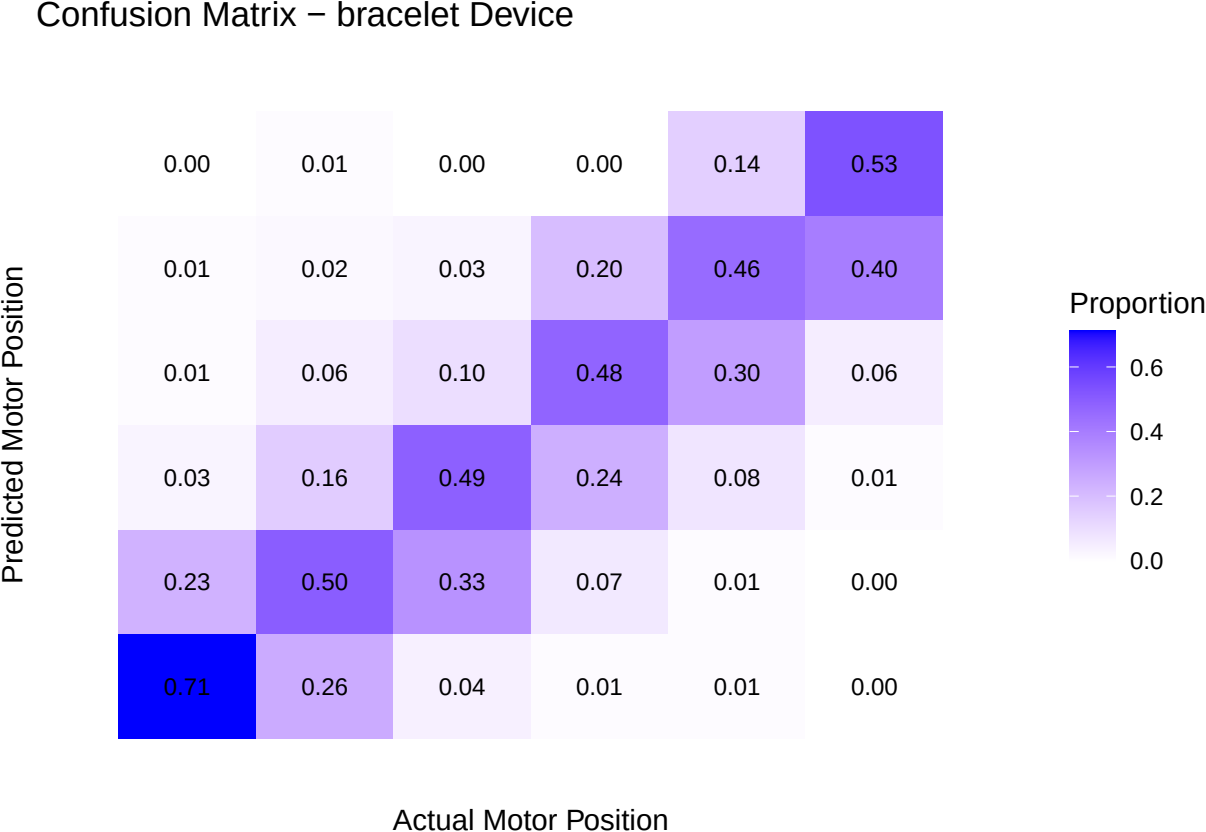
Confusion Matrix − bracelet Device
0.00
0.01
0.00
0.00
0.14
0.53
0.01
0.02
0.03
0.20
0.46
0.40
0.01
0.06
0.10
0.48
0.30
0.06
0.03
0.16
0.49
0.24
0.08
0.01
0.23
0.50
0.33
0.07
0.01
0.00
0.71
0.26
0.04
0.01
0.01
0.00
Predicted Motor Position
Actual Motor Position
Proportion
0.6
0.4
0.2
0.0