


其余: $\frac{6.3}{\triangle}$

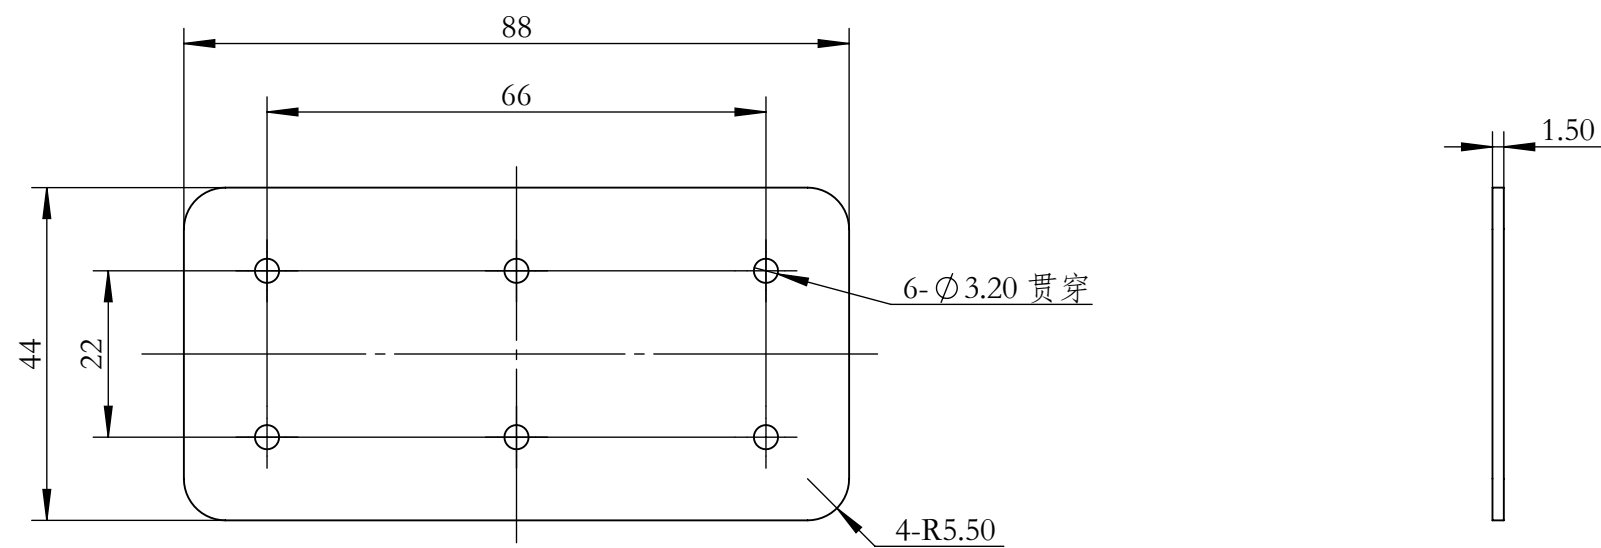

技术要求:

- 1.表面平整,无毛刺;
- 2.未注线性尺寸公差及角度公差按GB/T 1804-f;
- 3.未注形位公差按GB/T 1184-H;

						1.5mm碳纤维板 斜纹亚光					杭州三坛医疗科技有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例	MS001—C支撑板盖板		
设计			标准化							1:1			
校核			工艺										
主管设计			审核										
			批准			共 张 第 张			版本		替代		