
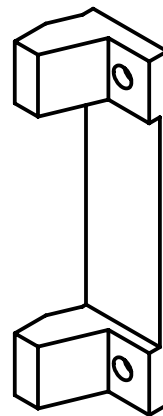


A-A

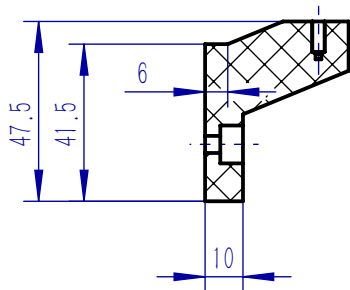

技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
- 2、未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
- 3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
- 4、不足尺寸参考三维模型;
- 5、表面平整, 去除毛刺;

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
|----|----|----|-------|----|-----|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | 工艺 | | |
| 审核 | | | | | |
| 批准 | | | | | |

ABS


阶段标记

重量

比例

共 1 张 第 1 张

版本



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

MS001-A
外壳侧部固定支架

MS001-A. 02. 013SL. 1. 1

替代