



1	蓝
2	绿
3	红
4	黑

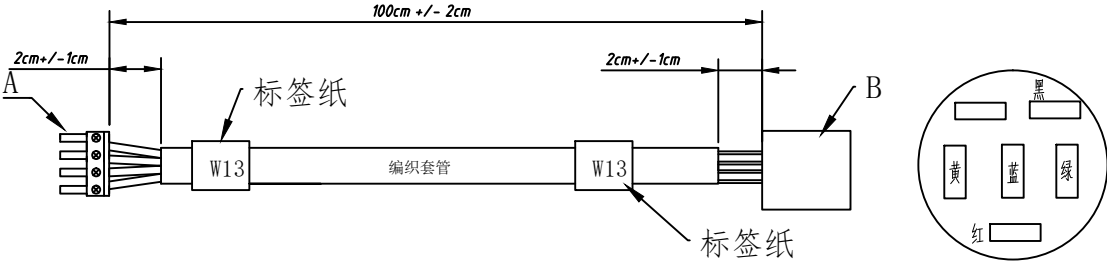

技术要求

- 1、线缆外部用  $\Phi 8$  的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、HT396K-3.96-4P-14-00A（母头）端剥线拧接点锡处理，控制剥线长度，避免电缆导电部分裸露在外，多出来的黄线剪断不用；
- 3、16mm带灯按钮座要求供应商预留线长度150cm；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	16mm带灯按钮座及自带线
A	HT396K-3.96-4P-14-00A(母头)

						线缆组件						 三坛医疗科技 Sante Medical Technology		
标记	处数	分 区		更改文件号	签名	年、月、日							MS001-B台车升控制线	
设 计				标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例				
校 对												MS001-B. 01. 013XH. 1. 1		
审 核										1:1				
工 艺				批 准			共      张      第      页							