
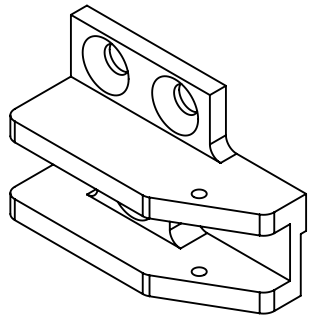
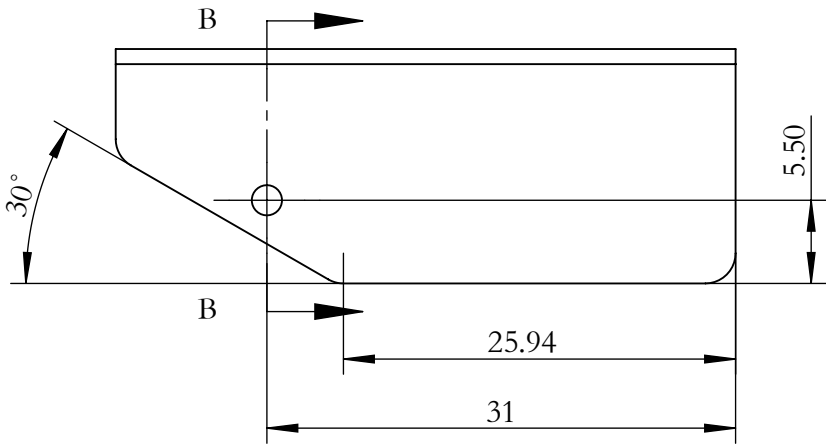


A-A

- 技术要求:
- 1.表面平整, 无毛刺;
 - 2.未注圆角尺寸为R2;
 - 3.未注线性尺寸公差及角度公差按GB/T 1804-f;
 - 4.未注形位公差按GB/T 1184-H;
 - 5.表面打磨、抛光

B-B

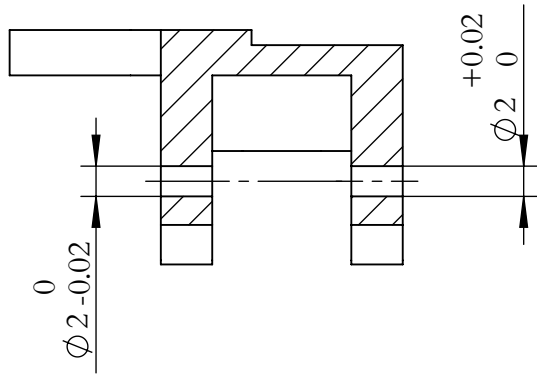

						SUS304			杭州三坛医疗科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		数量	比例	MS001-C底板
设计			标准化						2:1	
校核			工艺							
主管设计			审核							MS001-C.04.003JS.1.1
			批准			共 张 第 张		版本	替代	