



MS001-A.03.009SL.1.1

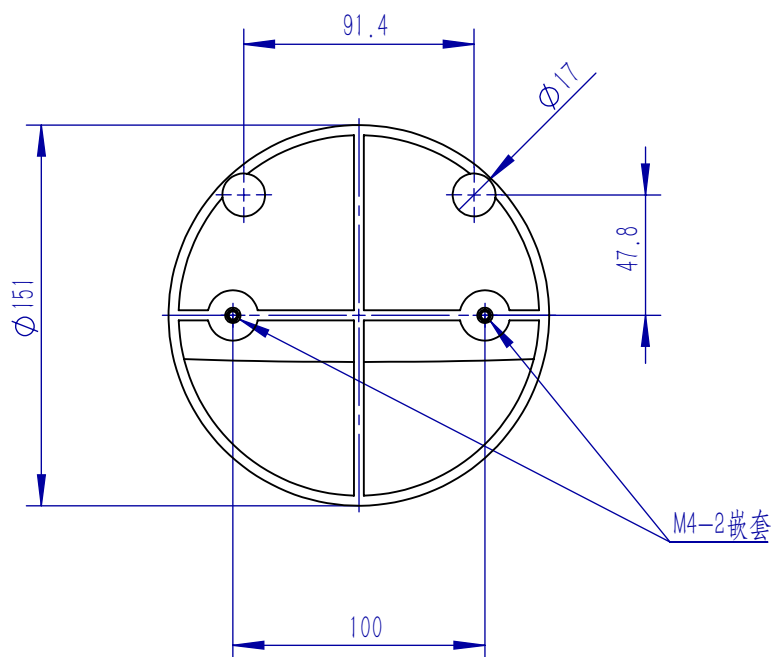

技术要求:

1. 表面平整边角无毛刺;
2. 内面均匀喷涂导电漆;
3. 表面哑光喷漆PANTONE 冷灰4C, 详见喷漆说明书;
4. 共嵌2个M4-2嵌套;
5. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
6. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
7. 未注尺寸参照stp文件。

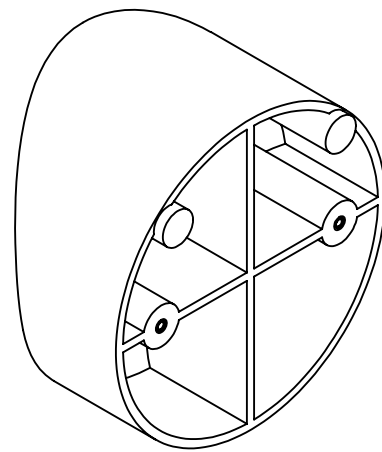

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

ABS



三坛医疗科技  
Santa Medical Technology

MS001-A摄像头盖板

MS001-A. 03. 009SL. 1. 1

阶段标记

重量

比例

0.315

1:3

共1张 第1张

版本

替代