
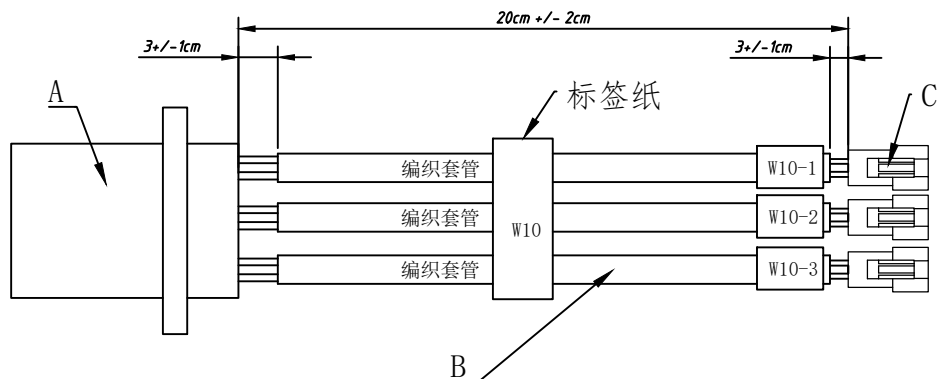


焊接面示意图

1	红
2	黑
1	蓝
2	白
11	黄
12	绿



1	红
2	黑
1	蓝
2	白
1	黄
2	绿

技术要求

- 1、线缆外部用 $\phi 4$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、SM2.5-2Pin公头端子采用压接，保证压接牢固；
- 3、线缆另一端与脚踏开关插座焊接，并用合适的热缩套管保护；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

C	SM2.5-2Pin公头
B	22AWG 红/黑/蓝/白/黄/绿
A	脚踏开关插座

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			MS001-B脚踏线
设 计			标准化						
校 对									MS001-B. 01. 010XH. 1. 1
审 核								1:1	
工 艺			批 准			共	张	第 页	