
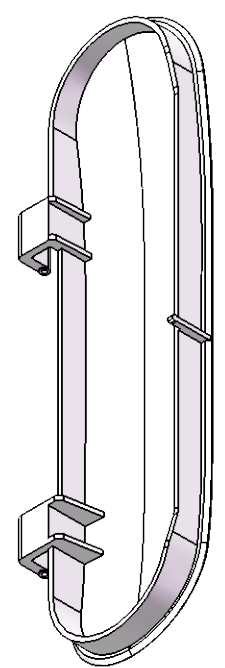



MS001-B.04.009SL.1.1

6.3

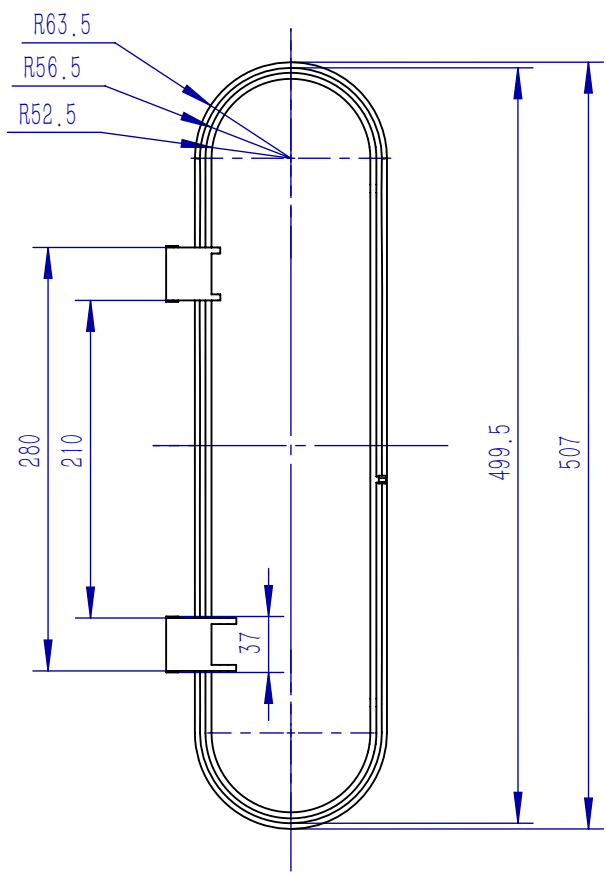


技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
3. 哑光喷漆, 白色, 正反全喷;
4. 周边平整无毛刺;
5. 丝印见丝印文件MS001-B.04.009SY.1.1;
6. 未注外形尺寸参考STEP文件;

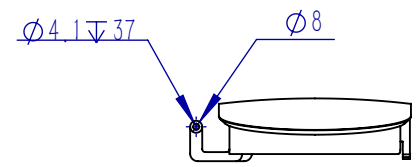

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

ABS			 三坛医疗科技 Santa Medical Technology		
阶段标记		重量	比例	MS001-B 外壳5	
		0.370	1:5	MS001-B. 04. 009SL. 1. 1	
共 1 张 第 1 张		版本		替代	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期