

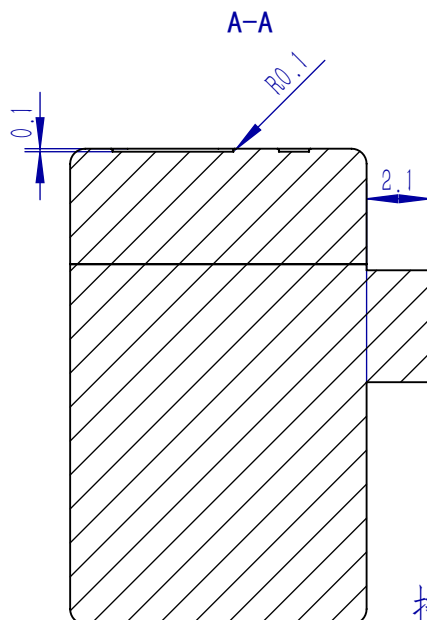



MS001-D.01.002SL.1.1


6.3

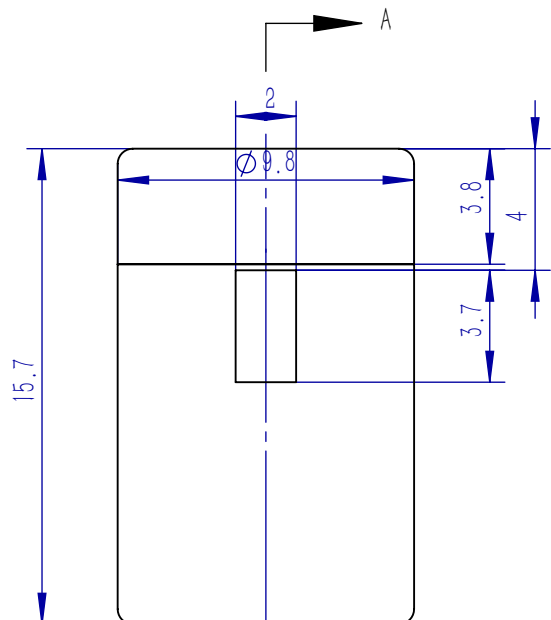

技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
3. 表面平整, 无毛刺;
4. 未注倒角R0.5;

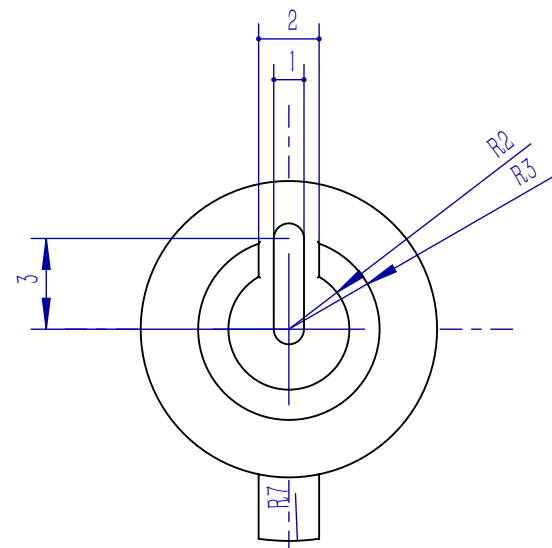

						ABS			 三坛医疗科技 Santa Medical Technology	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记			MS001-D 开关	
设计			标准化			重量			MS001-D.01.002SL.1.1	
校对			工艺			0.001				
审核						4:1				
批准						共1张 第1张			版本	
						替代				

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期