



24V	蓝
DI0	白
24V	
DI1	
24V	
DI2	
24V	
DI3	

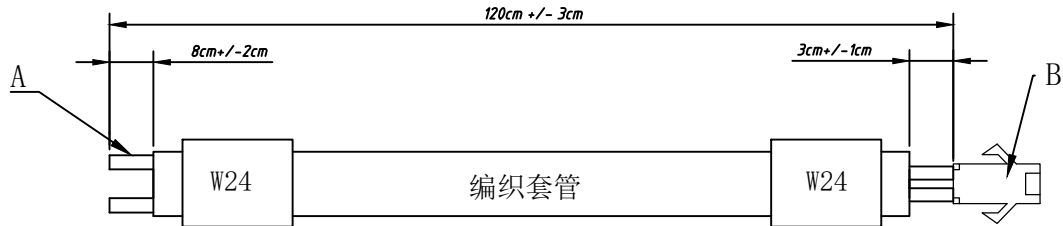

技术要求

- 1、线缆外部用 $\phi 4$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、SM2.5-2Pin（母头）端采用压接方式，保证压接可靠；
- 3、线缆裸露端剥线3mm点锡处理，待后续装配；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	SM2.5-2Pin母头
A	22AWG 蓝/白

						线缆组件	 三坛医疗科技 Sante Medical Technology			
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日		MS001-B脚踏延长线			
设 计			标准化							
校 对						阶 段 标 记		重 量	比 例	MS001-B. 01. 024XH. 1. 1
审 核									1:1	
工 艺			批 准			共 张 第 页				