
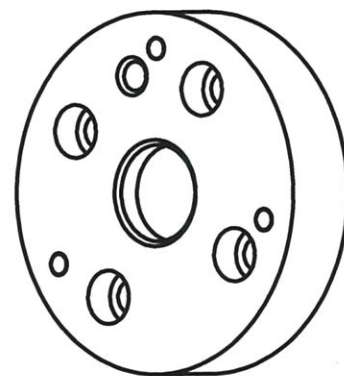
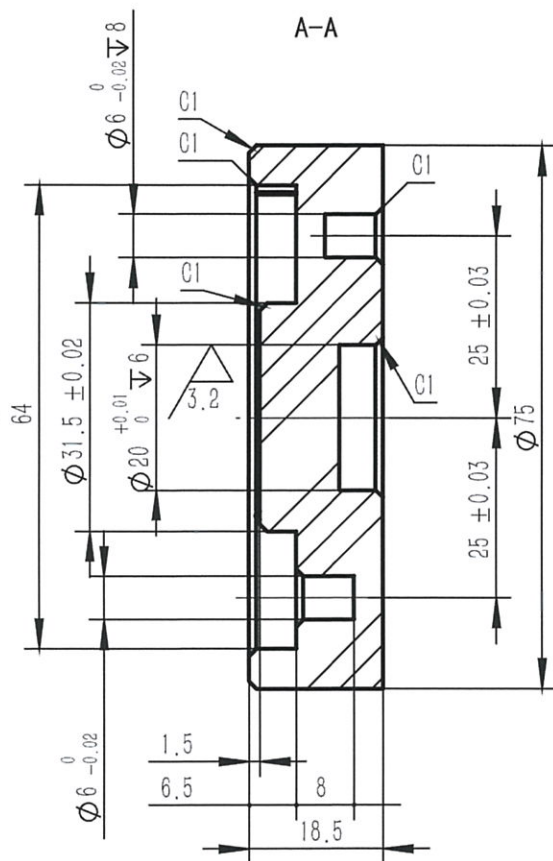


其余: $\sqrt{3.2}$

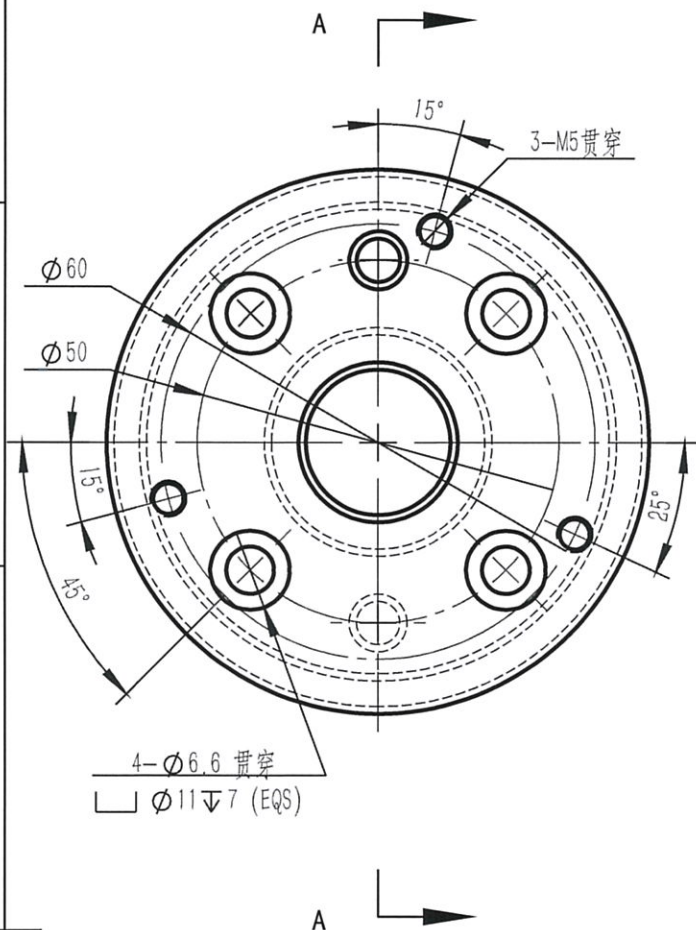

技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
3. 棱边钝化处理;
4. 不足尺寸参考三维模型;
5. 表面平整, 去除毛刺;

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

签字

设计 沈松 2021.04.25 标准化

校对 沈松 2021.04.25 工艺 马志豪 2021.04.25

日期

审核 沈松 2021.04.25

批准 沈松 2021.04.25

阶段标记

重量

比例

共1张 第1张 版本

替代

黑色POM



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

MS001-C转接法兰

MS001-C. 02. 002SL. 1. 1