



1	蓝
2	绿
3	红
4	黑

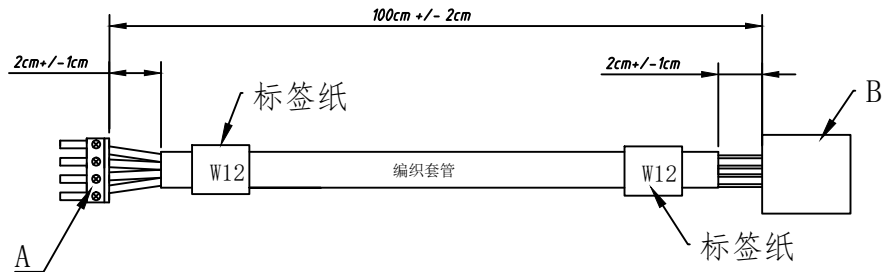

技术要求

- 1、线缆外部用 $\phi 8$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、HT396K-3.96-4P-14-00A（母头）端剥线拧接点锡处理，控制剥线长度，避免电缆导电部分裸露在外，多出来的黄线剪断不用；
- 3、16mm带灯按钮座要求供应商预留线长度150cm；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	16mm带灯按钮座及自带线
A	HT396K-3.96-4P-14-00A(母头)

						线缆组件				 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日						
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		
校 对										MS001-B. 01. 012XH. 1. 1	
审 核									1:1		
工 艺			批 准			共 张 第 页					