




MS001-B. 04. 003SL. 1. 1

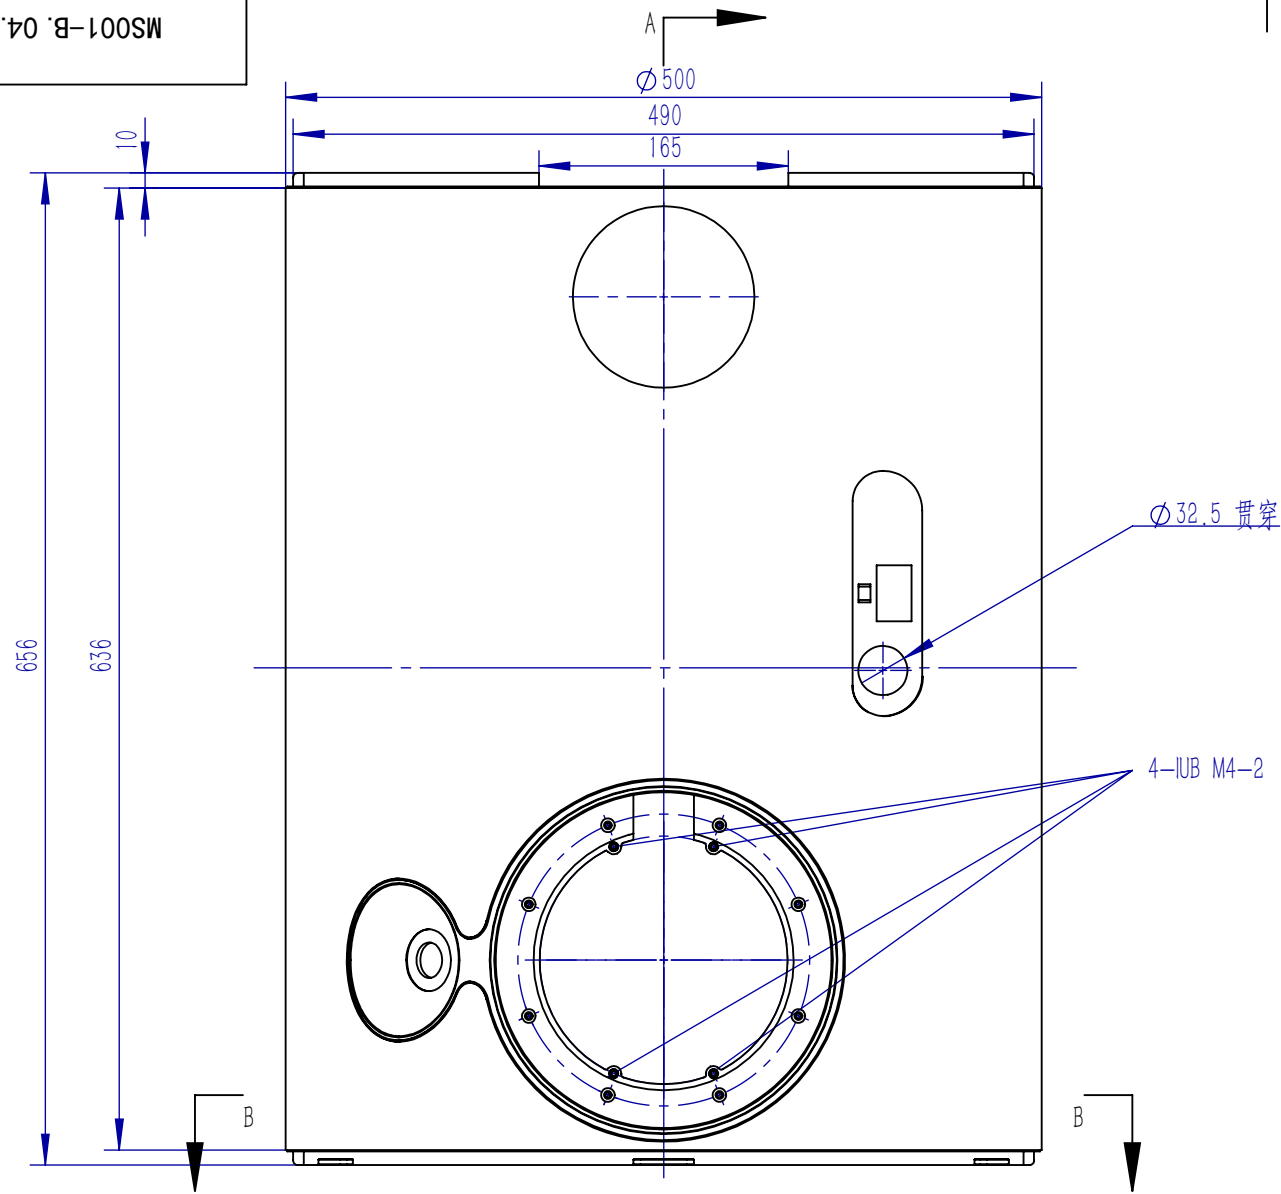


A-A
1 : 5

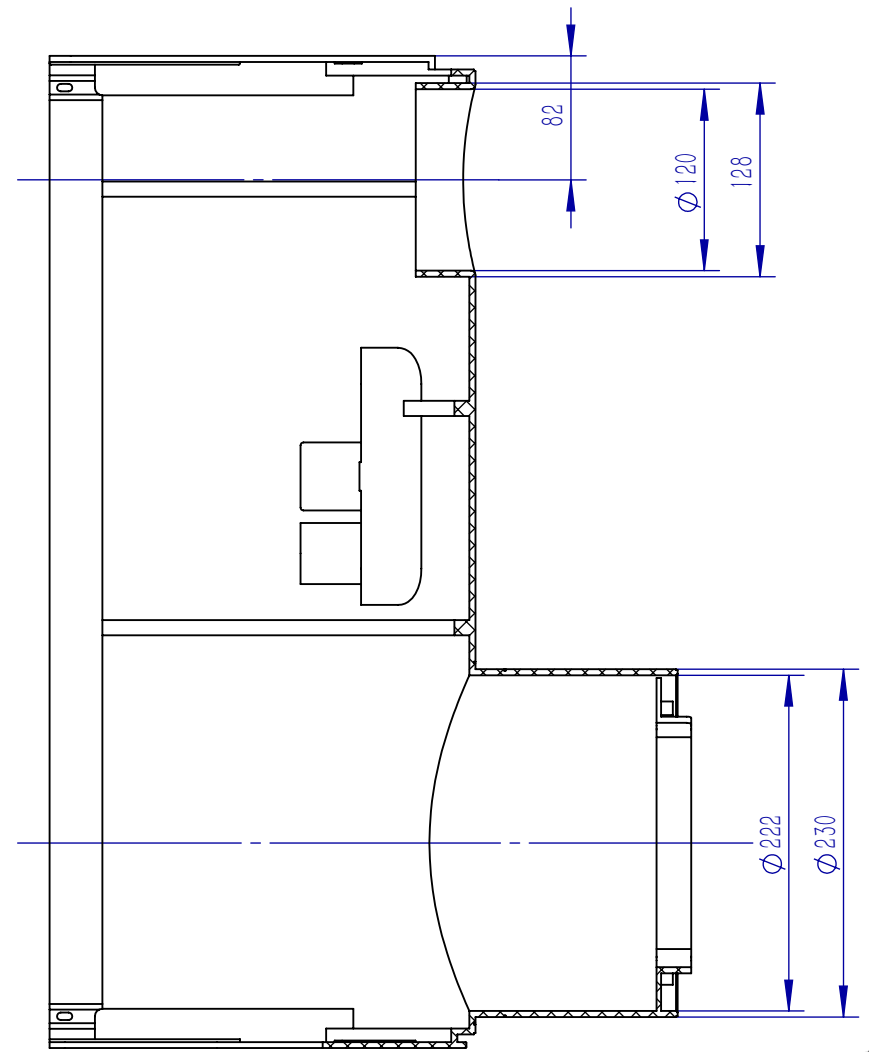

B-B
1 : 5

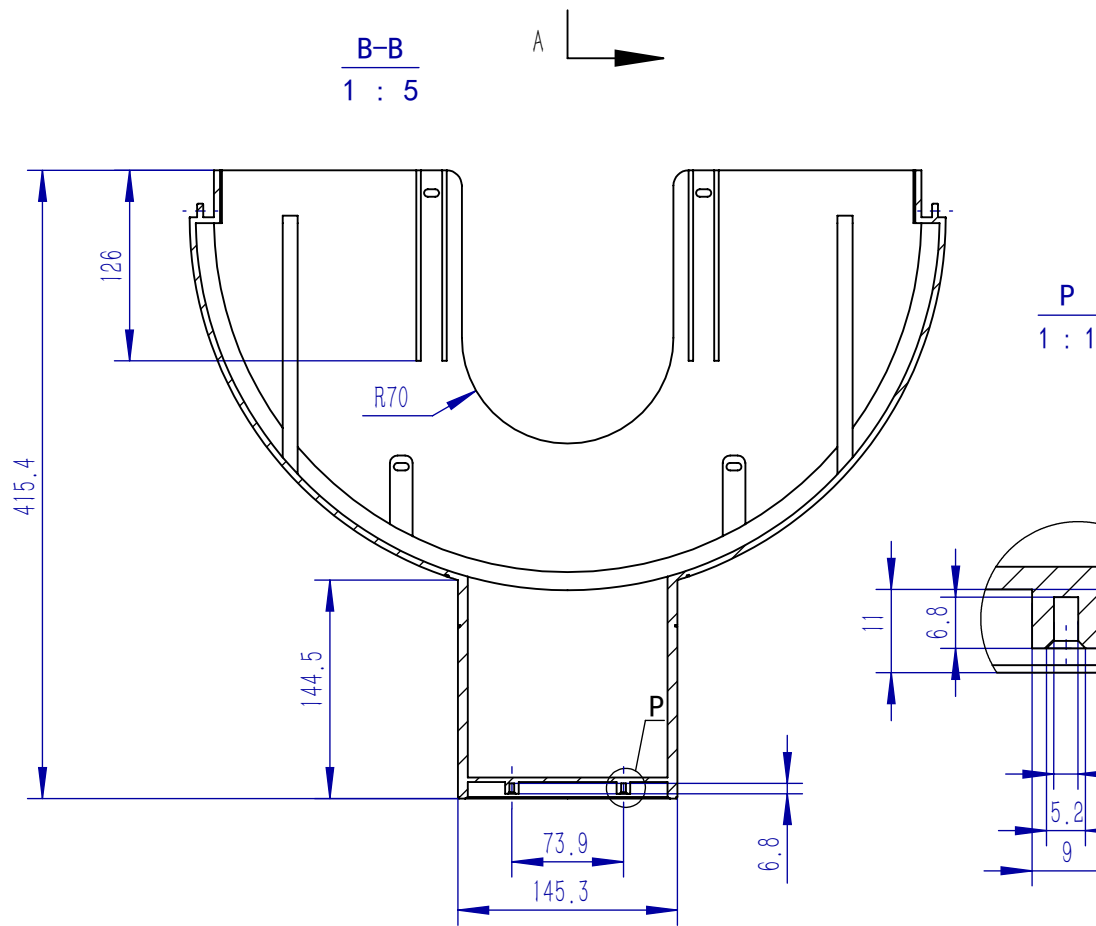


P
1 : 1

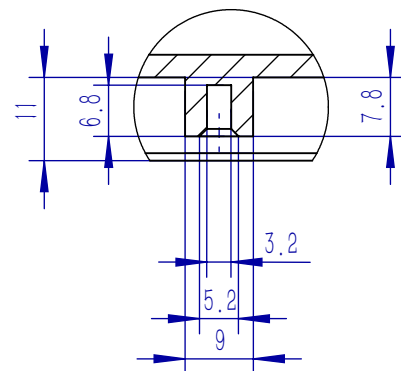

技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
3. 表面平整边角, 无毛刺;
4. 哑光喷漆, 色号冷灰色40(潘通色卡);
5. 内表面喷涂铜导电漆;
6. 未注外形尺寸参考STEP文件;

此面为喷漆面
内喷导电漆

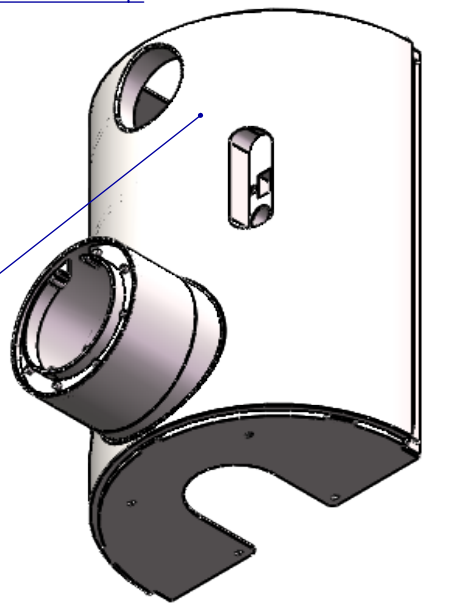

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						ABS			 三坛医疗科技 Santa Medical Technology	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日					
设计			标准化			阶 段 标 记		重量	比例	MS001-B 外壳1 MS001-B. 04. 002SL. 1. 1
校对			工艺					3.806	1:10	
审核										
批准						共 1 张 第 1 张		版本		替代