


1	红
2	黑
3	绿
4	蓝

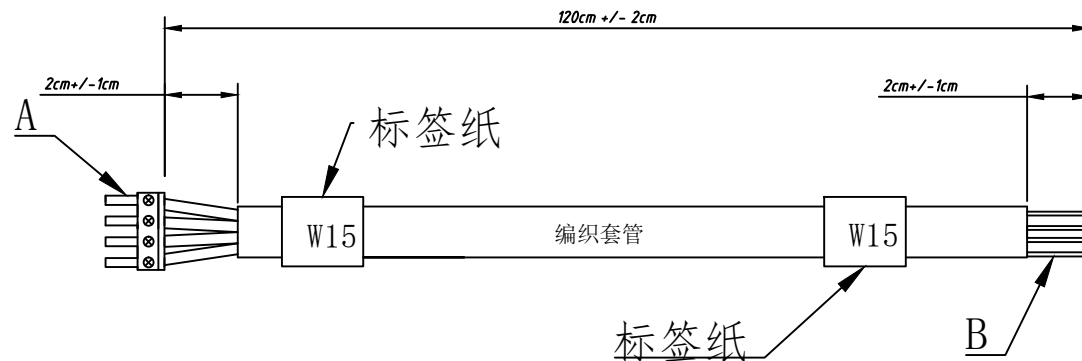


12V	红
GND	黑
ON	绿
OFF	蓝

技术要求

- 1、线缆外部用 $\phi 8$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、线缆两端剥线拧接点锡处理，控制剥线长度，避免电缆导电部分裸露在外；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	22AWG 红/黑/绿/蓝
A	HT396K-3.96-4P-14-00A(母头)

						线缆组件					 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日							
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		MS001-B UR开/关输出控制线	
校 对												
审 核									1:1		MS001-B.01.015XH.1.	
工 艺			批 准			共 张 第 页						