
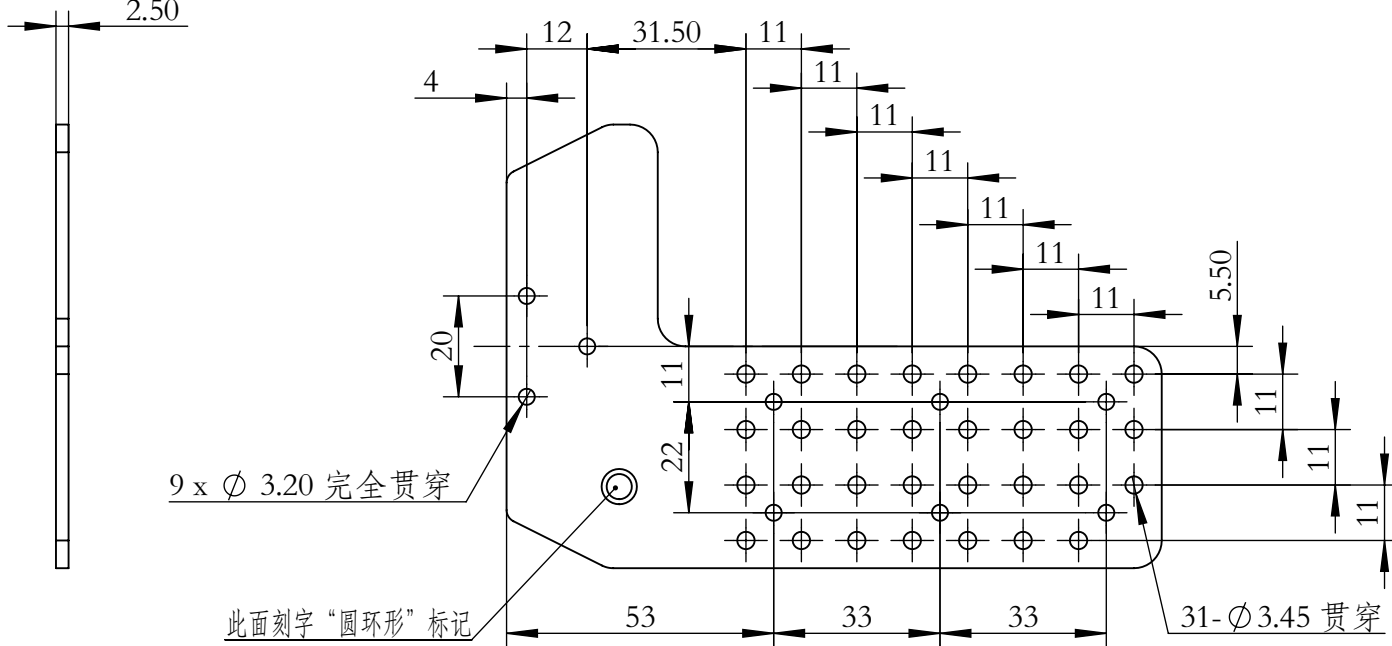
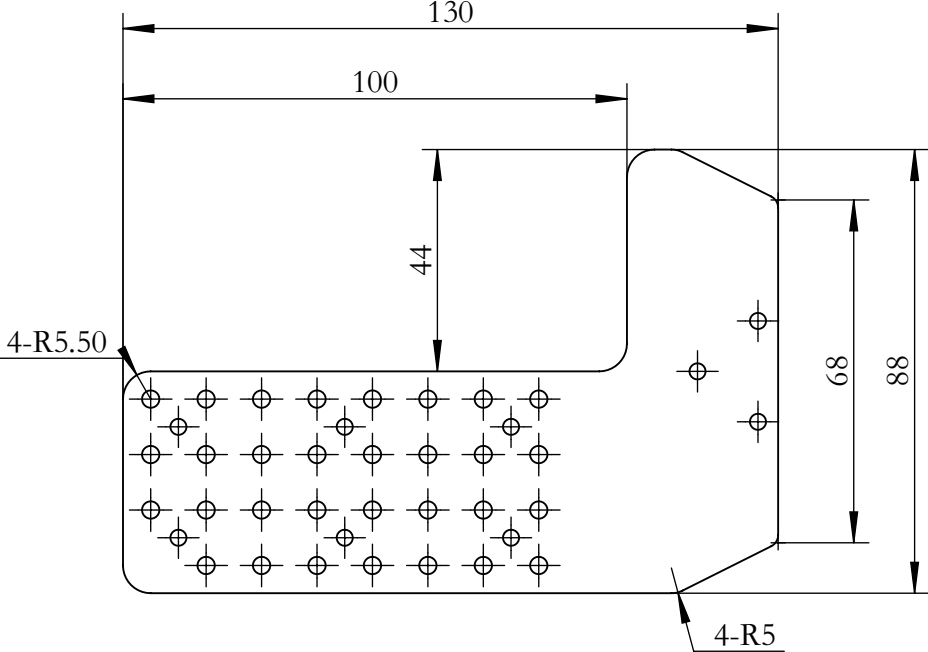


其余: 



1.表面平整

- 2.未注线性尺寸公差及角度公差按GB/T 1804-f;
3.未注形位公差按GB/T 1184-H;

						1.5mm碳纤维板 斜纹亚光				杭州三坛医疗科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	MS001-C支撑板I	
设计			标准化						1:1		
校核			工艺							MS001-C.03.002SL.1.1	
主管设计			审核								
			批准			共 张 第 张		版本		替代	