


技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
- 2、未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
- 3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
- 4、图示面喷漆, 哑光白色;
- 5、不足尺寸参考三维模型;
- 6、焊后打磨平整处理。

仅此面喷漆, 哑光白色

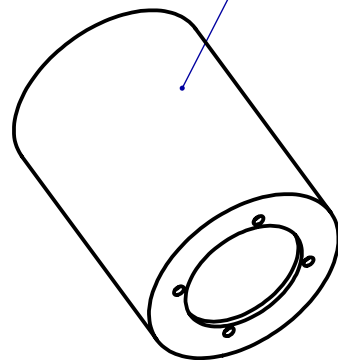

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

304



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

阶段标记 重量 比例

1.538 1:2

共1张 第1张 版本 替代

MS001-A 工作台支撑柱

MS001-A. 02. 010JS. 1. 1