
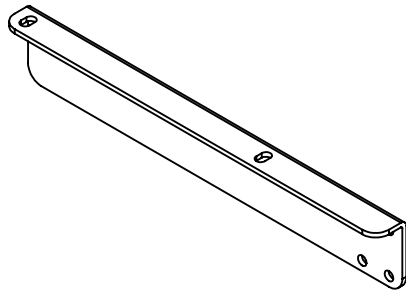


A

B

C

D

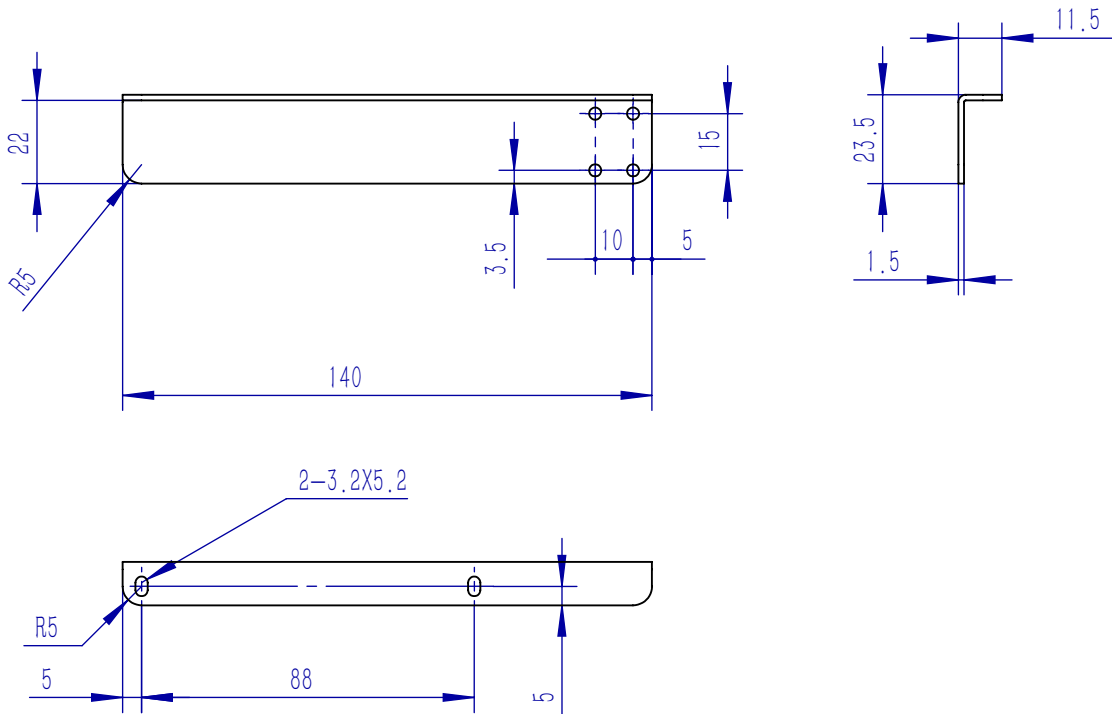

技术要求:

1. 表面平整边角无毛刺;
2. 表面镀锌处理;
3. 未注尺寸公差按GB/T 1804-c 执行;
4. 未注形位公差按GB/T 1184-L 执行。

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

冷轧钢板 t=1.5

阶 段 标 记 重 量 比 例

1:2

共 张 第 张 版 本



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

MS001-A抽屉左支撑板

MS001-A. 05. 008JS. 1. 1

替代