


1	黑
2	蓝

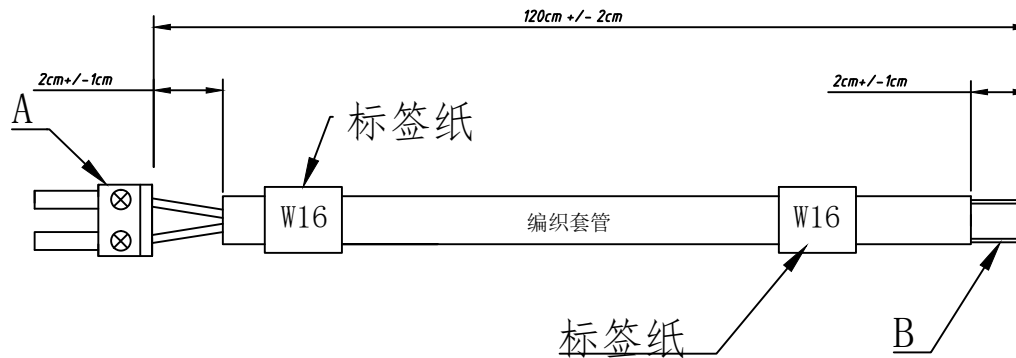


0V	黑
D□0	蓝
0V	
D□1	
0V	
D□2	
0V	
D□3	

#### 技术要求

- 1、线缆外部用 $\phi 4$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、线缆两端剥线拧接点锡处理，控制剥线长度，避免电缆导电部分裸露在外；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	22AWG 蓝/黑
A	HT396K-3.96-2P-14-00A(母头)

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				MS001-B UR上电反馈线	
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例		
校 对									MS001-B.01.016XH.1.1	
审 核								1:1		
工 艺			批 准			共	张	第 页		