

A

B

C

D

零件代号

借(通)用件登记

描图




描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

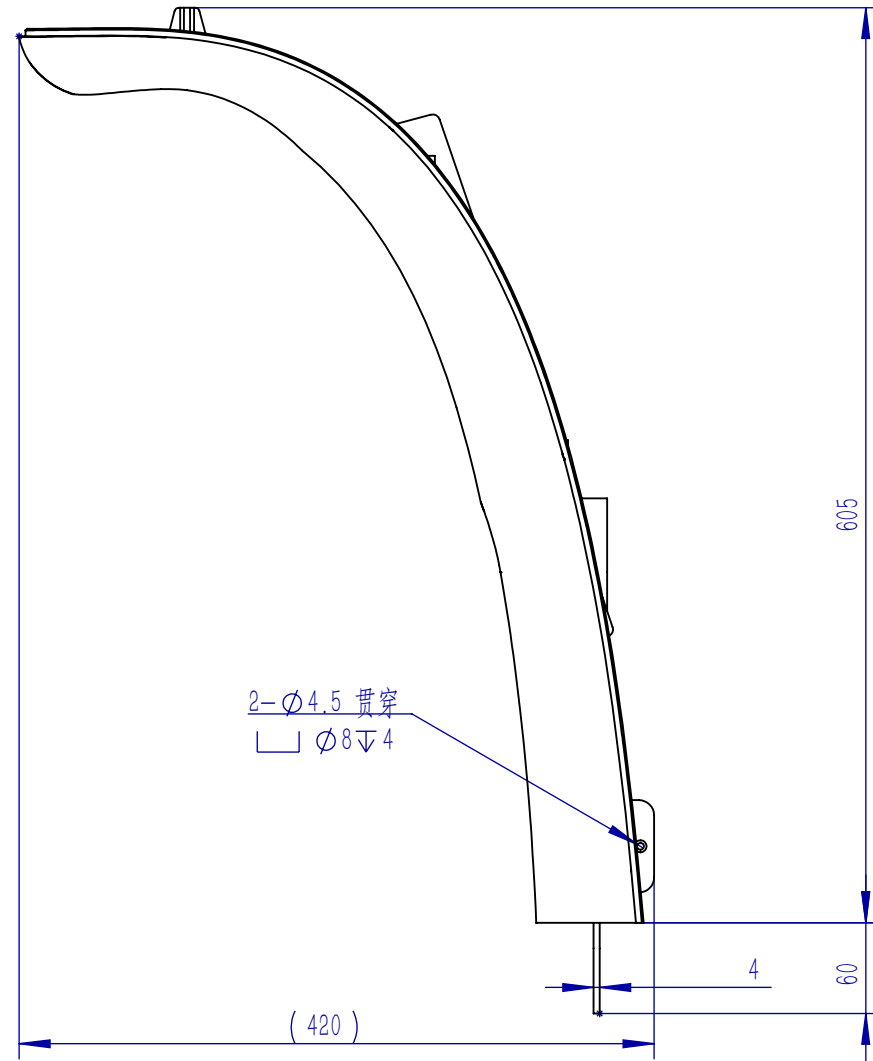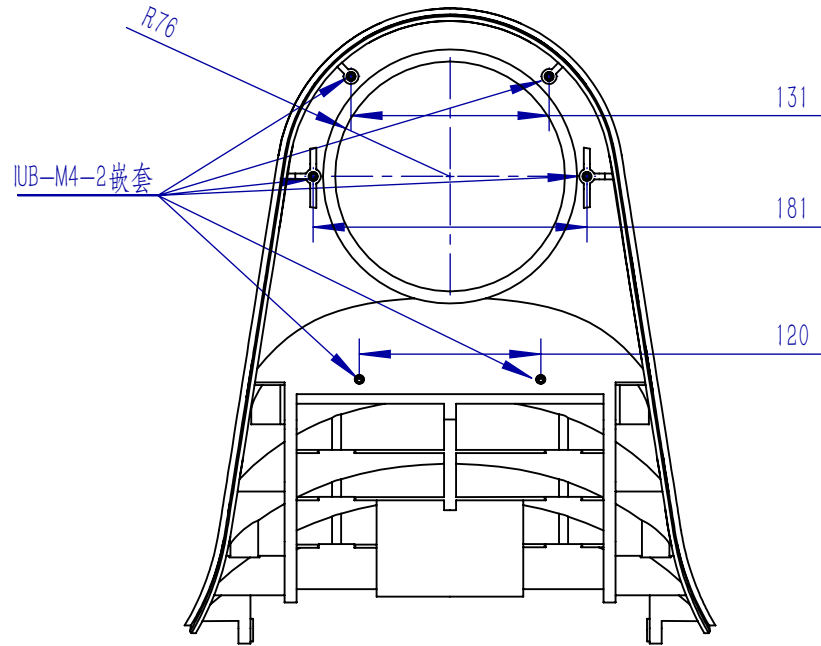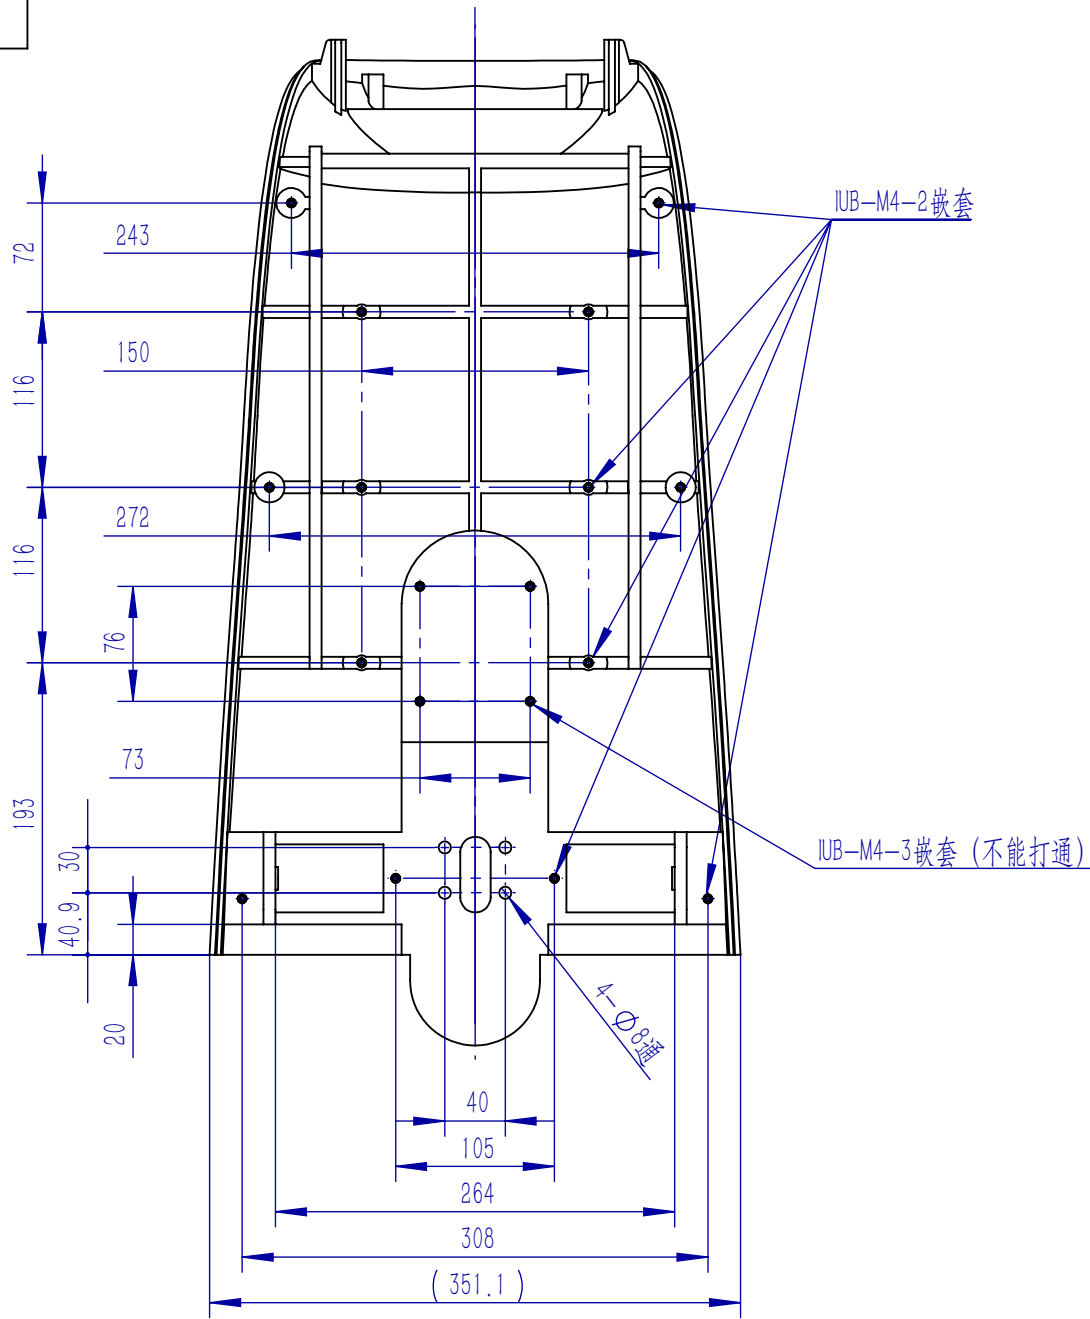

技术要求:

1. 表面平整边角无毛刺;
2. 内表面喷涂导电漆;
3. 表面哑光喷漆PANTONE 冷灰4C, 详见喷漆说明书;
4. 主视图内共嵌入14个IUB-M4-2嵌套;
5. 共嵌20个IUB-M4-2嵌套, 4个IUB-M4-3嵌套;
6. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
7. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
8. 未注尺寸参照stp文件。

						ABS			 三坛医疗科技 Santa Medical Technology
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
设计			标准化						MS001-A外壳6
校对			工艺						MS001-A. 03. 010SL. 1. 1
审核									
批准						共1张 第1张	版本		替代