
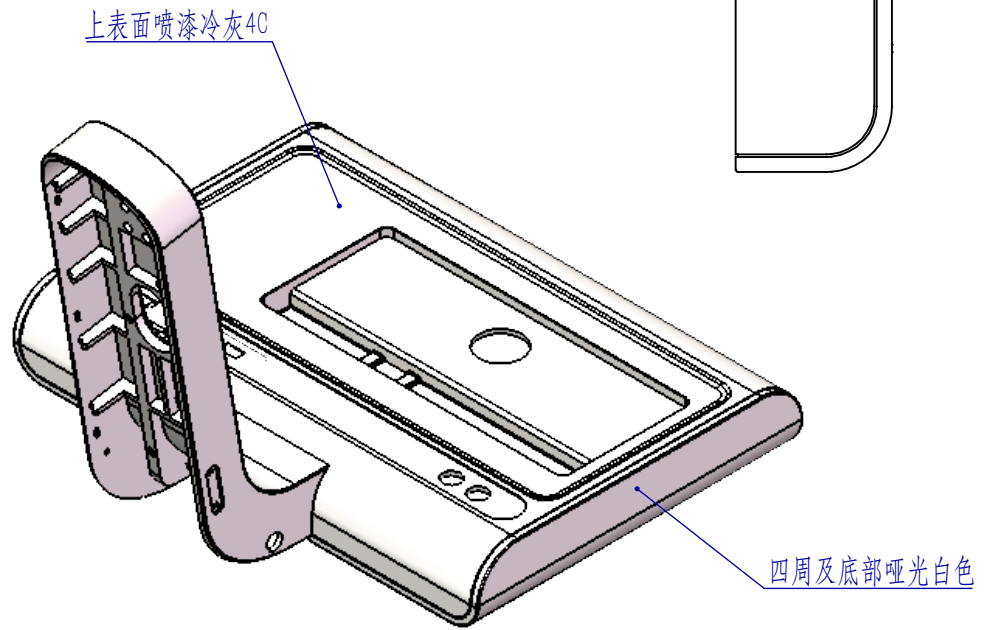
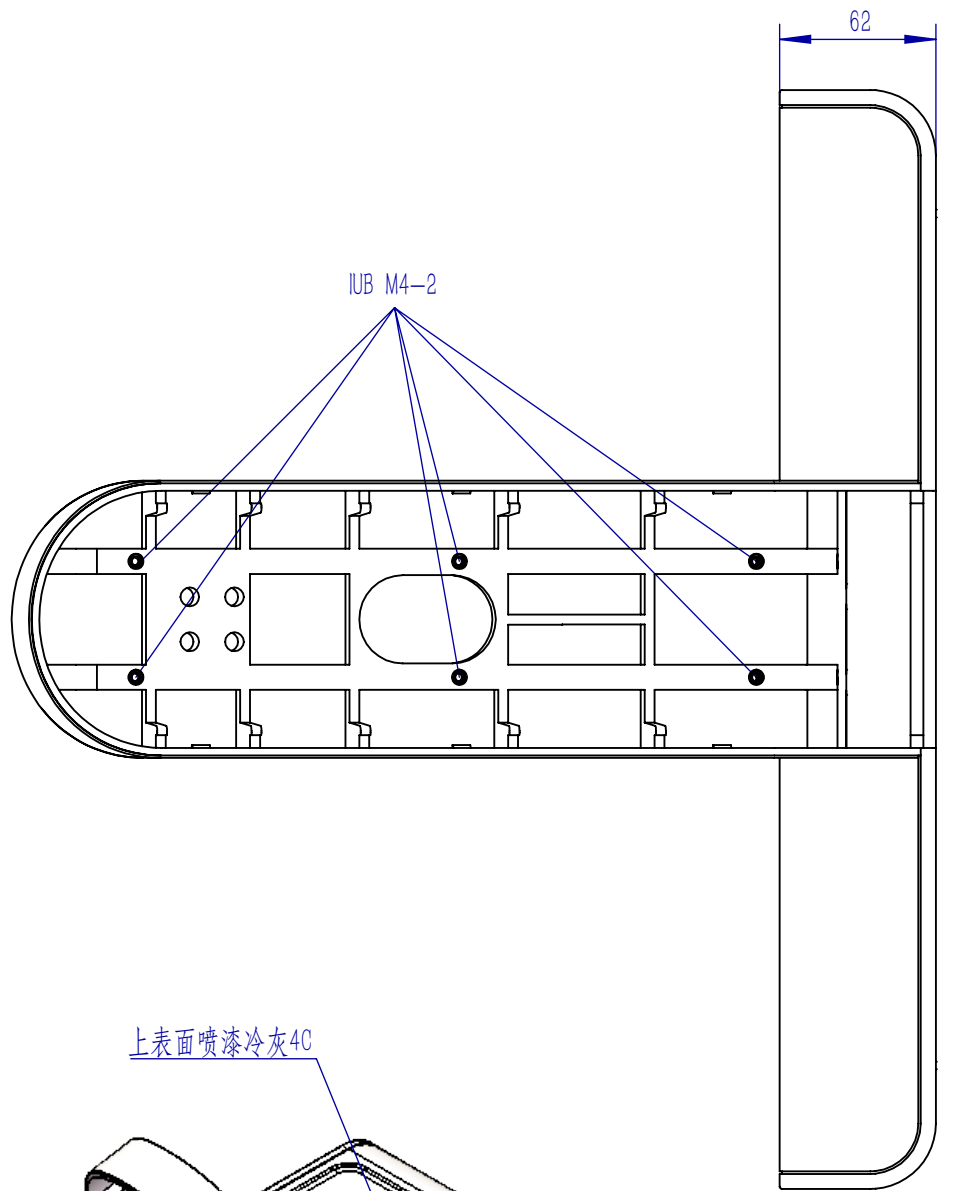
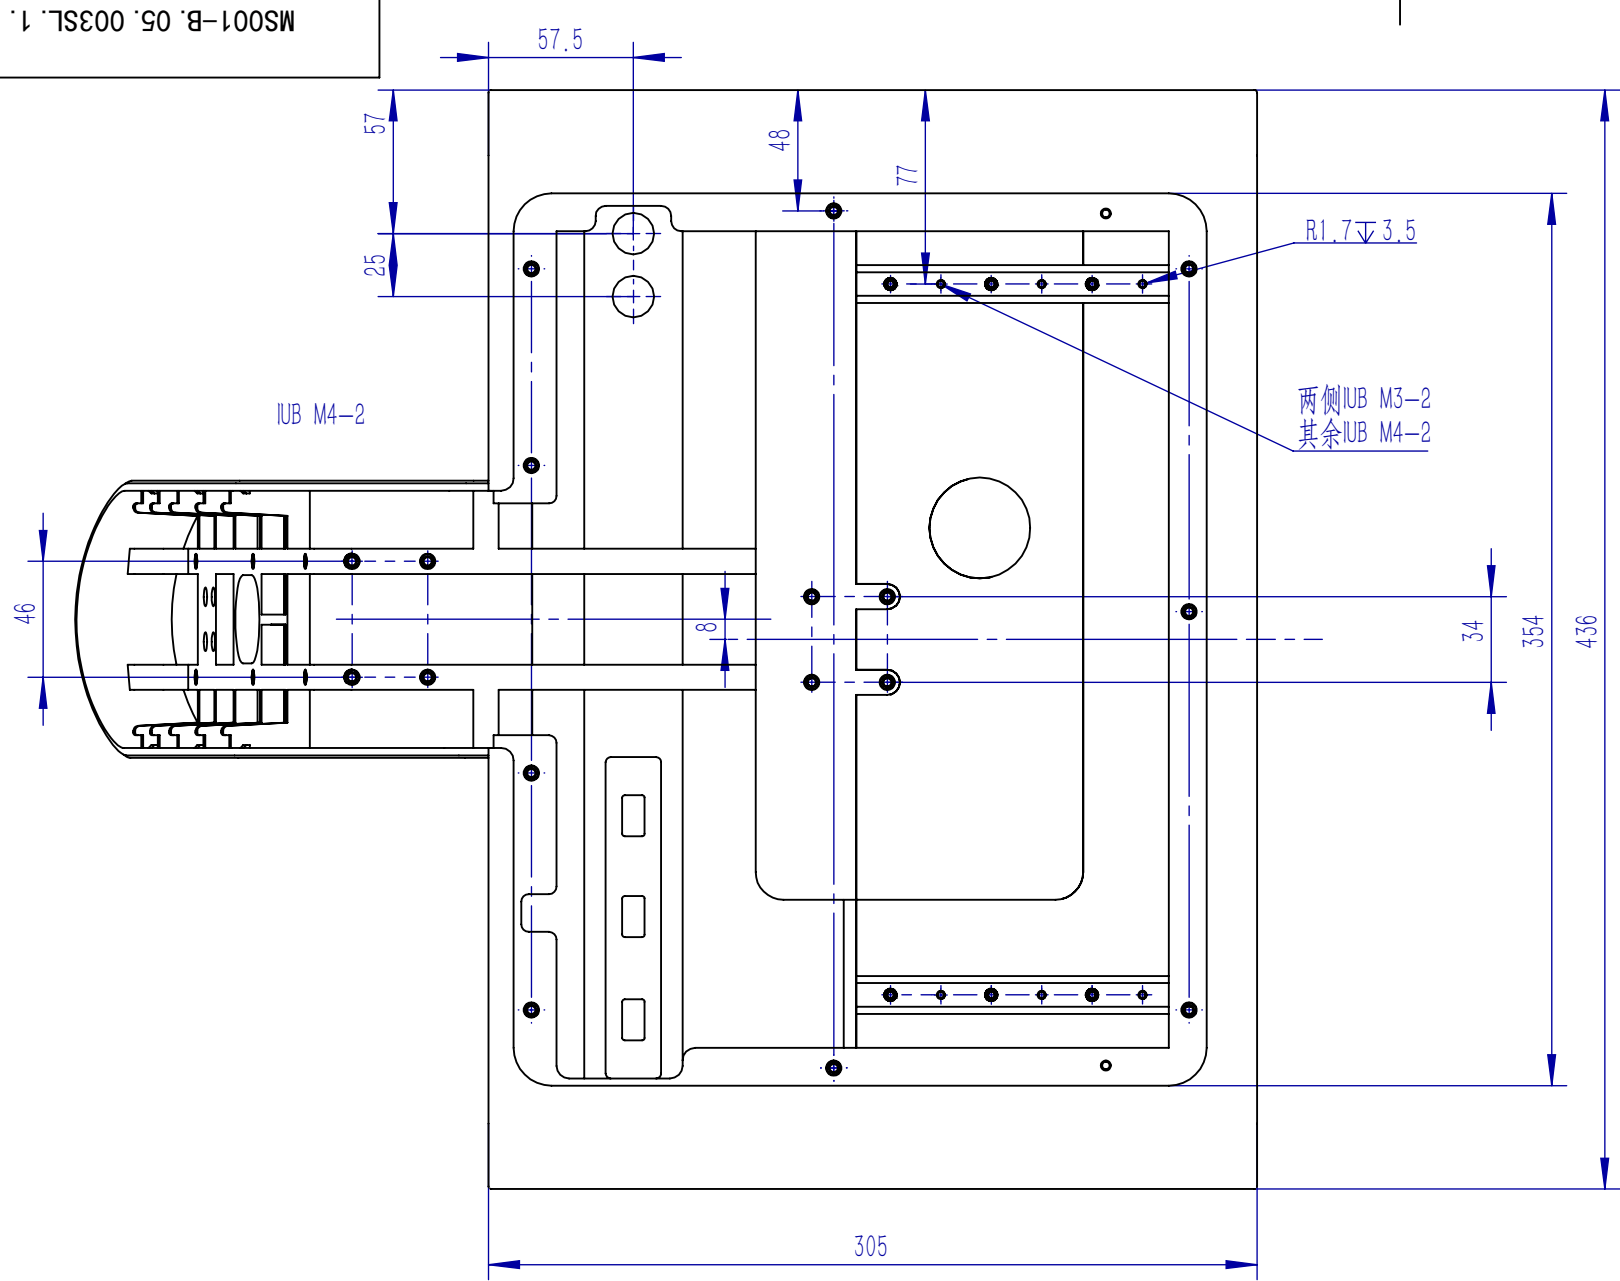


MS001-B.05.003SL.1.1



技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
3. 如图示喷漆, 详见喷漆说明书;
4. 周边平整无毛刺;
5. 未注外形尺寸参考STEP文件;

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|-------|----------------|--|----------|---|--------------------------|---------------|
| | | | | | | ABS | | |  三坛医疗科技 Santa Medical Technology | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | | | | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶 段 标 记 | | 重量 | | 比例 | MS001-B 工作台主体 |
| 校对 | | | 工 艺 | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | 1566.579 | 1:3 | MS001-B. 05. 003SL. 1. 1 | |
| 批准 | | | | | | 共 1 张 第 1 张 | | 版本 | | 替代 | |

MS001-B 工作台主体

MS001-B.05.003SL.1.1